MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 7 (27.10.2026)
SW version 1.1.6

Table of contents

Medit Link Express

簡介 5

Medit Link Express 5

預期用途 5

禁忌症 5

對操作人員的資格要求 5

符號 5

概覽 7

系統需求與安裝 9

建議系統配置要求 9

iPad 9

Mac 9

安裝應用程式 10

設定 11

Medit Link Express > 開始

註冊&登入/登出 16

註冊 16

登入/登出 19

掃描儀設定 21

掃描儀連接 21

無線連接（直接） 21

無線連接（集線器） 27

USB連接 30

校準掃描儀 31

如何進行校準 31

掃描儀狀態 36

管理掃描儀連接 37

網路檢查 38

Medit Link Express > 工作流程

快速導引手冊 42

Express Scan：先掃描，後添加 42

治療掃描 48

步驟1：連接&校準掃描儀 49
步驟 2：選擇患者 49
步驟 3：選擇工作流程 50
步驟4：選擇牙齒或牙顎——修復體&植體掃描 51
步驟 4：選擇牙齒或牙顎——矯正掃描 52
使用現有的Express Scan 53
步驟 5：掃描&檢視 54
步驟 6：訂單 54
步驟7：管理訂單 56
管理患者 59
添加患者 59
編輯和刪除患者資訊 60
管理案例 62
案例狀態 62
檢視和管理案例數據 63
檢視數據 63
添加及檢視附件 64
同步檔案 65
在Web應用程式中開啟案例 65
管理訂單 67
訂購案例 67
選擇列表 70
查看已訂購案例 77
管理訂單 78
工作流程 81
預設工作流程 81
自訂工作流程 82
掃描階段與工具 85
掃描階段 85
工具——編輯 85
修剪 85
鎖定區域 86
倒凹分析 86
工具——手動對齊 87
工具——視圖模式 87

工具 ––網格顯示 88
工具 ––智能掃描檢查 88
工具––高清相機 89

Medit Link Express

製造商資訊 91

簡介

Medit Link Express

專為Medit i900 Series（i900、i900M及i900c）量身打造，Medit Link Express是Medit Link應用程式的精簡版，其整合了Medit Scan for Clinics的核心功能。這款應用程式作為診所的理想解決方案，使牙科專業人員能以最少的操作複雜度執行高品質的數位掃描。在本指南中，「點選」指的是選擇螢幕上的項目。在macOS上，亦包含使用滑鼠或觸控板進行的操作。

預期用途

Medit Link Express是一款用於驅動口內3D掃描器的軟體，旨在以數位方式記錄牙齒及周圍組織的形態特徵。該軟體可產生用於電腦輔助設計和牙科修復物製造的3D掃描數據。牙科診所也可使用該軟體來下單和管理用口內掃描儀獲取的數據。

禁忌症

Medit Link Express並非用於獲取牙齒內部結構或支撐骨性結構的影像。

對操作人員的資格要求

Medit Link Express應由受過訓練的牙科專業人員使用。使用者負責判斷掃描儀對特定患者案例的適用性，並確保所獲得的任何數據之準確性、完整性及充分性。使用者必須驗證結果的準確性及充分性以便進行適當的治療。使用者必須按照使用者指南和注意事項來操作該系統。嚴禁對系統進行任何修改或未經授權的變更，不當使用或處理將導致保固失效。如需更多關於系統正確使用的資訊，請聯絡您當地的經銷商。

符號

編號	符號	描述
1		請閱讀使用者指南
2		請參考使用者指南

編號	符號	描述
3		注意
4		警告
5		憑處方使用（美國）
6		軟體發佈數據
7		生產商
8		重要資訊

概覽

Medit Link Express提供簡易化介面，讓診所能更高效地開始掃描及管理病例。 儀表板將所有必要功能集中於一處——從快速的患者搜尋、經簡化的掃描工作流程，到患者管理與訂單追蹤。

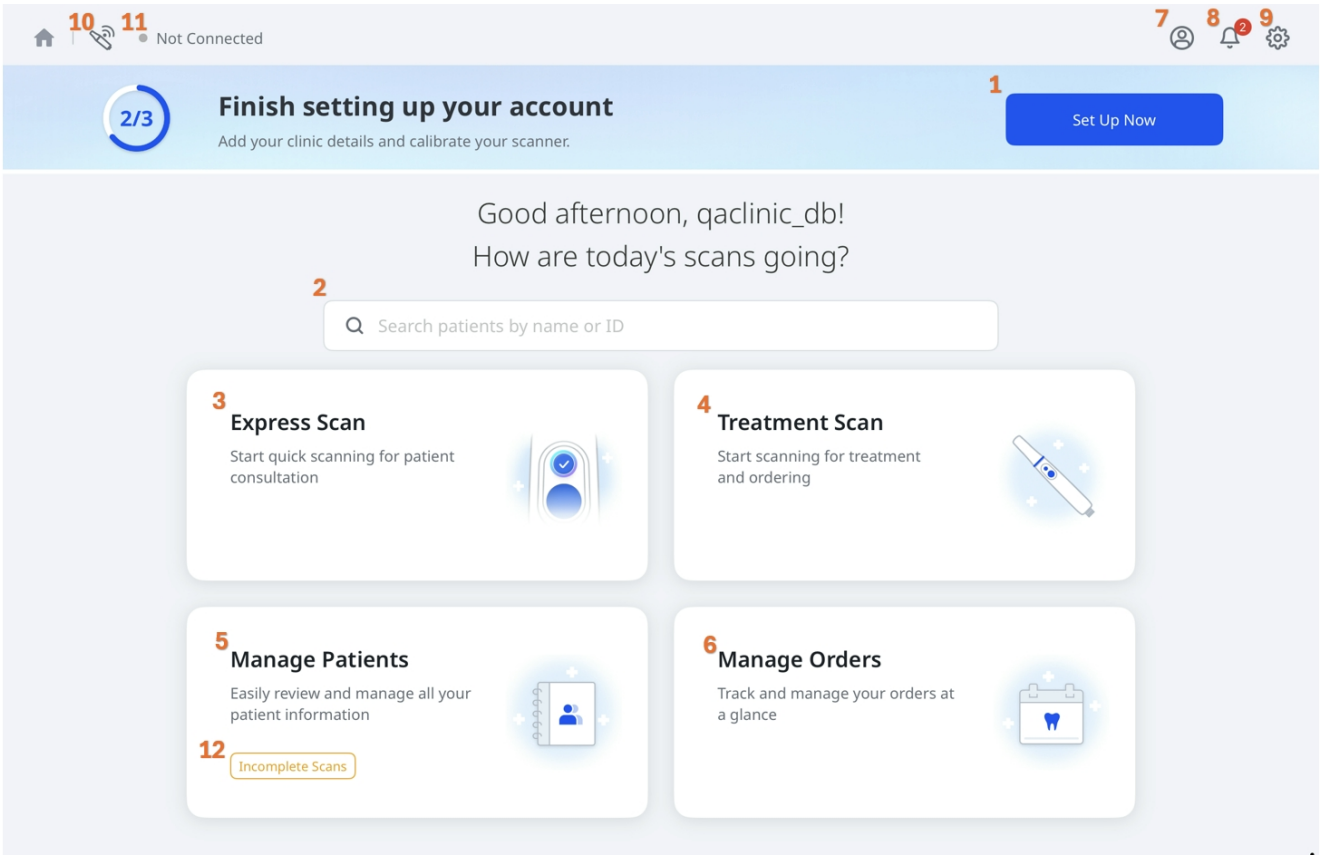

1	立即設定	使用前，請輸入診所詳細資訊並校準掃描儀以完成初始設定。
2	搜尋	在系統內依姓名或ID快速尋找患者。
3	Express Scan	開始快速掃描以進行患者諮詢.
4	治療掃描	開始掃描以用於治療和下單。
5	管理患者	輕鬆檢視並管理患者資訊。
6	管理訂單	追蹤並管理訂單總覽.
7	使用者個人資料	存取並更新您的帳戶資訊。
8	通知	查看警示和重要的系統訊息。
9	設定	自訂應用程式設定，包括掃描儀設定與使用者偏好設定。
10	掃描儀管理器	尋找、連接並管理您的掃描儀。
11	掃描儀狀態	檢查您的掃描儀連線與校準狀態。

12	未完成的掃描	如果掃描中斷（例如應用程式意外關閉），可重新開始或刪除未完成的掃描。 僅在存在未完成的掃描時此選項才顯示。



系統需求與安裝

建議系統配置要求

iPad

裝置	Apple iPad Pro第7代或更新版本
晶片	Apple M4或更新版本
CPU	10-core CPU以上
GPU	10-core GPU或以上
記憶體	16GB或以上
存儲	1TB或以上
作業系統	iPadOS 26.0或更新版本

Mac

晶片	Apple M3或更新版本
CPU	8-core CPU以上
GPU	10-core GPU或以上
記憶體	24GB或更高
作業系統	macOS 15.0 (Sequoia) 或以上

安裝應用程式

從Apple App Store安裝Medit Link Express應用程式。

設定

若要打開**設定**，請在主畫面右上角選取齒輪圖示。

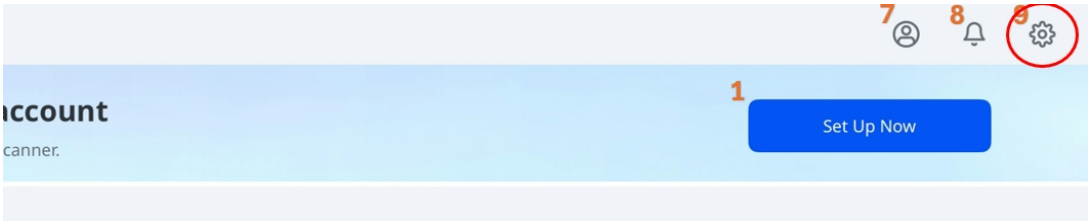

如需可用的設定與功能的詳細資訊，請參閱下表：

> **🔎重要資訊**
>
> 部分設定僅在掃描儀已連接時可用。

Tab	標籤	備註
常規設定	語言	遵循iPad系統設定。點選此選項可打開iPad語言設定。
	牙齒編號系統	設定牙齒編號系統（**US** 或 **FDI**）。
	傳送匿名使用統計數據	啟用將匿名使用統計數據傳送給Medit。 **收集匿名統計數據** Medit會收集匿名診斷與使用數據，包括裝置類型、iOS版本與應用程式效能。這有助於我們在未來發佈的版本中改善產品穩定性與使用者體驗。我們不會收集個人數據（例如您的姓名、聯絡方式或項目詳細資訊），也絕不會嘗試透過這些資訊識別您的身分。
	清除快取	清除裝置上儲存的快取數據以釋放空間。
掃描儀資訊	掃描儀狀態	顯示當前的掃描儀狀態。如需更多資訊，請參閱開始>掃描儀設定> 掃描儀狀態。
	上次校準時間	顯示最近一次校準的日期與時間。
	校正間隔	定義掃描器需要校準的頻率。您可選擇30、60、90、180或365天。 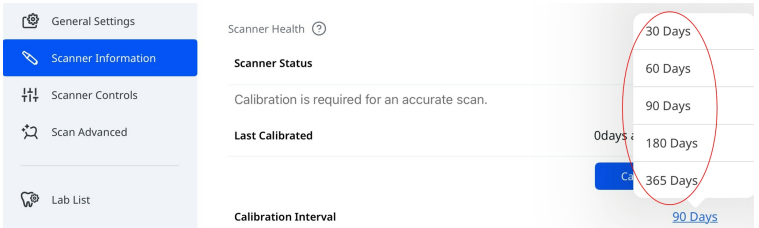
	立即校準	立即開始校準。如需更多資訊，請參閱 *開始 > 掃描儀設定 > 校準掃描儀校準*。
	保固到期日	顯示掃描儀保固的到期日期。
	型號（序號）	顯示掃描儀型號與序號。

Tab	標籤	備註
	電池資訊	顯示電池狀態及重要資訊，例如充電循環次數、電壓、溫度與剩餘電量。
掃描儀設定	開始自動掃描	進入掃描階段時，程式會自動開始掃描程序，無需執行任何操作即可啟動掃描。
	掃描停止時顯示智能箭頭	當數據擷取不足時系統會顯示智慧箭頭。
	燈光顏色	設定掃描儀的LED燈光顏色（**藍色**或**白色**）。
	掃描儀最低溫度通知	在掃描儀溫度低於最低臨界值時啟用通知功能。
	自動打開UV	在掃描儀連線時或掃描停止時，啟用自動打開UV燈功能。
	UV持續時間（分鐘）	設定**自動打開UV**選項的時間長度。可選擇1、3、5、10或30分鐘。 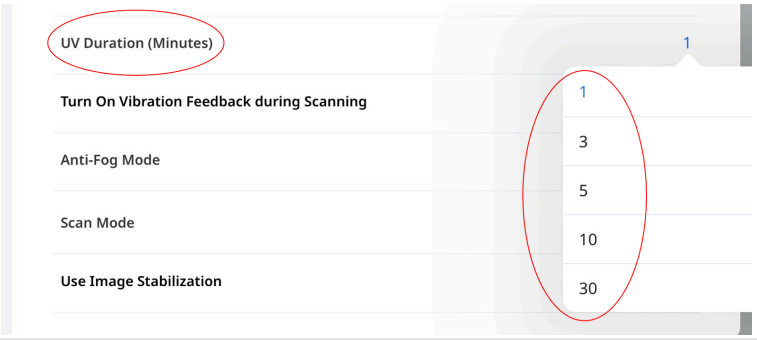
	掃描時打開震動反饋	在掃描期間偵測到未對齊時提供震動回饋。
	防霧模式	設定風扇模式以防止在低溫時鏡片起霧。選項：**靜音**或**加強**。
	掃描模式	設定掃描模式。您可以選擇**穩定**、**自動**或**性能**模式。
	自適FPS模式	自動調整掃描幀率（FPS），以維持流暢穩定的性能。若停用該功能，可能會出現FPS波動。
	使用影像穩定功能	在掃描期間啟用自動影像穩定功能，以獲得更清晰且更穩定的影像。
	進階網路搜尋	將搜尋範圍擴展至更廣的網路區域，以尋找未自動偵測到的掃描儀。
	音訊反饋	提供音訊反饋以指示掃描儀狀態。
	按鈕與觸控操作	**i900 Mobility&i900 classic** 設定掃描按鈕的按一下、按兩下及長按操作。可選操作包括 **開始/停止掃描**、**下一階段**、**上一階段**、***游標控制（Air Mouse）** 以及 **無**。 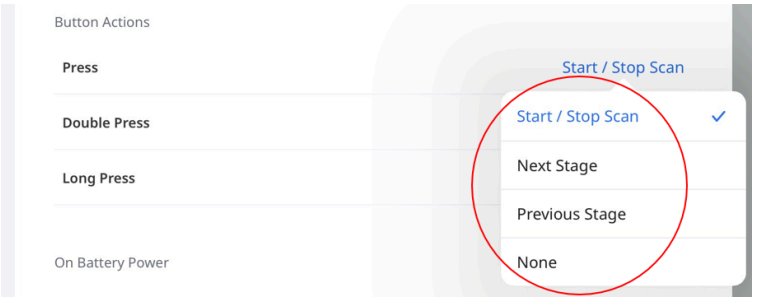

<table>
<tr><th>Tab</th><th>標籤</th><th>備註</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td>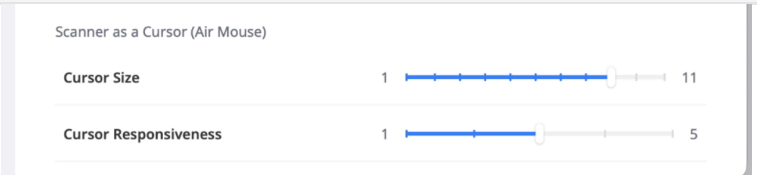

i900
設定觸控手勢與菜單按鈕的操作。點選一個項目，即可從列表中選擇一項操作。
可用操作會依手勢不同而有所差異。
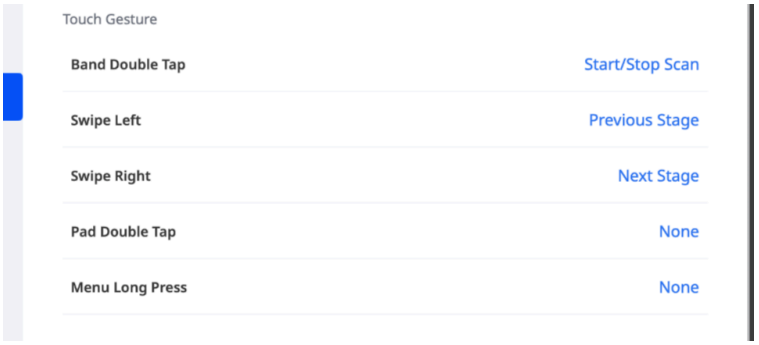

*游標控制（Air Mouse）
游標控制（Air Mouse）可讓您透過移動掃描儀來移動游標，而無需觸碰螢幕。依不同型號，可將其分配為以下操作：
• i900 classic：
－按兩下
• i900
－觸控板－－點兩下
－菜單按鈕－－長按</td></tr>
<tr><td>休眠時間設定</td><td></td></tr>
<tr><td>自動關閉電源（進入「睡眠模式」後）</td><td>時。</td></tr>
<tr><td>進階掃描設定</td><td colspan="2">如需進階掃描選項，請參閱Medit Scan for Clinics使用者指南中「設定」下的「掃描性能與後期處理」。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">數據& 儲存</td><td>自動上傳原始數據</td><td>自動將原始掃描數據上傳至雲端。此功能可備份原始數據，並透過相同的Medit Link Express帳號，在其他裝置上無縫進行掃描。</td></tr>
<tr><td>本機存儲空間</td><td>顯示裝置上儲存的掃描數據量，包括：
• 原始數據
• 結果檔案&附件
點選管理本機儲存 以：
• 查看詳細的儲存空間使用情況
• 依選定條件刪除儲存數據（例如刪除早於特定時期的數據）</td></tr>
<tr><td>雲端儲存空間</td><td>顯示目前的雲端儲存計畫及空間使用情況。
點選管理雲端儲存 以開啟Medit Link網頁應用程式，您可在其中查看儲存計畫詳細資訊並管理您的訂閱。</td></tr>
<tr><td>我的技工所</td><td></td><td>顯示您曾與其有過互動的技工所（曾向其提出或接收過邀請），以及其目前的連線狀態。</td></tr>
</table>

Tab	標籤	備註
		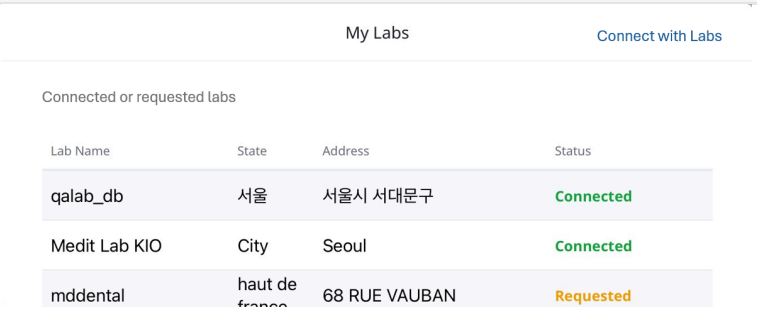 **連線狀態** • **請求已發送**——您已向技工所發送連線請求。 • **已連線**—— 該技工所已接受您的請求且連線已啟用。 • **請求已收到**——技工所已向您發送連線邀請。回覆方式： 1. 點選技工所旁的狀態標籤。  2. 在**連線至技工所**視窗中，點選右上角的**接受**或**拒絕**。 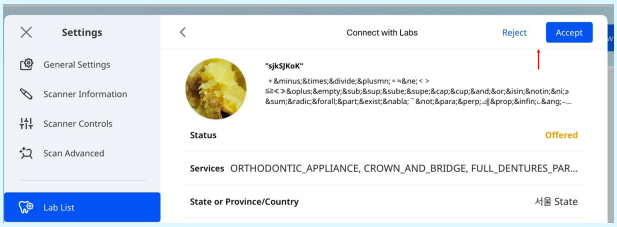 • **已中斷連線** ——您已拒絕該技工所的請求或邀請。 若要選擇某一技工所並傳送合作請求，請遵循下列步驟： 1. 在**我的技工所**視窗右上角點選**連線至技工所**。 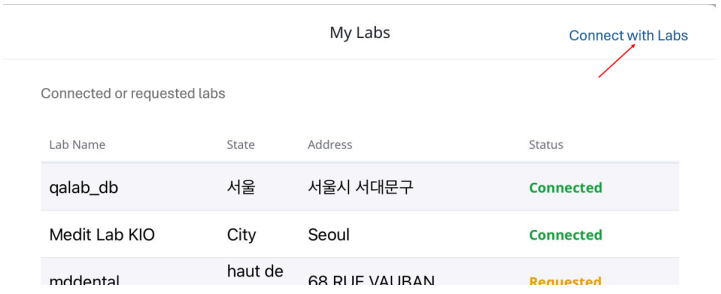 2. 從列表中選擇某一技工所，然後點選**發送請求**。  3. 在**發送請求** 彈出視窗中，點選**發送**以確認您的請求。 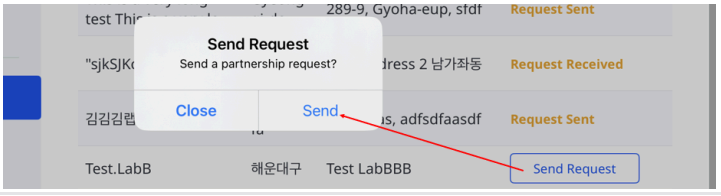

Tab	標籤	備註
應用程式設定	版本	顯示當前應用程式版本。
	Web應用程式	控制開啟案例或完成掃描時可使用的Web應用程式。 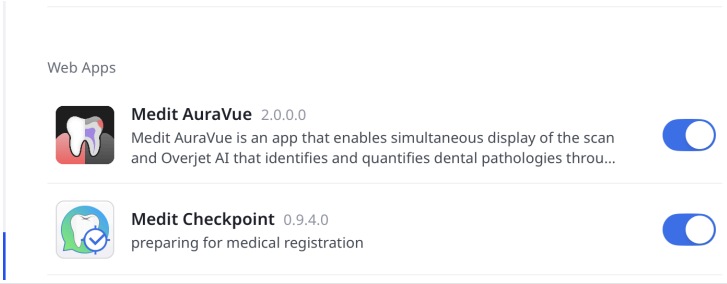
公告		顯示應用程式中的更新與公告。
獲取幫助		允許您直接從應用程式提交支援請求。如需其他資源，您也可以造訪 Medit幫助中心。

註冊&登入/登出

註冊

若要存取Medit Link Express，請依照以下步驟註冊會員：

1. 在登入頁面點選**創建新賬戶**。

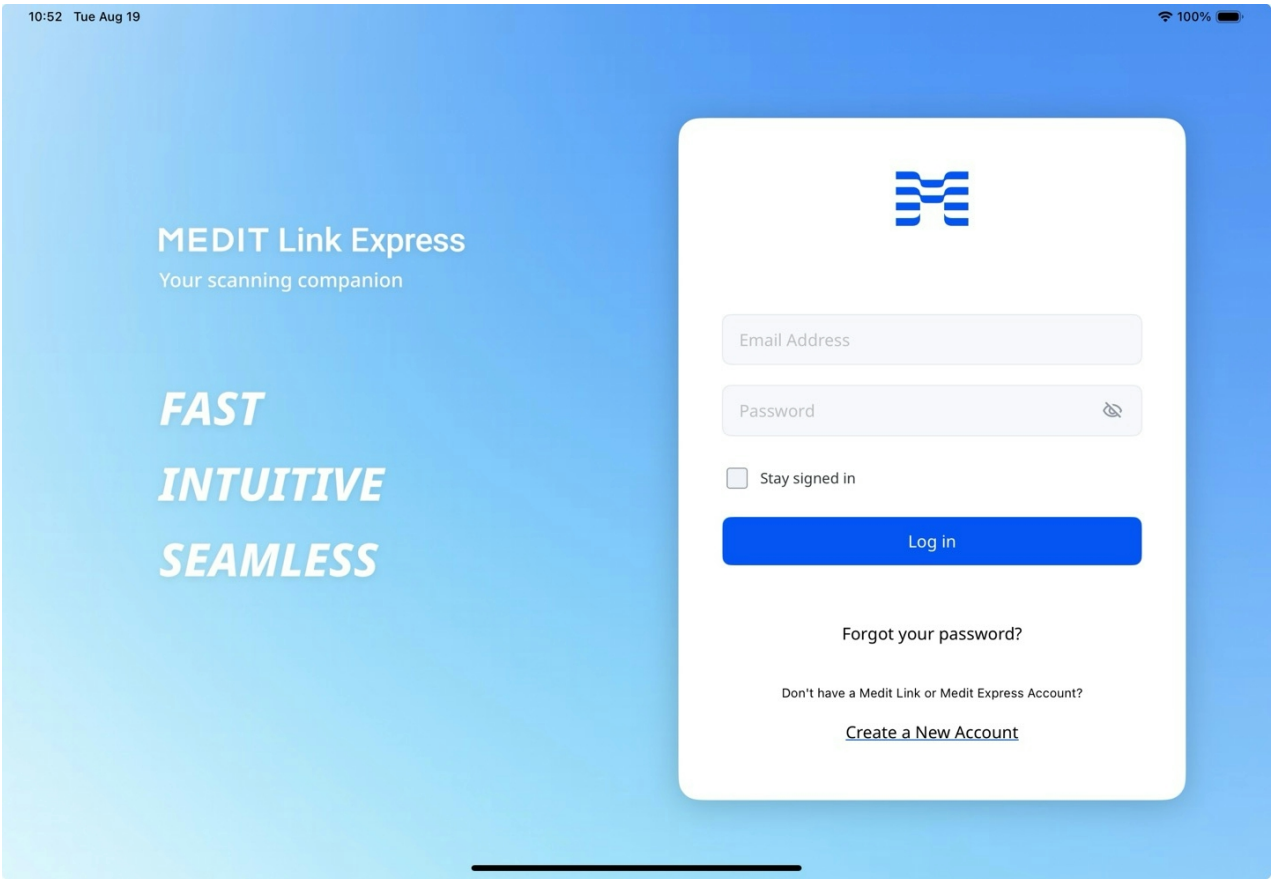

2. 依下列順序填寫註冊表單，然後點選**提交**。 密碼長度須為8-16個字元，至少包括一個從A到Z的大寫或小寫字母、一個數位以及一個特殊字元。

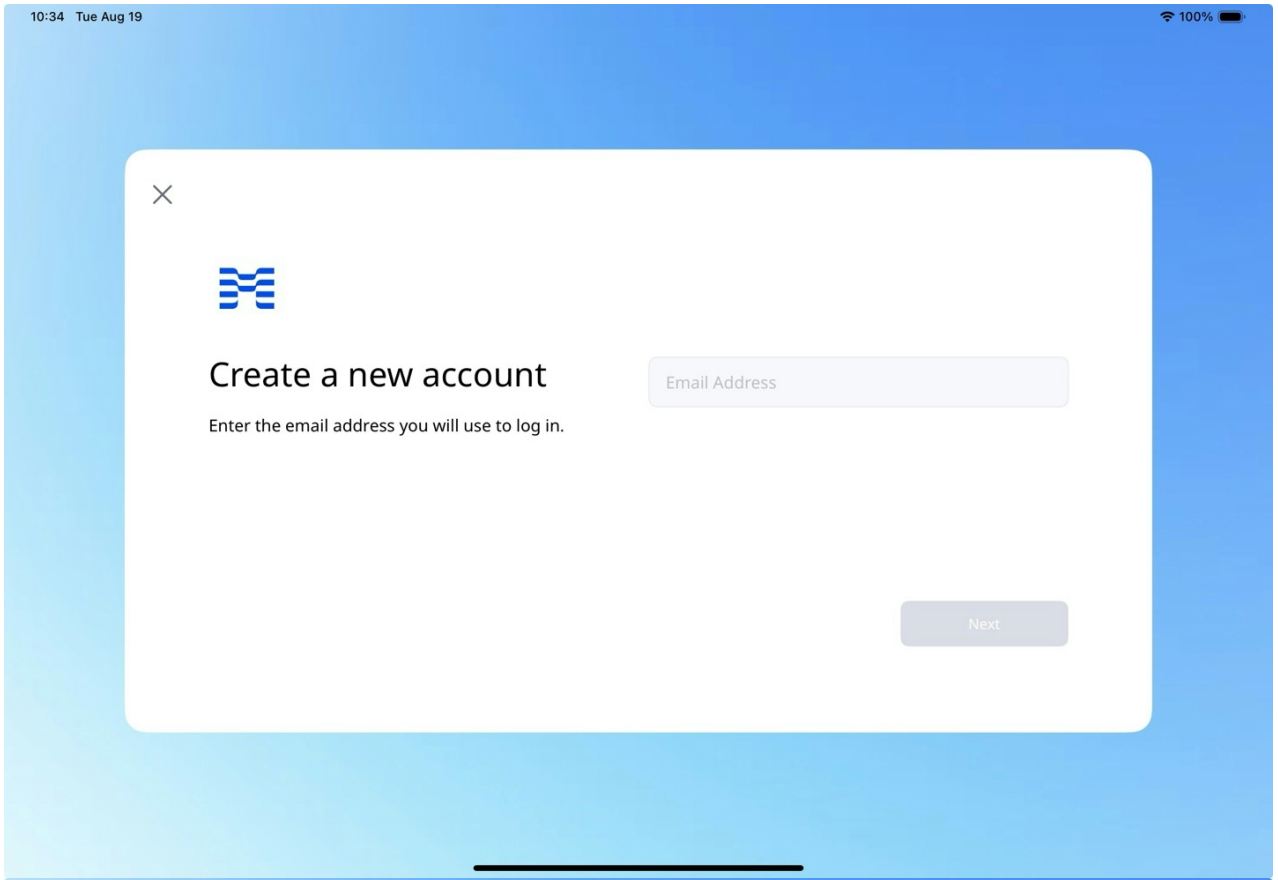
10:34 Tue Aug 19
100%
Create a new account
Enter the email address you will use to log in.
Email Address
Next

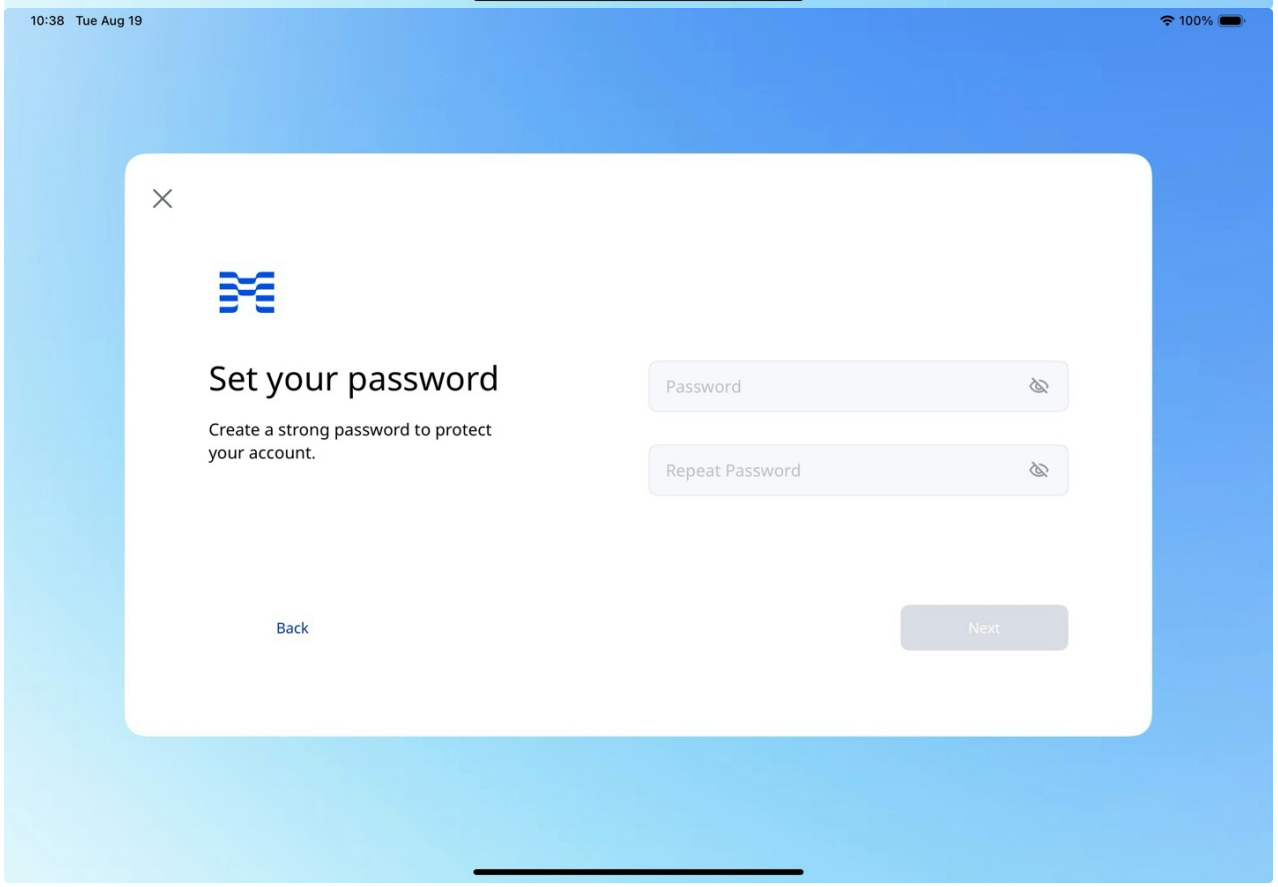
10:38 Tue Aug 19
100%
Set your password
Create a strong password to protect your account.
Password
Repeat Password
Back
Next

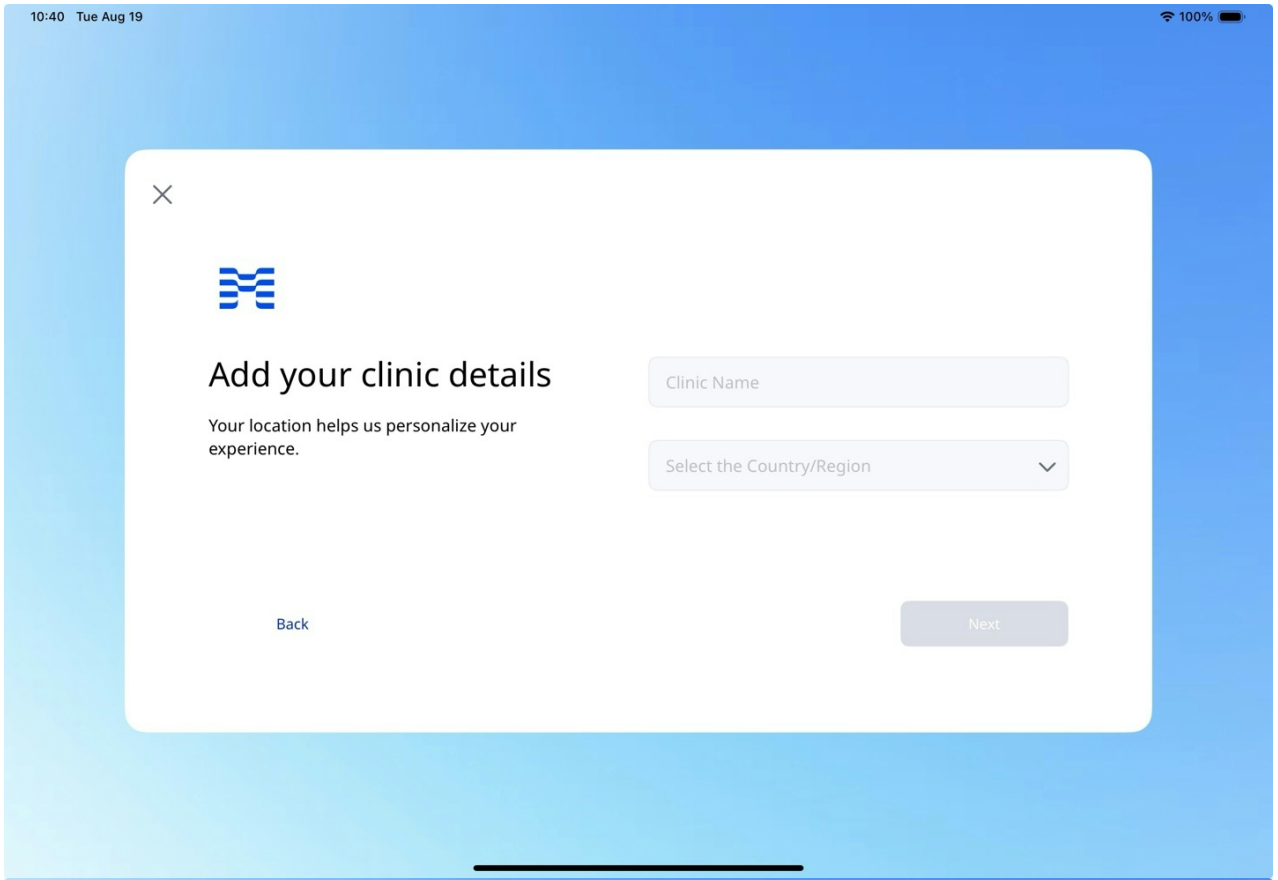
10:40 Tue Aug 19
100%
Add your clinic details
Your location helps us personalize your experience.
Clinic Name
Select the Country/Region
Back
Next

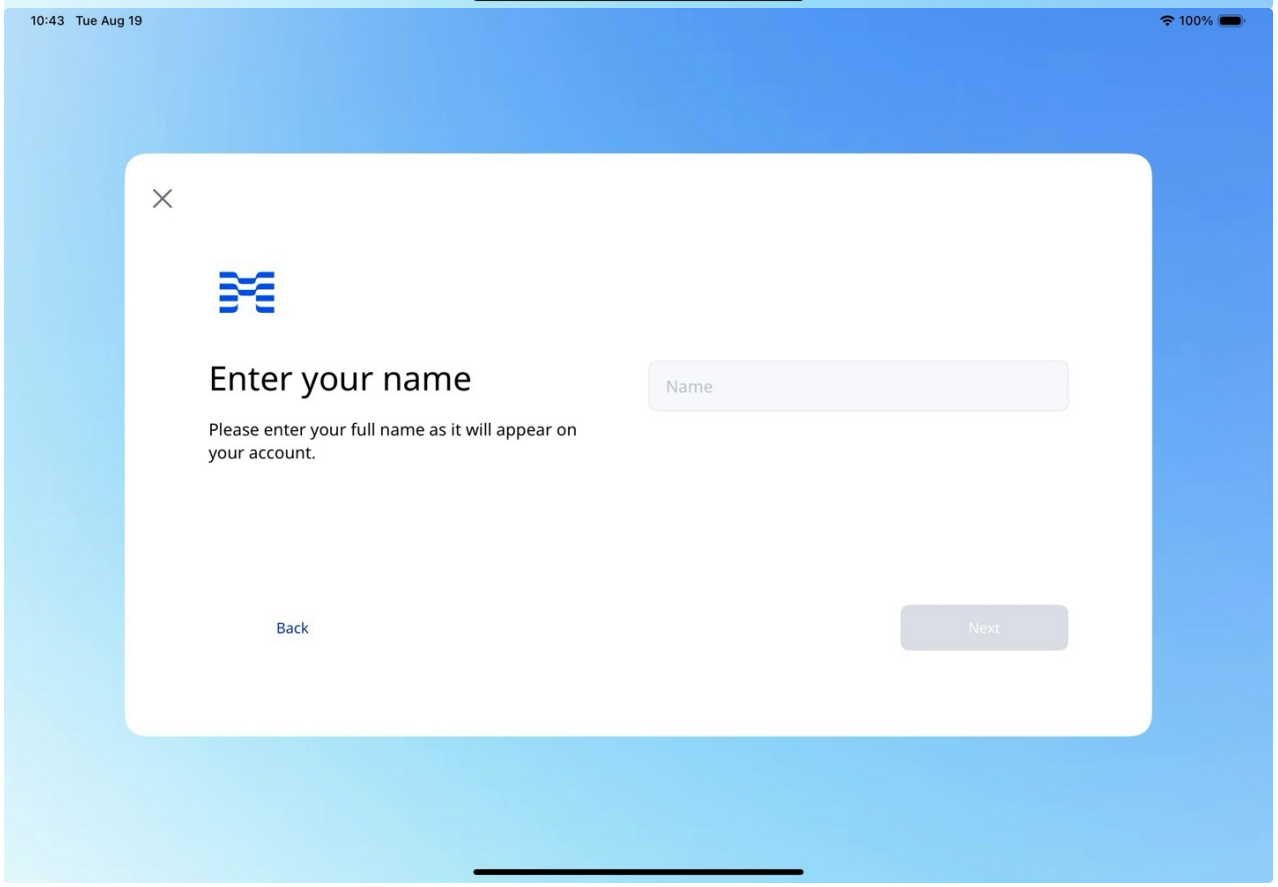
10:43 Tue Aug 19
100%
Enter your name
Please enter your full name as it will appear on your account.
Name
Back
Next

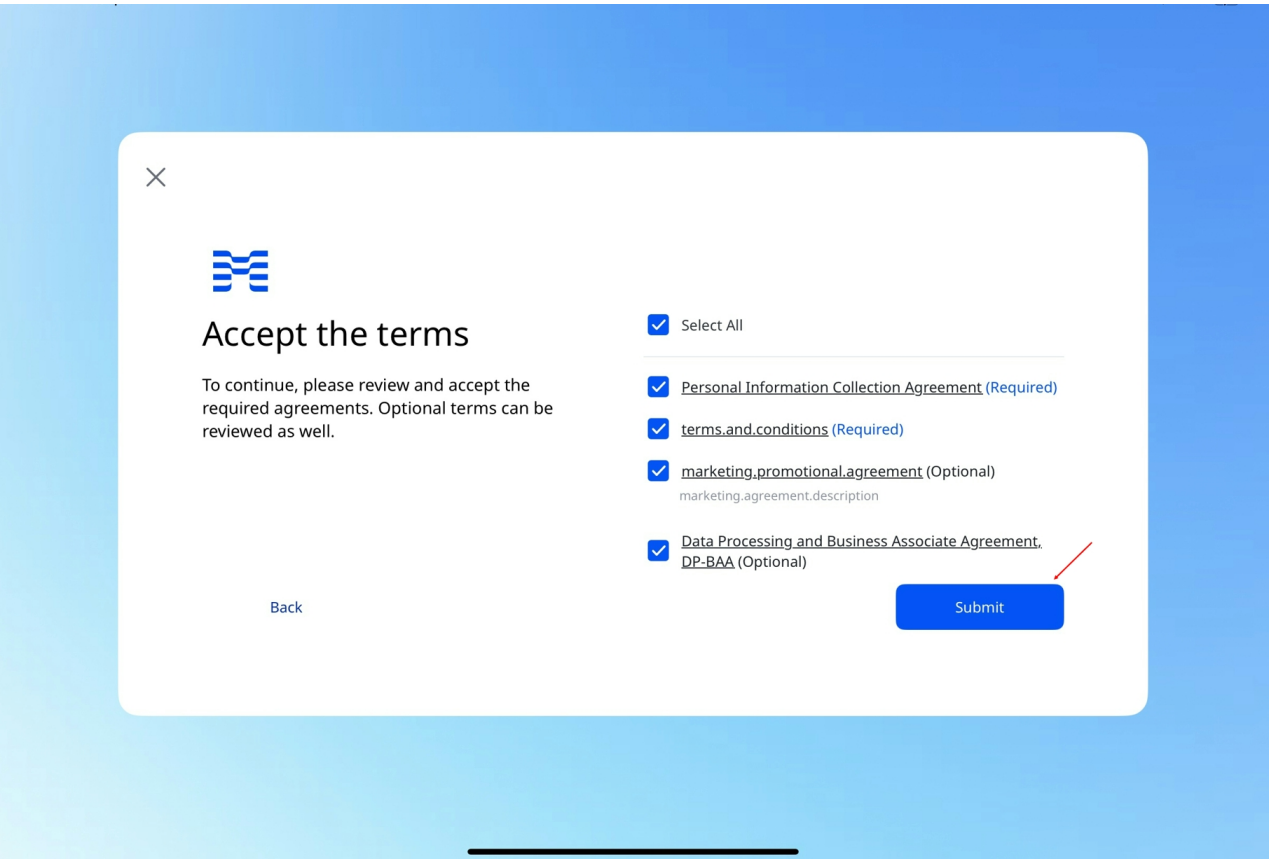

> 🔎**重要資訊**
>
> - 僅能建立「診所 - 管理員」賬戶。 點選**Medit Link**以進一步了解我們的賬戶類型。
> - 如您在註冊過程中同意接收行銷資訊，那麼您隨後便將從Medit收到有關產品及服務的實用資訊。

3. 我們將向您發送一封驗證電子郵件。
4. 使用收到的連結驗證您的電子郵件地址，以完成註冊流程。

登入/登出

1. 您可以使用新賬戶或現有的Medit Link賬戶（僅限「診所- 管理員」）登入。 勾選**保持登入狀態**核取方塊，以保存您的登入資訊並維持登入。

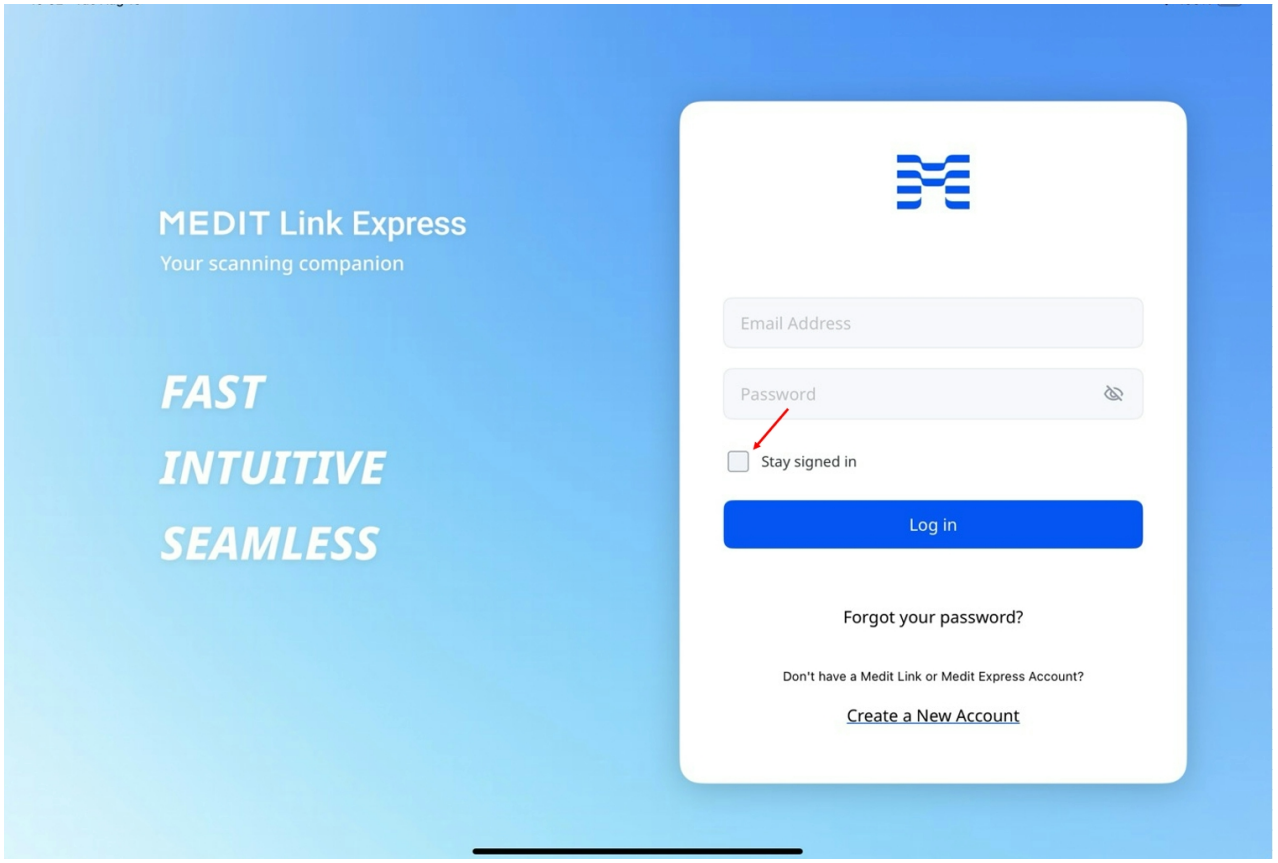

2. 若要登出，請在主畫面右上角點選個人資料圖示，然後在**診所資料**面板中選擇**登出**。

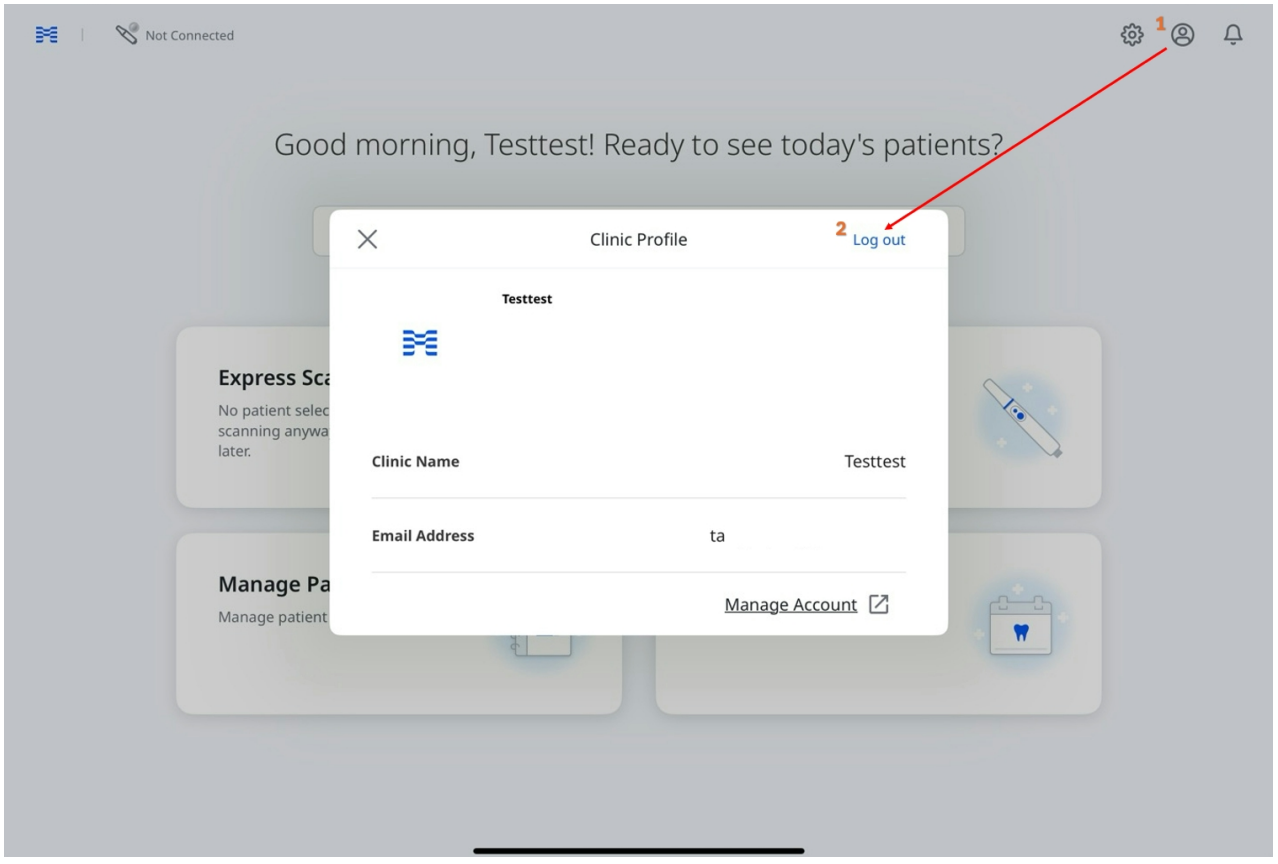

掃描儀設定

掃描儀連接

Medit Link Express支援透過無線（直接或透過集線器）及USB方式與相容的掃描儀進行連接。
連接類型會依型號與平台而有所不同：

- **無線**：適用於i900 Mobility（iPad與Mac）
- **USB**：適用於i900 與i900 classic（Mac）

無線連接（直接）

Medit Link Express可透過Wi-Fi網路或iPad個人熱點，自動偵測並與Medit i900 Mobility配對。連接前，請確保掃描儀已開啟電源：

1. 將電池插入機身底部，然後按一下電源按鈕。

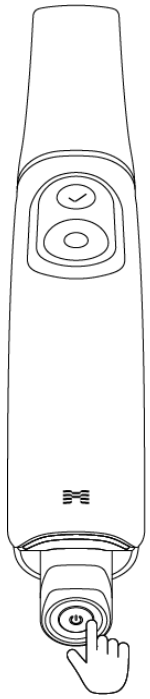

2. 接通電源後，後方兩個LED指示燈會亮起：靠近Medit「M」標誌的指示燈會以淡灰色閃爍，而電池底部的另一個指示燈則為恆亮藍色。

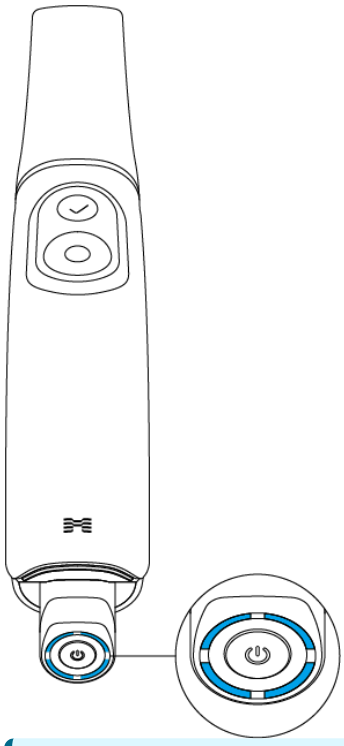

🔎重要資訊

電池電量表上的4個LED燈表示電池剩餘電量：

- 4個LED燈亮起：75%-100%
- 3個LED燈亮起：50%-74%
- 2個LED燈亮起：25%-49%
- 1個LED燈亮起：12%-24%
- 1個LED燈閃爍：1-12%
  * 當電池插入機身時，若電量介於1%至12%，指示燈會閃爍。不過，在單獨檢查或放入充電器時，指示燈將保持穩定，只有1個LED燈表示1-12%的充電範圍。
- 無LED燈亮起：0%

3. 在主畫面中，點選左上角的 **掃描儀管理器**圖示。

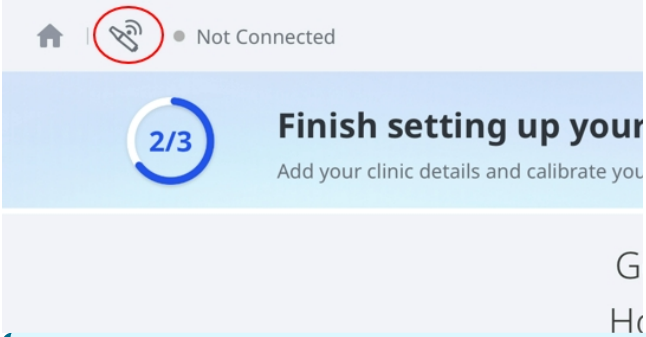

🔎重要資訊

您也可以使用以下方式存取「掃描儀管理器」：

• 點選左上角的**未連接**，然後在彈出視窗中點選**連接**。

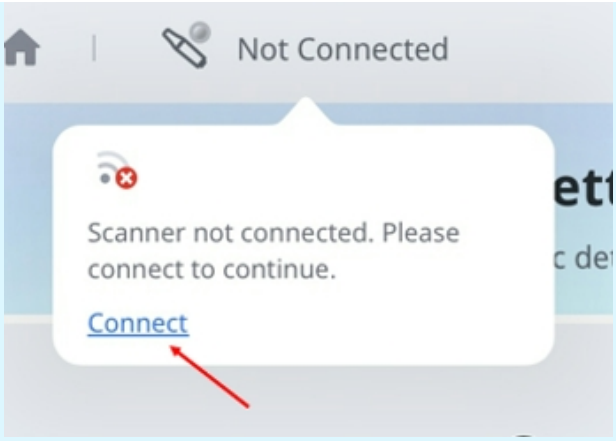

• 在主畫面點選 **立即設定**，然後在 **開始** 對話框中再次點選 **立即設定**。

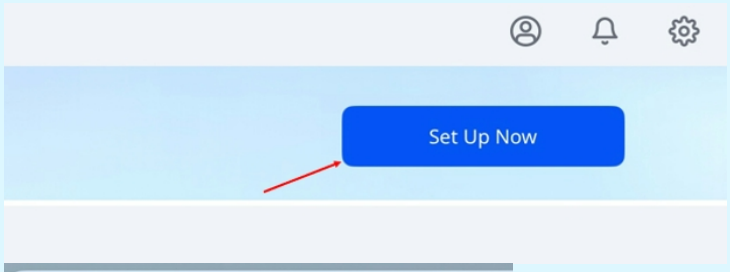

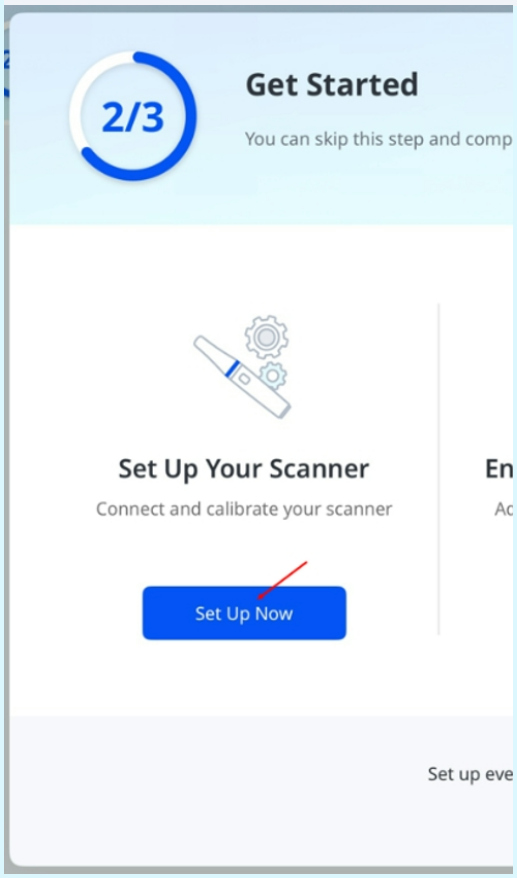

4. 在 **掃描儀管理器** 中，選擇與您的序號相符的掃描儀，然後點選**連接**。序號位於機身背面靠近底部的位置。

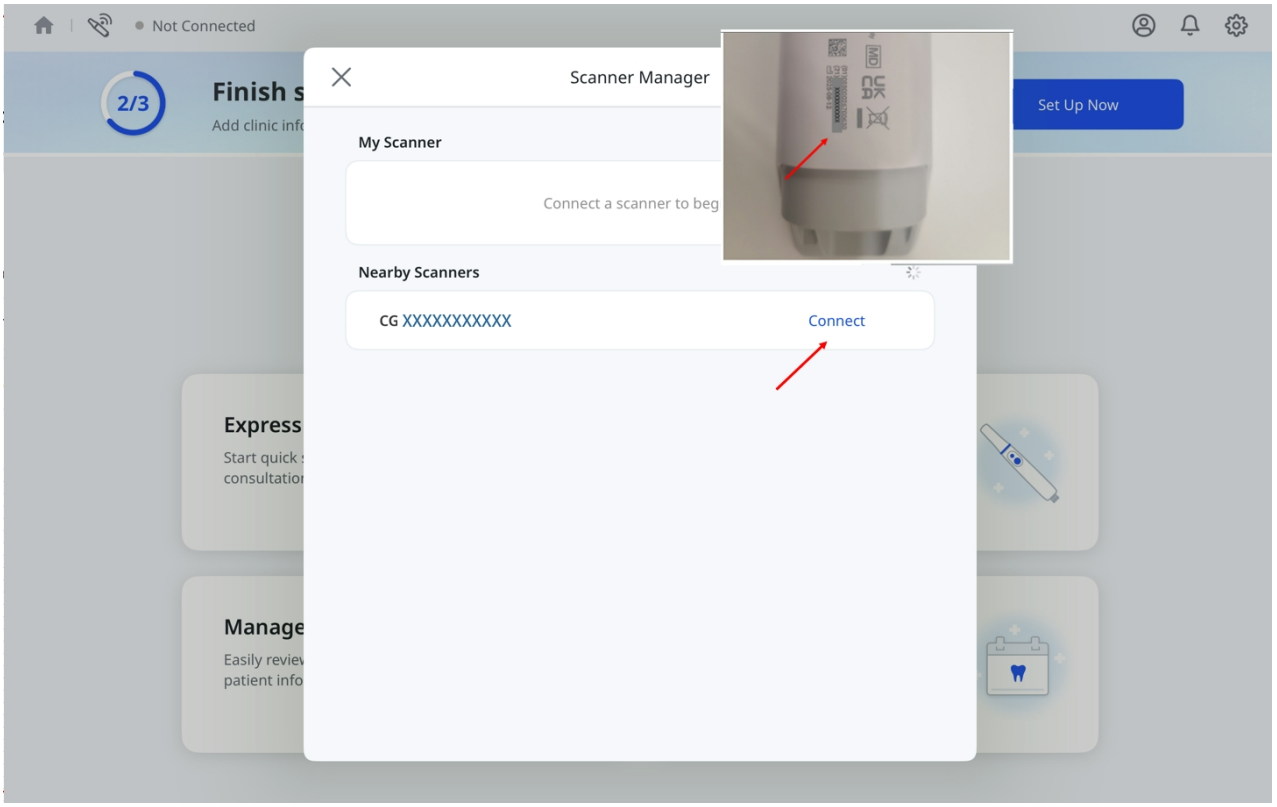

5. 輸入當前Wi-Fi網路的密碼，然後點選**確定**。

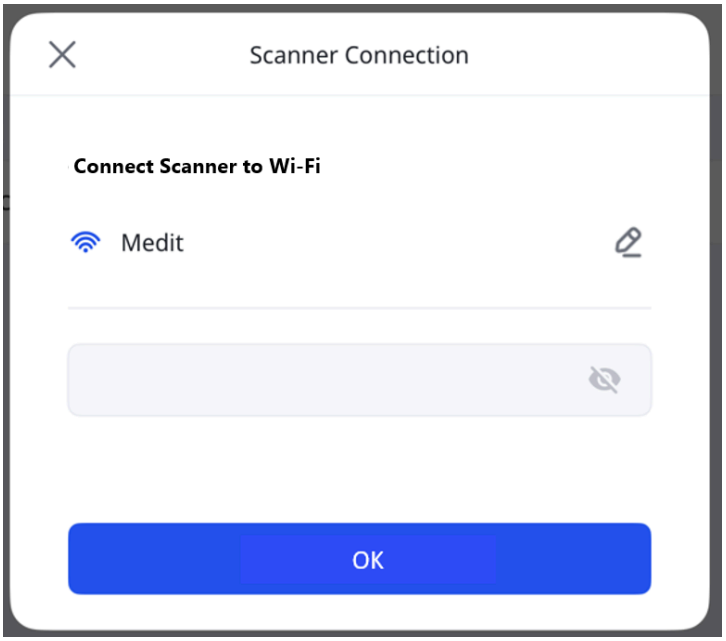

6. 當掃描儀連接後，旁邊會顯示 **斷開連接**按鈕。

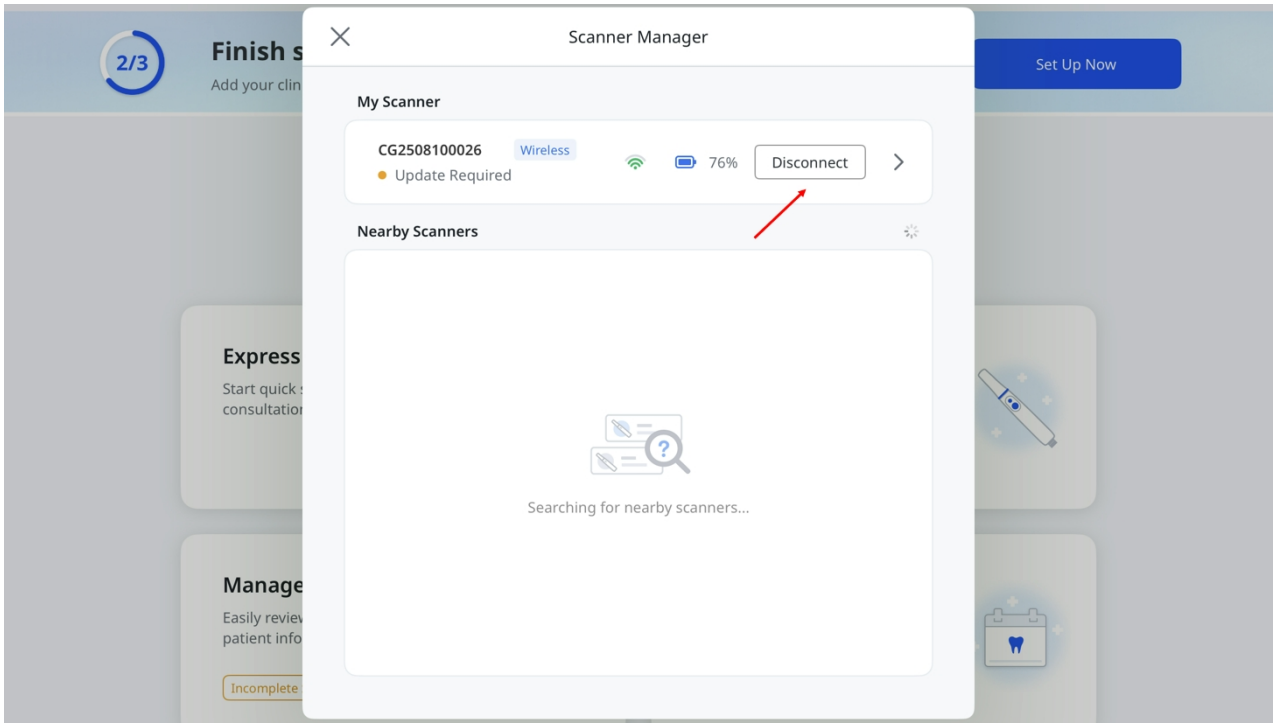

🔎重要資訊

- 若掃描儀已連接至其他裝置，可從 **附近掃描儀** 或 **我的掃描儀**中選擇以進行連接。此操作將斷開掃描儀與其他裝置之間的連接。
  當掃描儀正在其他裝置上進行掃描或更新韌體時，無法進行連接。

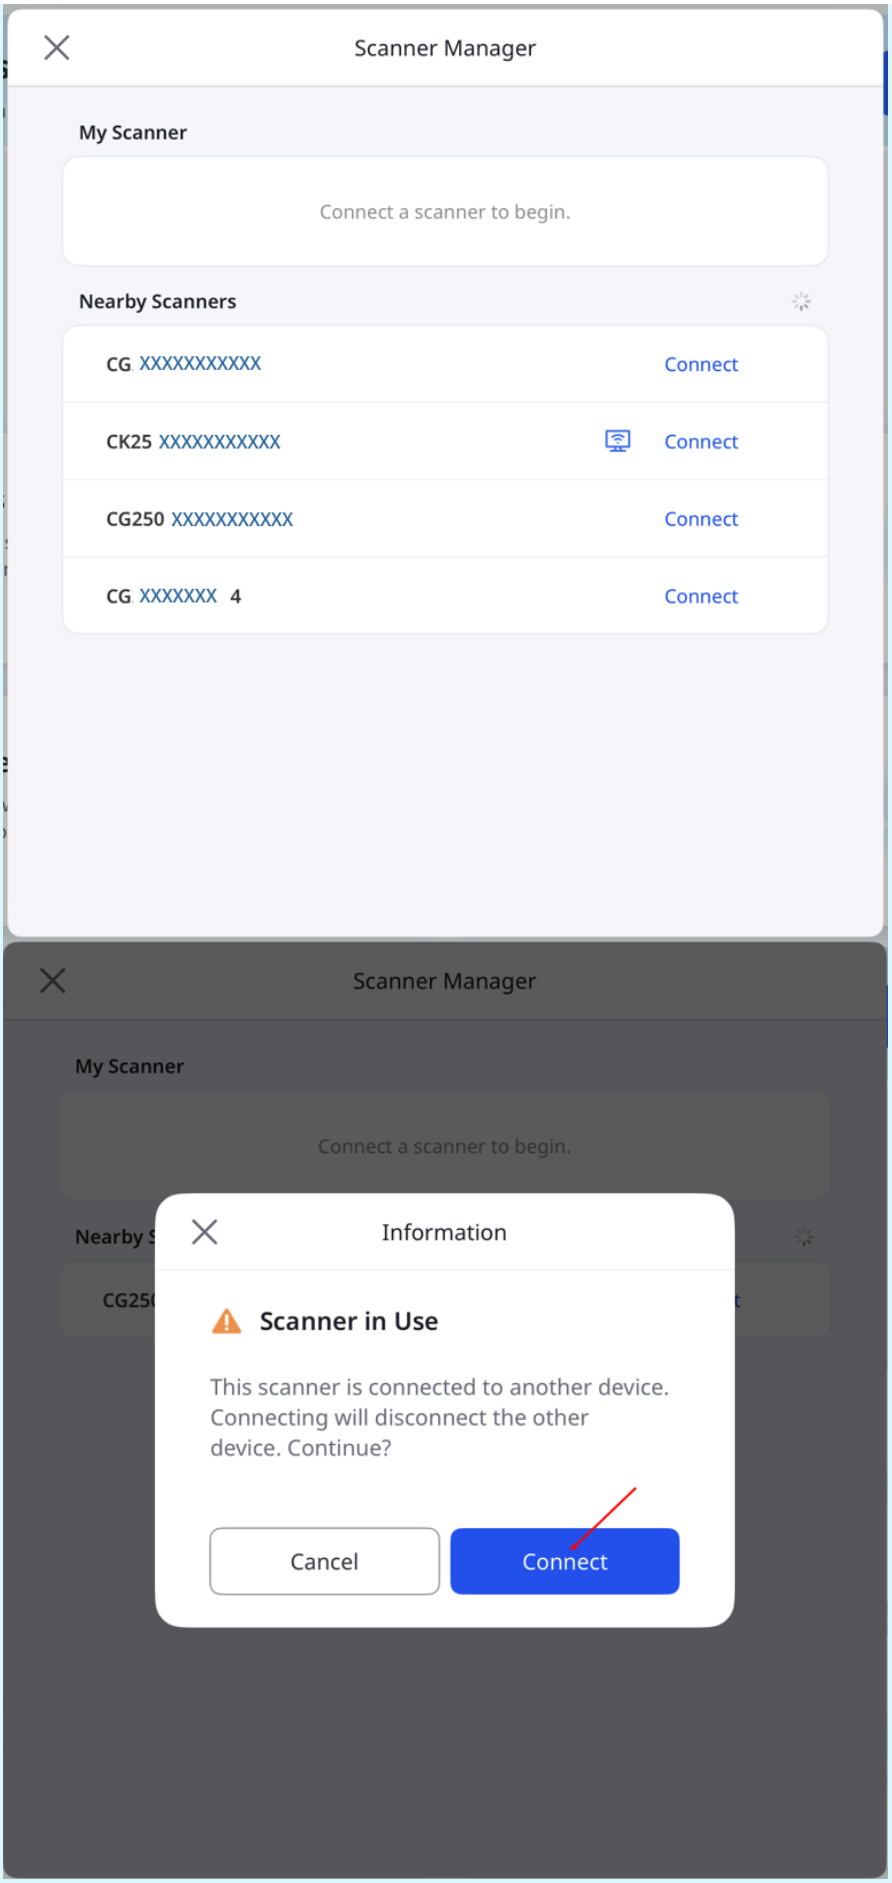

- 若無法使用Wi-Fi，可使用 **個人熱點**來連接掃描儀。
  - 在iPad上開啟 **行動數據**並啟用 **個人熱點**。
  - 將掃描儀連接至iPad上顯示的熱點網路。

■ 關閉 **最大化相容性**以獲得最佳性能。
**此選項僅適用於支援行動數據的iPad。

無線連接（集線器）

Medit Link Express可透過集線器連接至受支援的無線掃描儀，作為直接無線連接的替代方案。連接前，請確保掃描儀已開啟電源：

🔎重要資訊

請確保已使用i900 Mobility掃描儀隨附的電源輸送線將集線器連接至您的裝置。

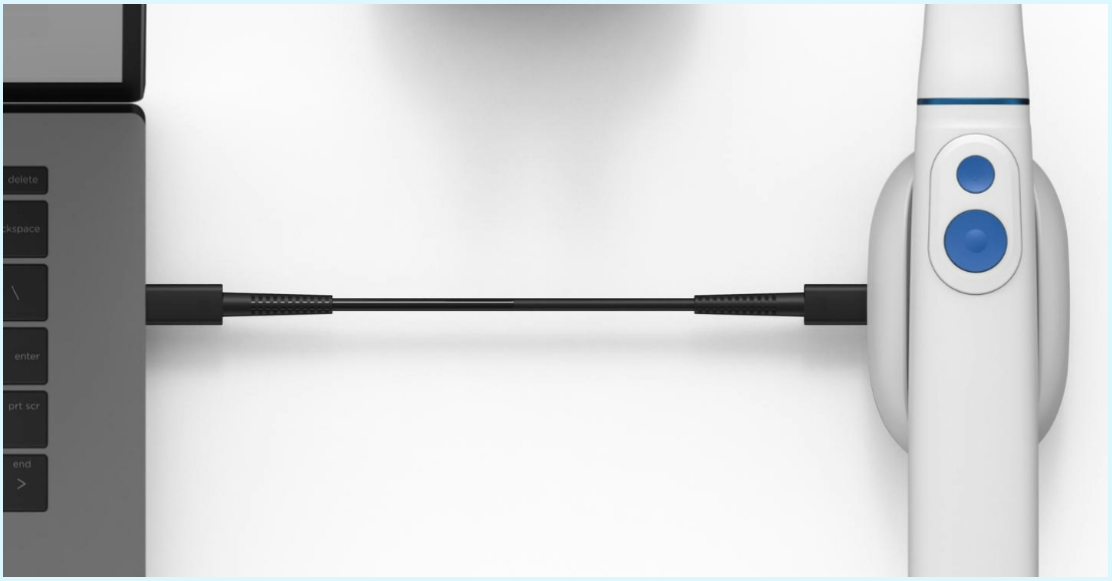

1. 將電池插入機身底部，然後按一下電源按鈕。

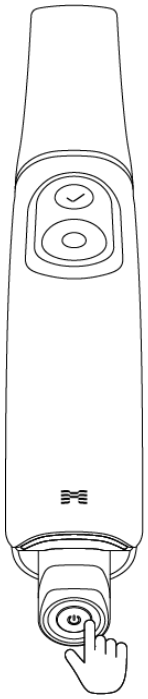

2. 接通電源後，後方兩個LED指示燈會亮起：靠近Medit「M」標誌的指示燈會以淡灰色閃爍，而電池底部的另一個指示燈則為恆亮藍色。

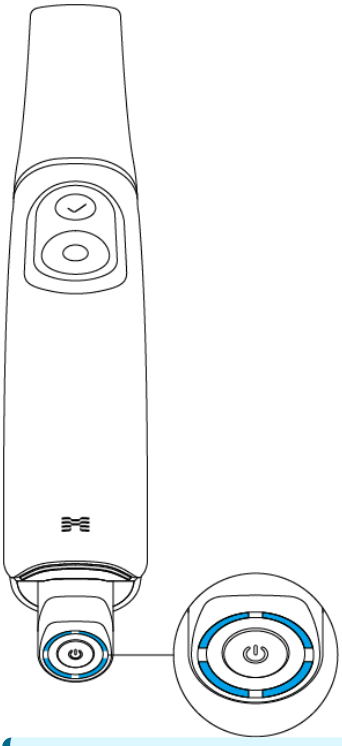

> 🔎**重要資訊**
>
> 電池電量表上的4個LED燈表示電池剩餘電量：
>
> - 4個LED燈亮起：75%-100%
> - 3個LED燈亮起：50%-74%
> - 2個LED燈亮起：25%-49%
> - 1個LED燈亮起：12%-24%
> - 1個LED燈閃爍：1-12%
>
> * 當電池插入機身時，若電量介於1%至12%，指示燈會閃爍。不過，在單獨檢查或放入充電器時，指示燈將保持穩定，只有1個LED燈表示1-12%的充電範圍。
> - 無LED燈亮起：0%

3. 在主畫面中，點選左上角的 **掃描儀管理器**圖示。

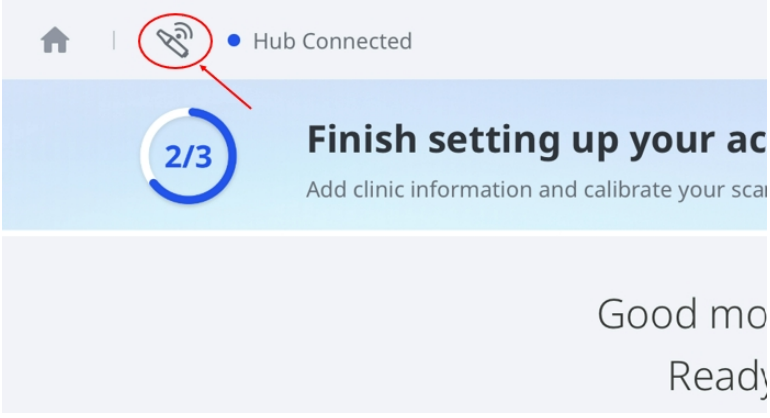

🔎重要資訊

您也可以使用以下方式存取「掃描儀管理器」：

· 點選左上角的 **集線器已連接**，然後在彈出視窗中點選 **連接**。

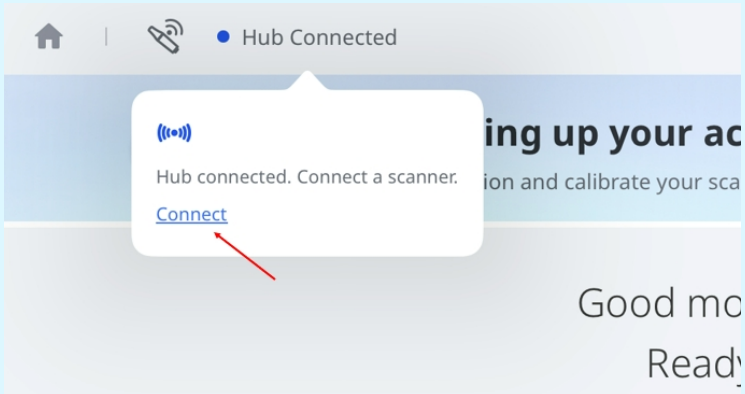

• 在主畫面點選 **立即設定**，然後在 **開始** 對話框中再次點選 **立即設定**。

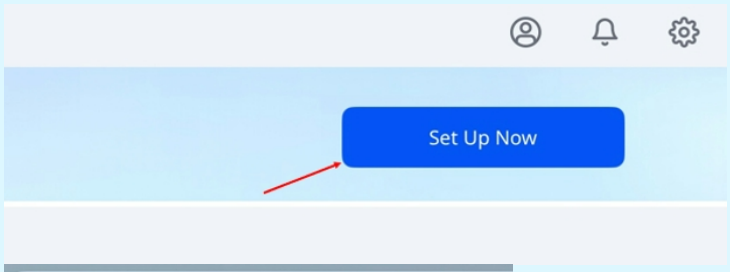

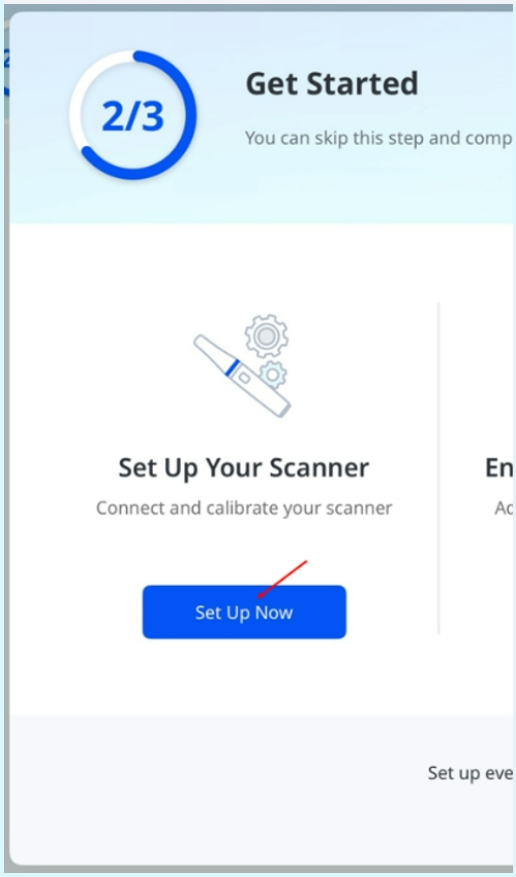

4. 在 **掃描儀管理器** 中，點選您掃描儀旁邊的 **連接**。

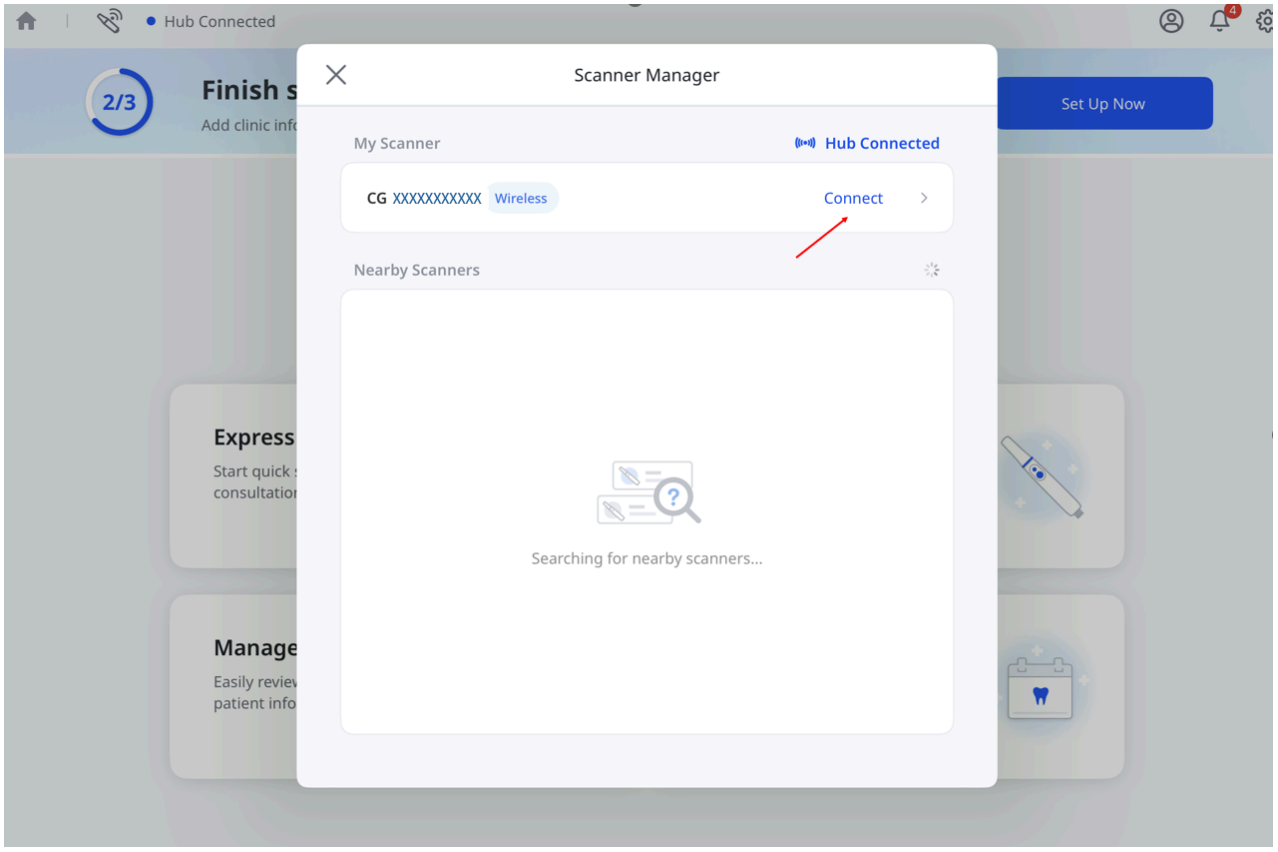

5. 當掃描儀連接後，旁邊會顯示 **斷開連接**按鈕。

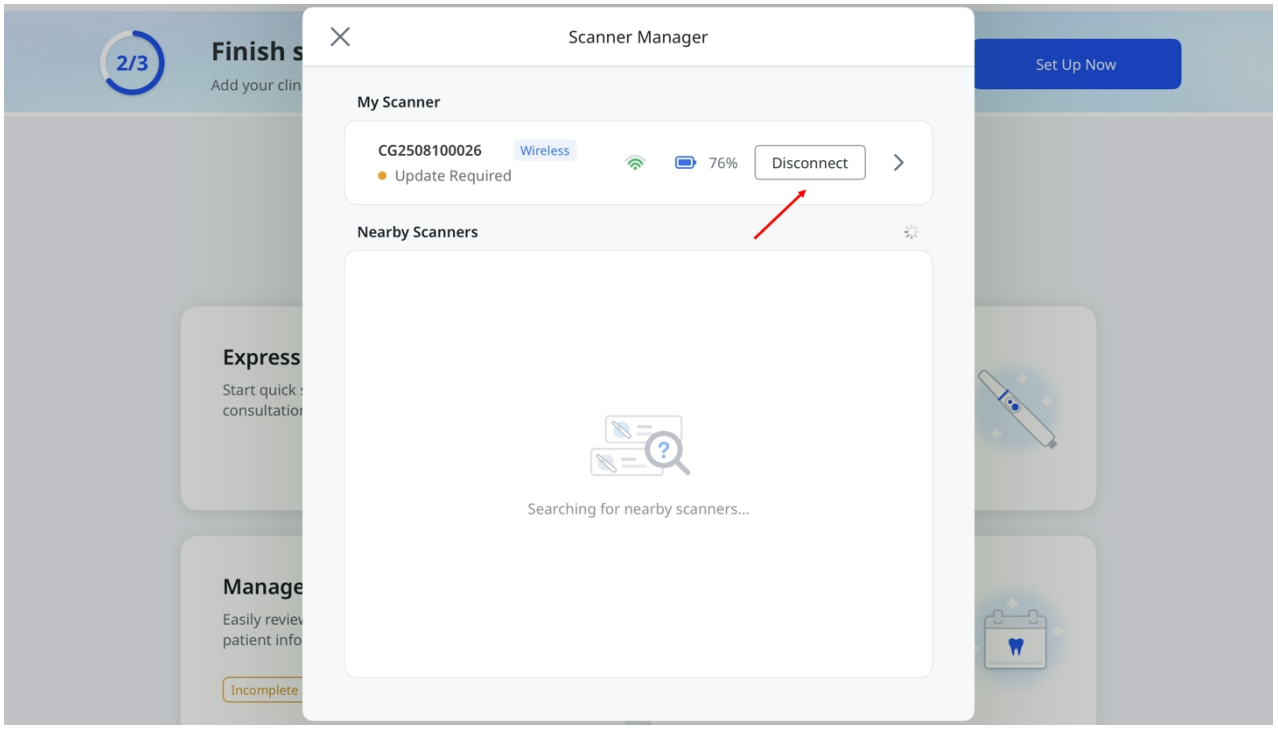

USB連接

Medit Link Express支援透過USB與Medit i900與i900 classic進行連接。在應用程式運行期間，使用專用連接線將掃描儀連接至您的Mac。
開始掃描前需具備有效授權。

校準掃描儀

> 🔎**重要資訊**
> 建議定期對掃描儀進行校準。

定期校準有助於維持掃描準確性與裝置效能穩定性。

在以下情況對掃描儀進行校準：

- 掃描數據品質低於先前的掃描
- 使用過程中外部條件（例如裝置溫度）發生變化
- 使用者自訂的校準間隔已到期

當校準與掃描時的掃描儀溫度相近時，校準會更準確。

校準前，讓掃描器預熱至工作溫度。

如何進行校準

1. 請確保掃描儀狀態顯示**需要校準**，然後點選它。



2. 出現彈出訊息時，點選**開始校準**。

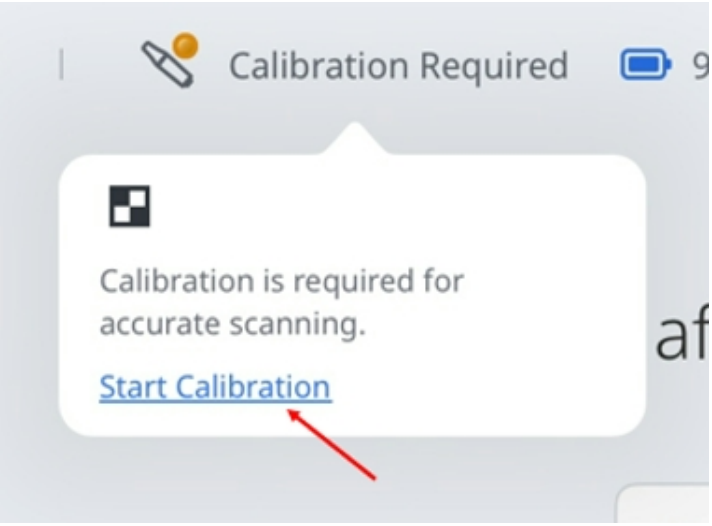

3. 或前往**設定** > **掃描儀資訊**，然後點選**立即校準**。

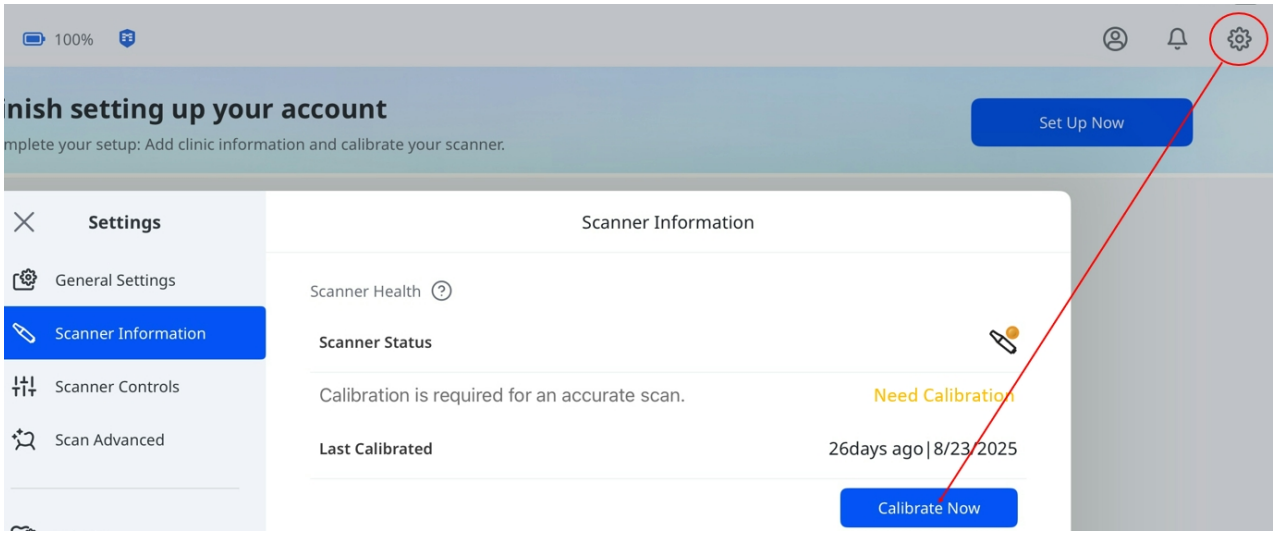

4. 準備好校準器，點選**下一步**以開始校準流程。

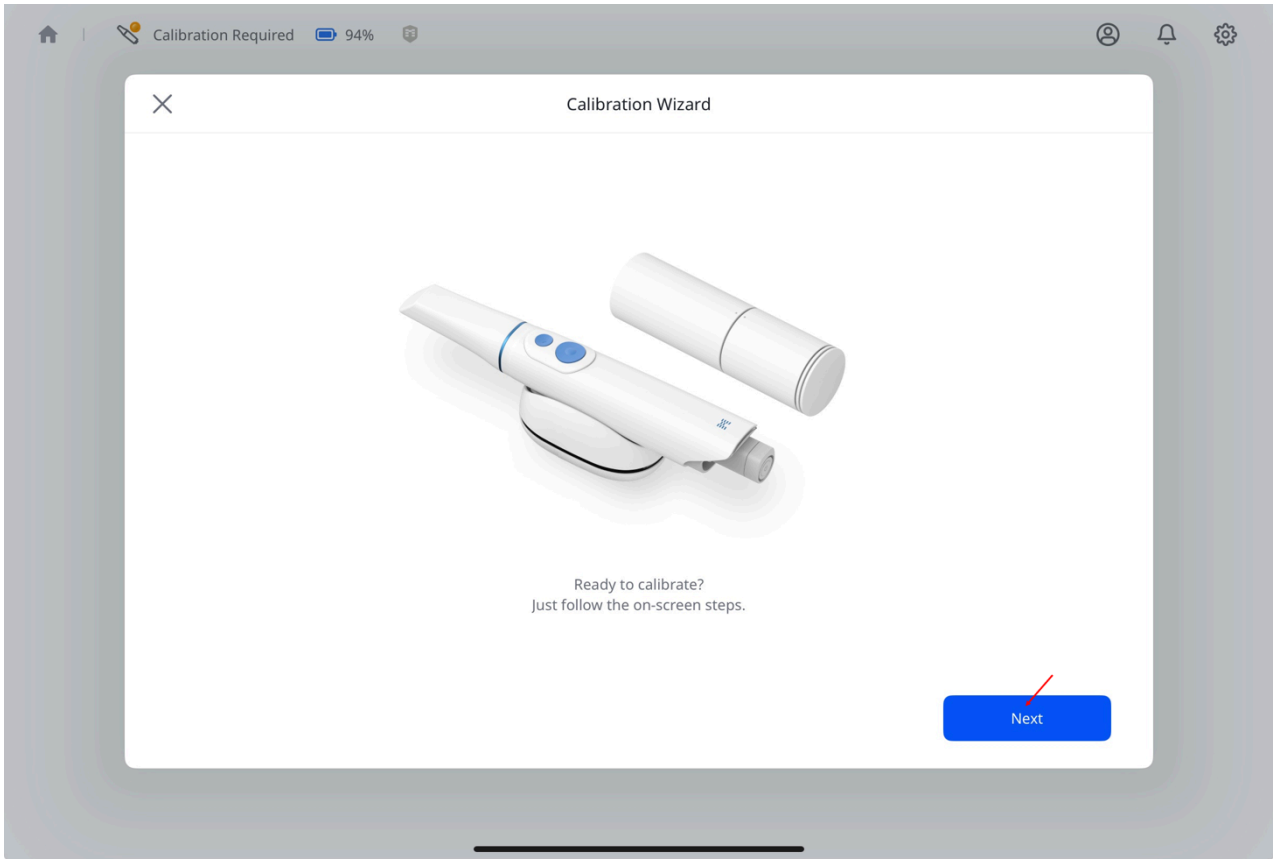

5. 旋轉校準器的上部，直到箭頭與圓點對齊，然後點選**下一步**。

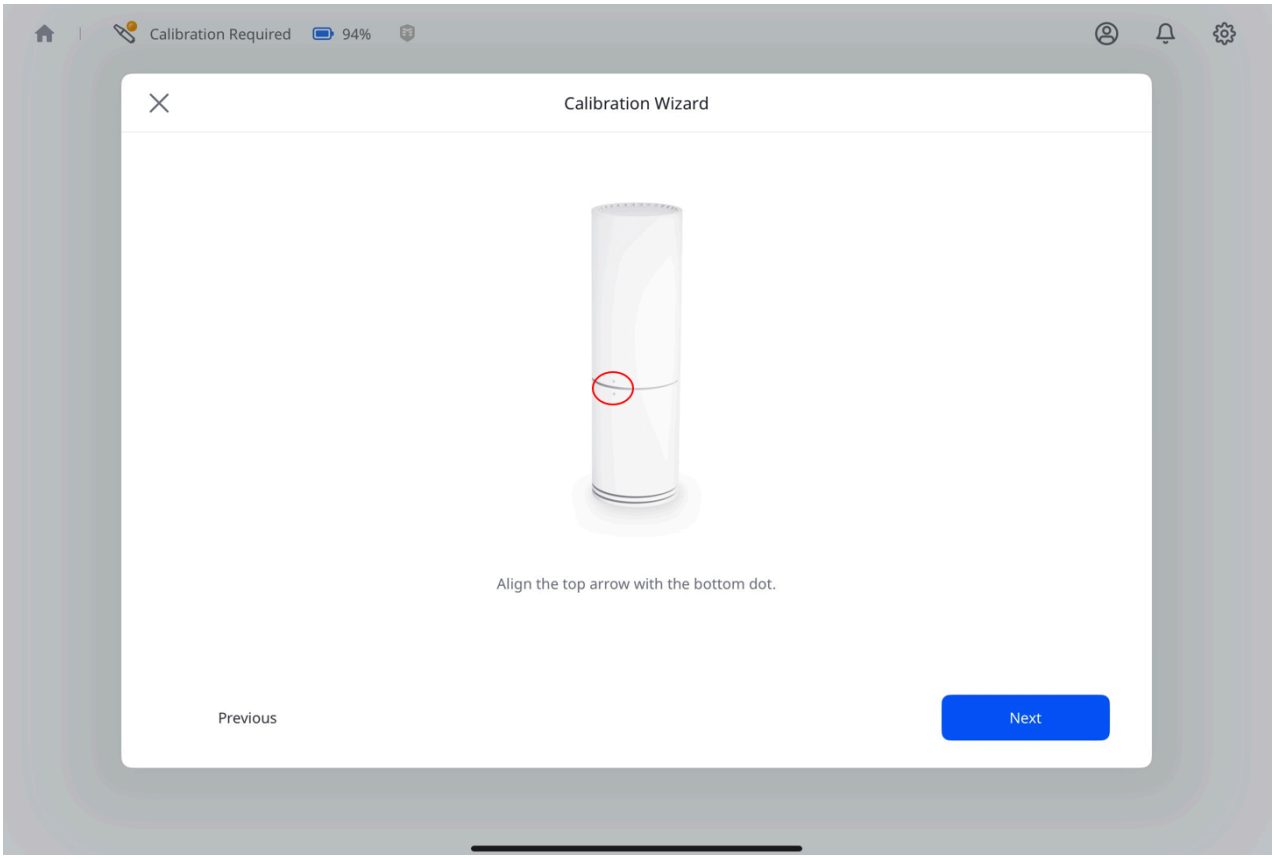

6. 取下校準器的底蓋以及掃描頭的掃描頭。
7. 在插入掃描儀之前，請確認校準器上的對齊符號與掃描儀機身上的實體按鈕對齊。
8. 將掃描儀牢固地推入校準器，直到**卡入到位**。

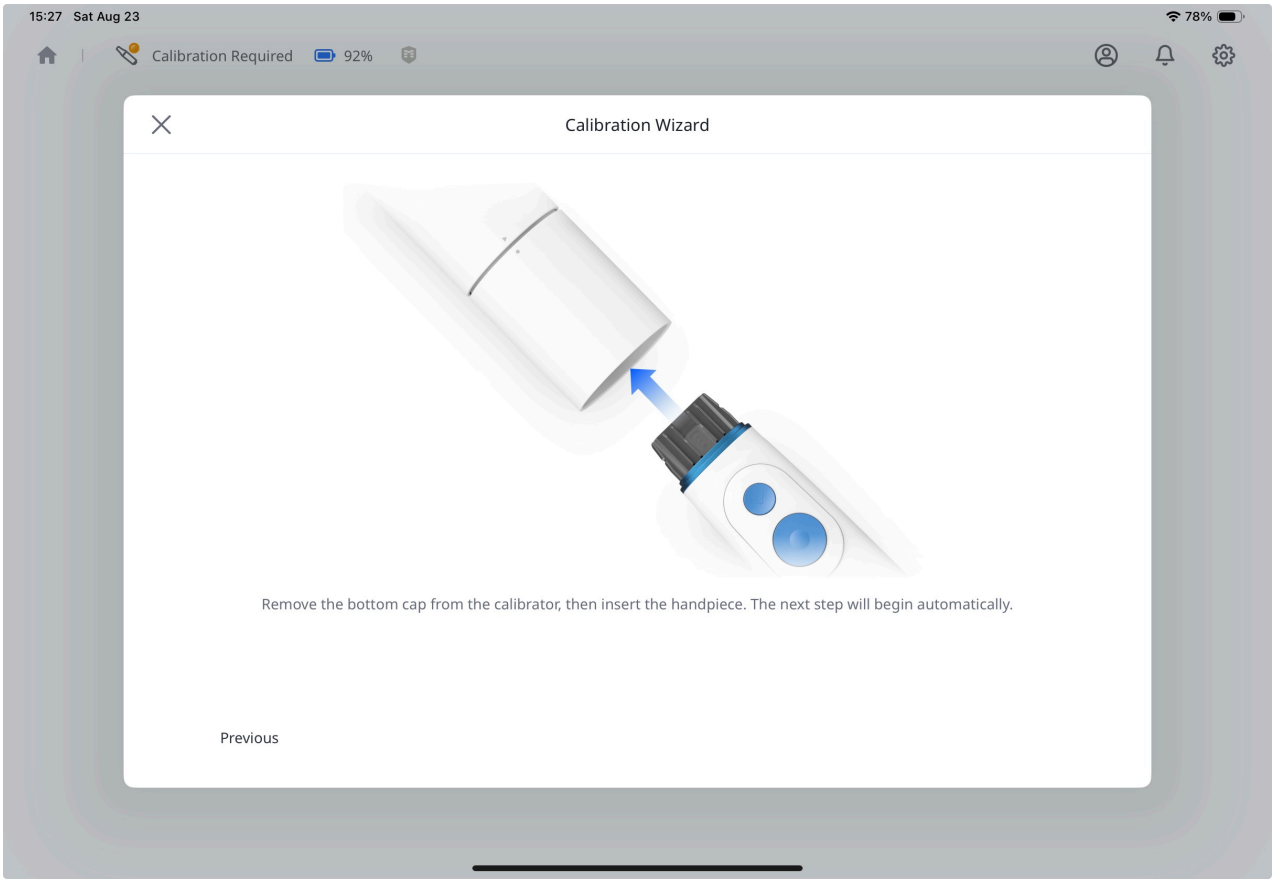

9. 當右下角出現**下一步**按鈕時，即表示連接已完成。點選以繼續。

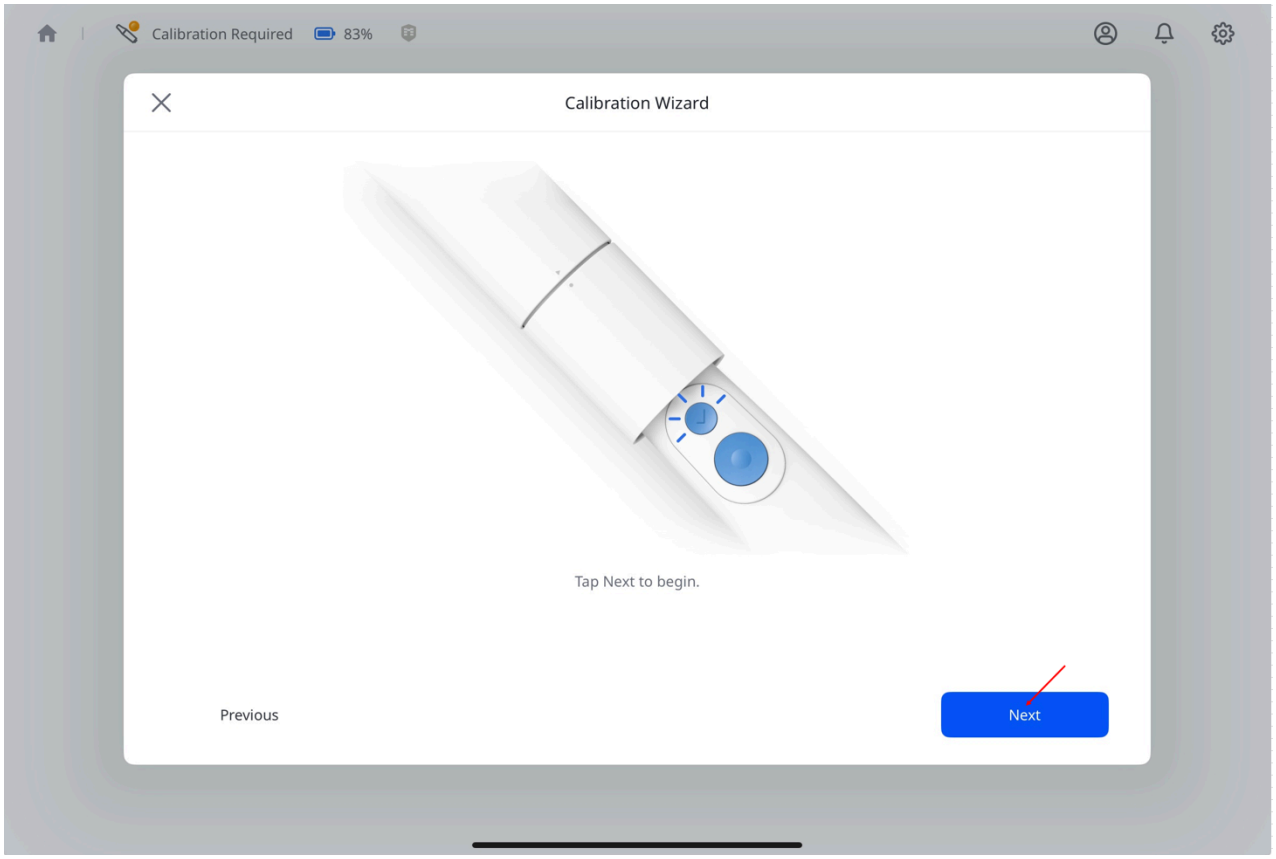

10. 依照螢幕指示，將校準器的上部旋轉至下一個位置。

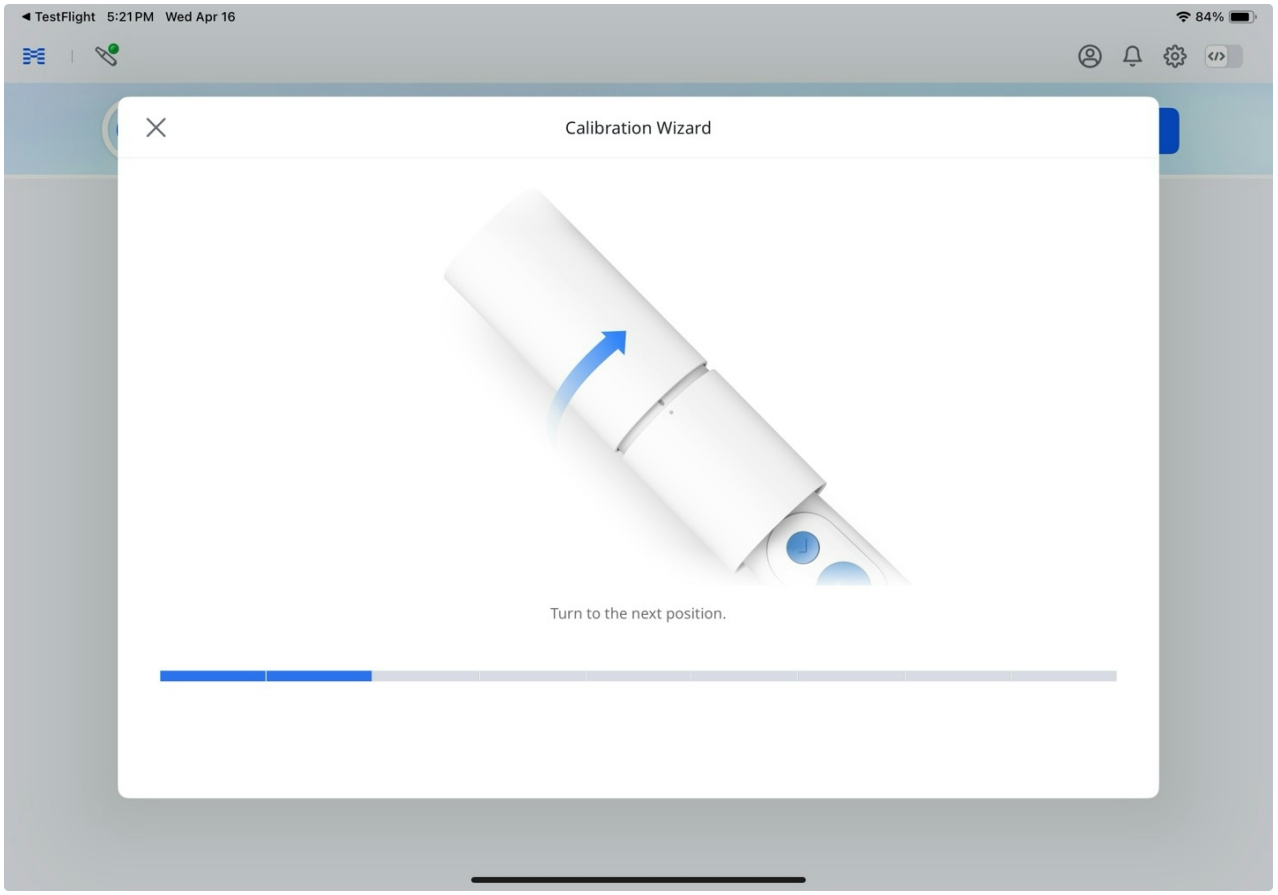

11. 重複上述流程，直到到達最後位置。
12. 校準開始後，結果會自動顯示。

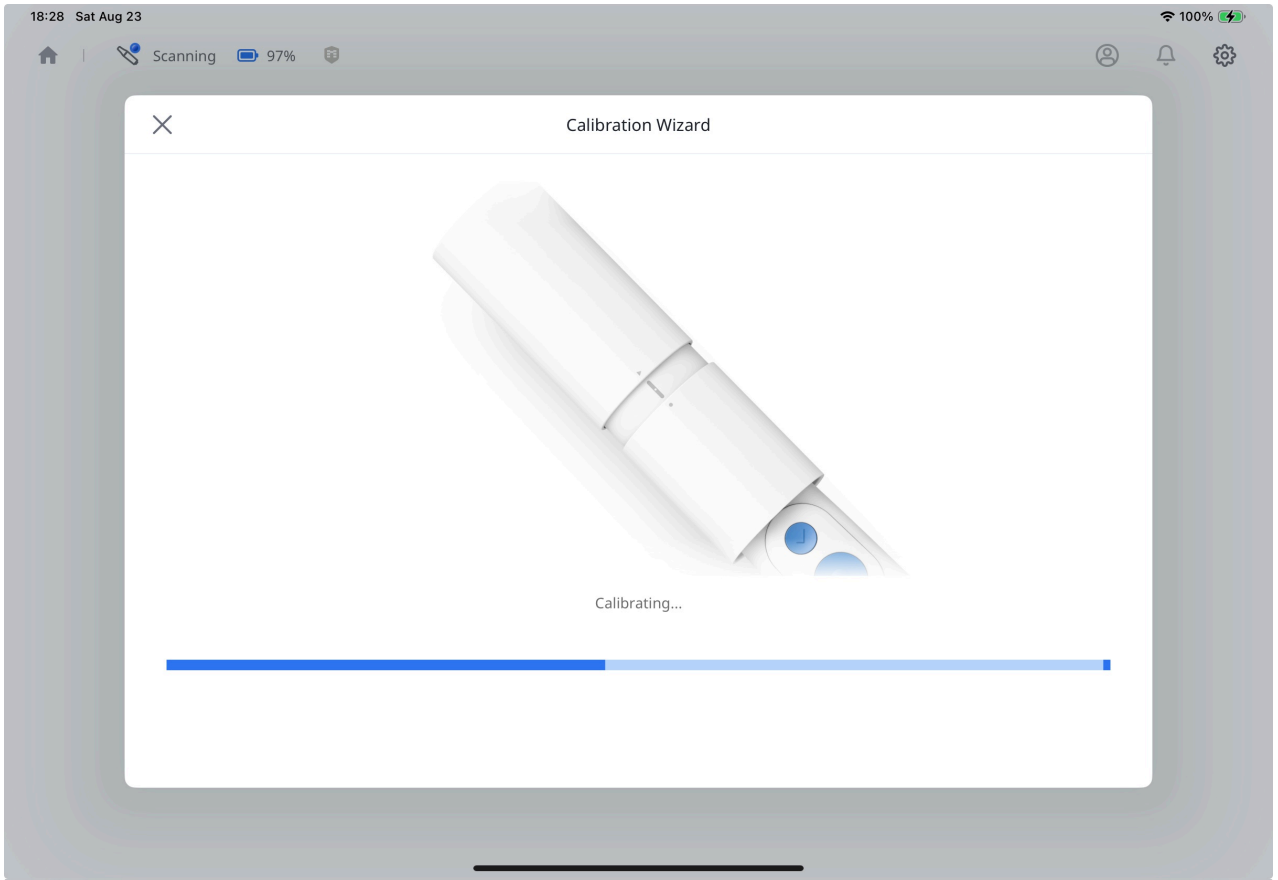

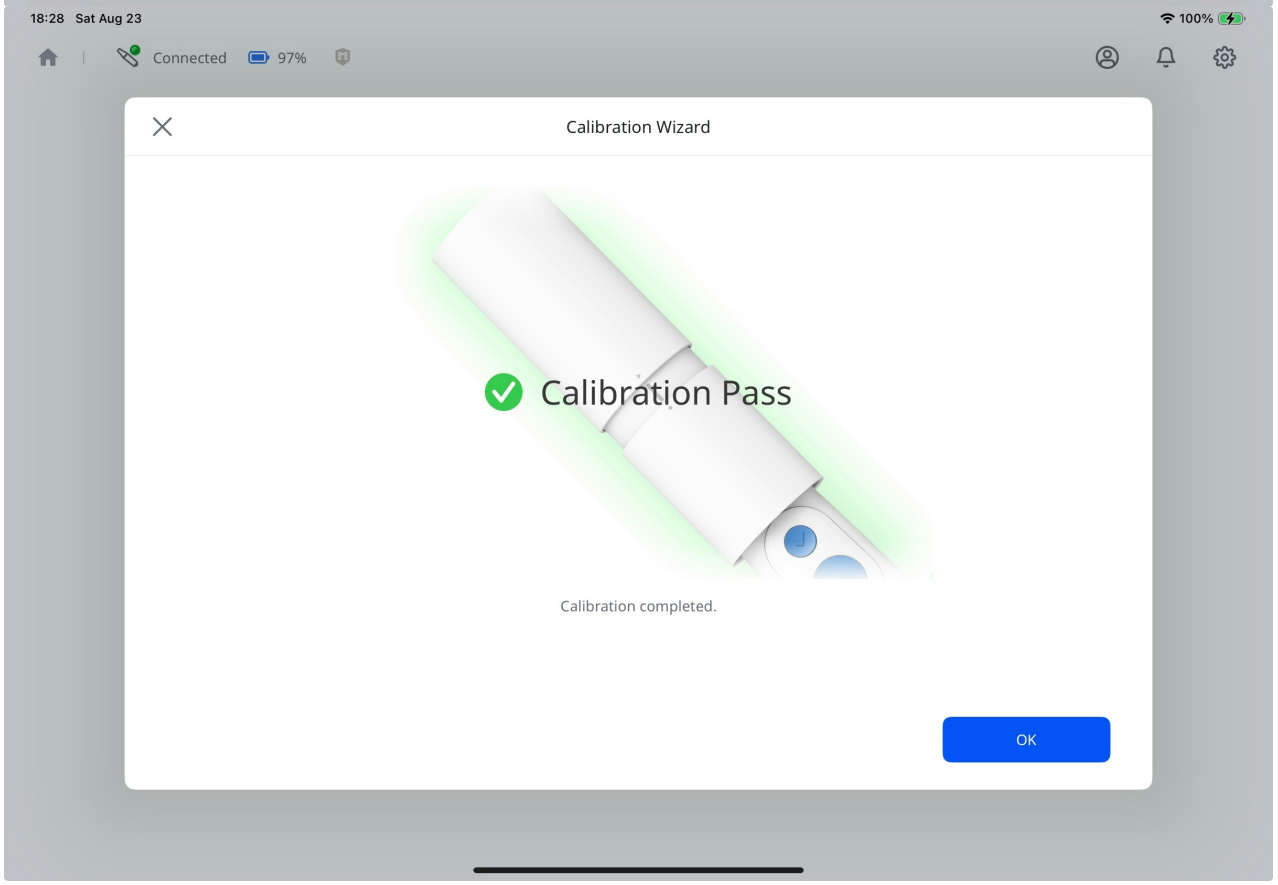

13. 您的掃描儀已連接並可使用。

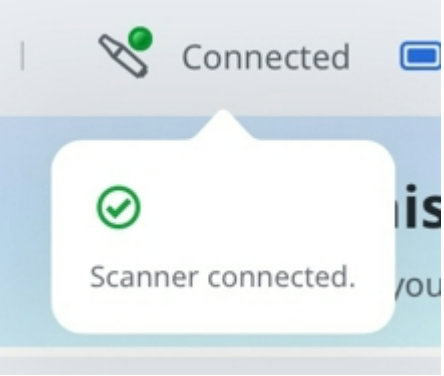

掃描儀狀態

下表列出了Medit Link Express中的掃描儀狀態指示。請熟悉以下指示，以更瞭解掃描儀狀態與所需操作。

圖示	狀態	描述
	Not Connected	掃描儀未連接。請檢查Wi-Fi或藍牙連線。
	Sleep	掃描儀處於睡眠模式。
	No Tip	掃描頭的掃描頭遺失或未正確裝上。
	Overheating	掃描儀溫度過高。停止掃描並讓其冷卻。 **🔎重要資訊** 當電池過熱時，掃描儀會自動關機，系統會顯示如下提示對話框。待電池冷卻後，即可繼續掃描。

圖示	狀態	描述
		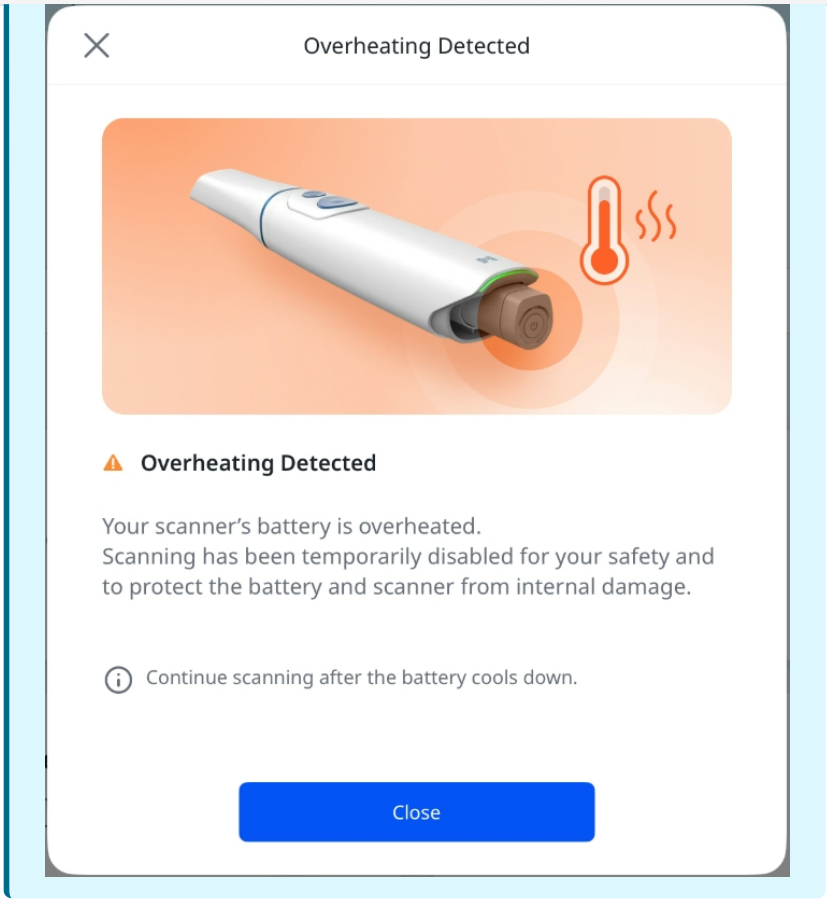
	Connecting	掃描儀正在建立Wi-Fi或藍牙連線。
	Scanning	掃描儀運作中。
	Rebooting	掃描儀正在重新啟動。
	Need Calibration	需要先校準才能繼續掃描。
	Preheating	掃描儀正在預熱。
	Connected	掃描儀已連接並可使用。

管理掃描儀連接

您可以透過以下方式斷開掃描儀的連接：

- 點選掃描儀旁的 **斷開連接**。

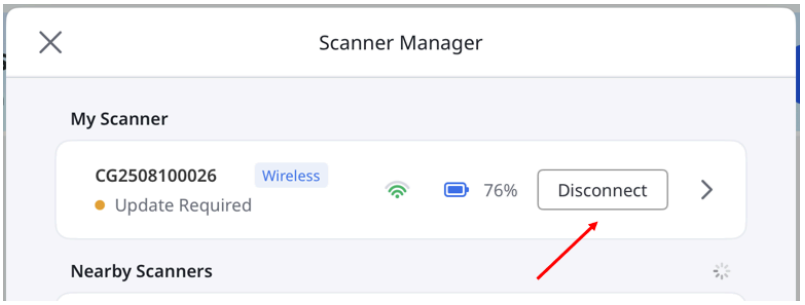

- 點選掃描儀旁的箭頭以開啟 **掃描儀詳細資訊**，然後點選 （···）並選擇 **斷開連接**。

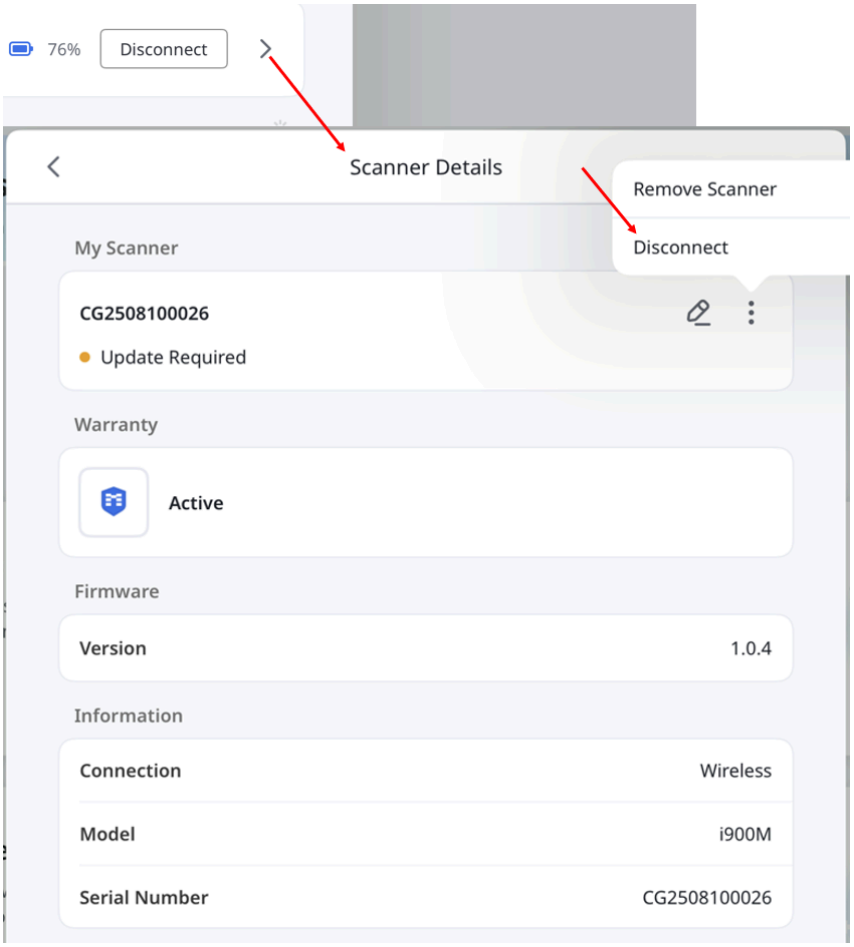

在 **掃描儀詳細資訊**中，您可以查看連接類型、型號、序號、韌體版本及保固期狀態等資訊。
您也可以透過重新命名或移除掃描儀來進行管理。

網路檢查

使用**網路檢查**檢查您的連線，並在掃描速度緩慢或掃描儀連線不穩定時查看建議的處理方式。

1. 確保您的掃描儀已連線。開啟**掃描儀管理器**，然後選取 **執行網路檢查**。

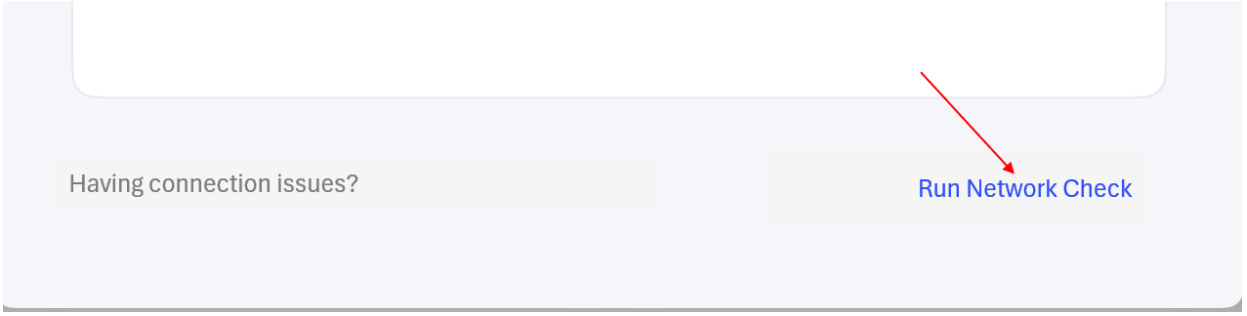

2. 請保持掃描儀處於連線狀態，直至檢查完成。

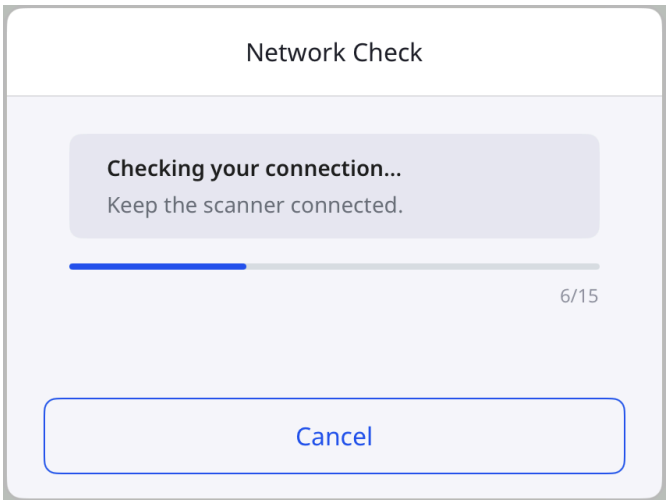

3. 查看結果並依照相應建議進行操作。選取**顯示詳細資訊**，查看每項檢查的結果。

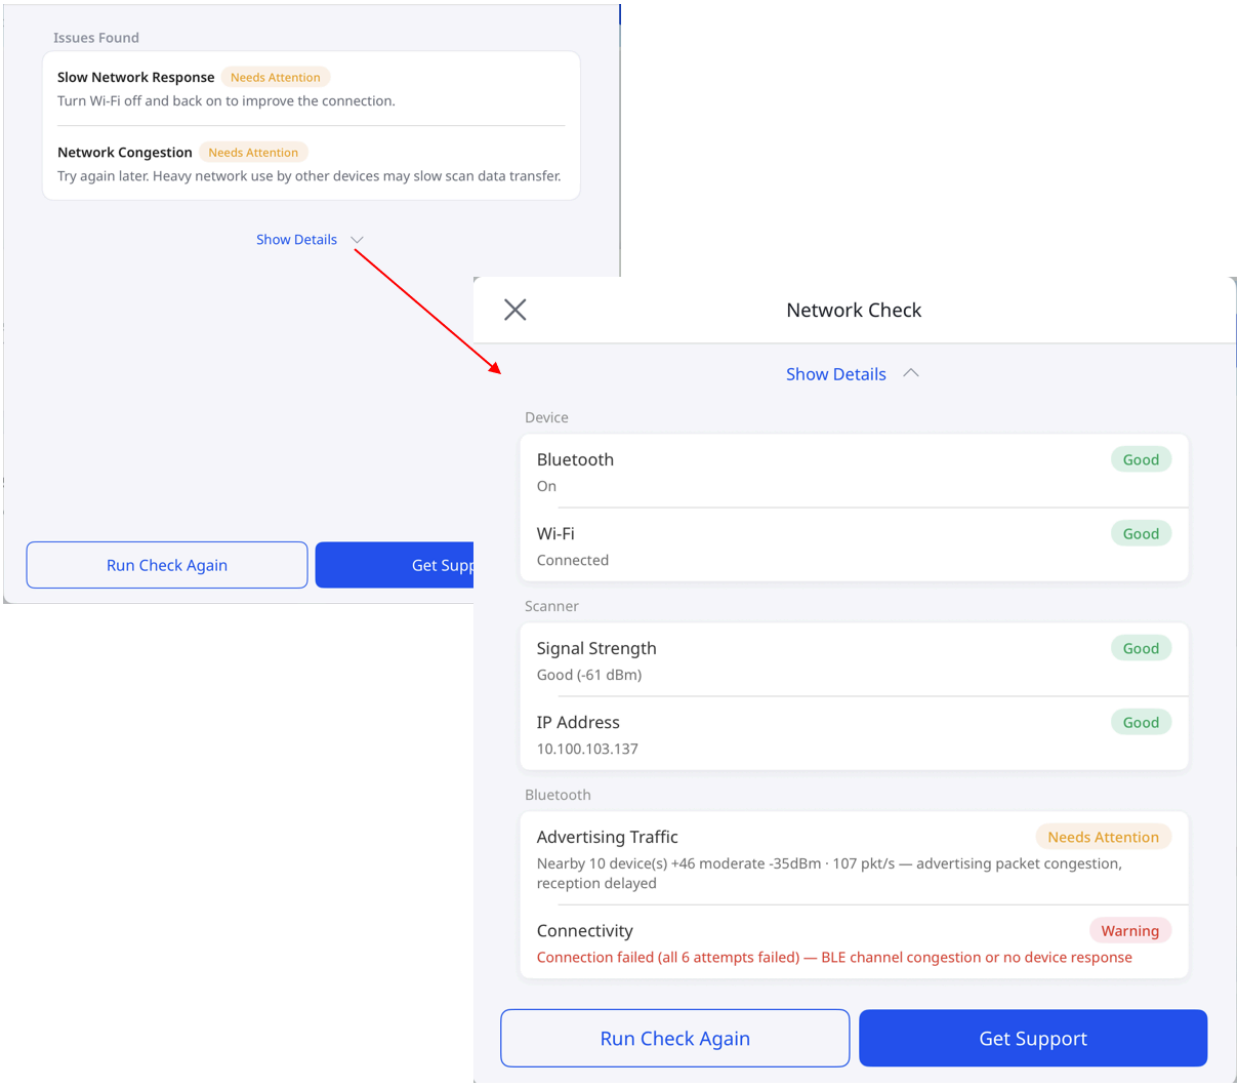

4. 選取**再次執行檢查**以再次檢查連線，或選取**獲取支援**以開啟支援請求，檢查結果會自動填入。

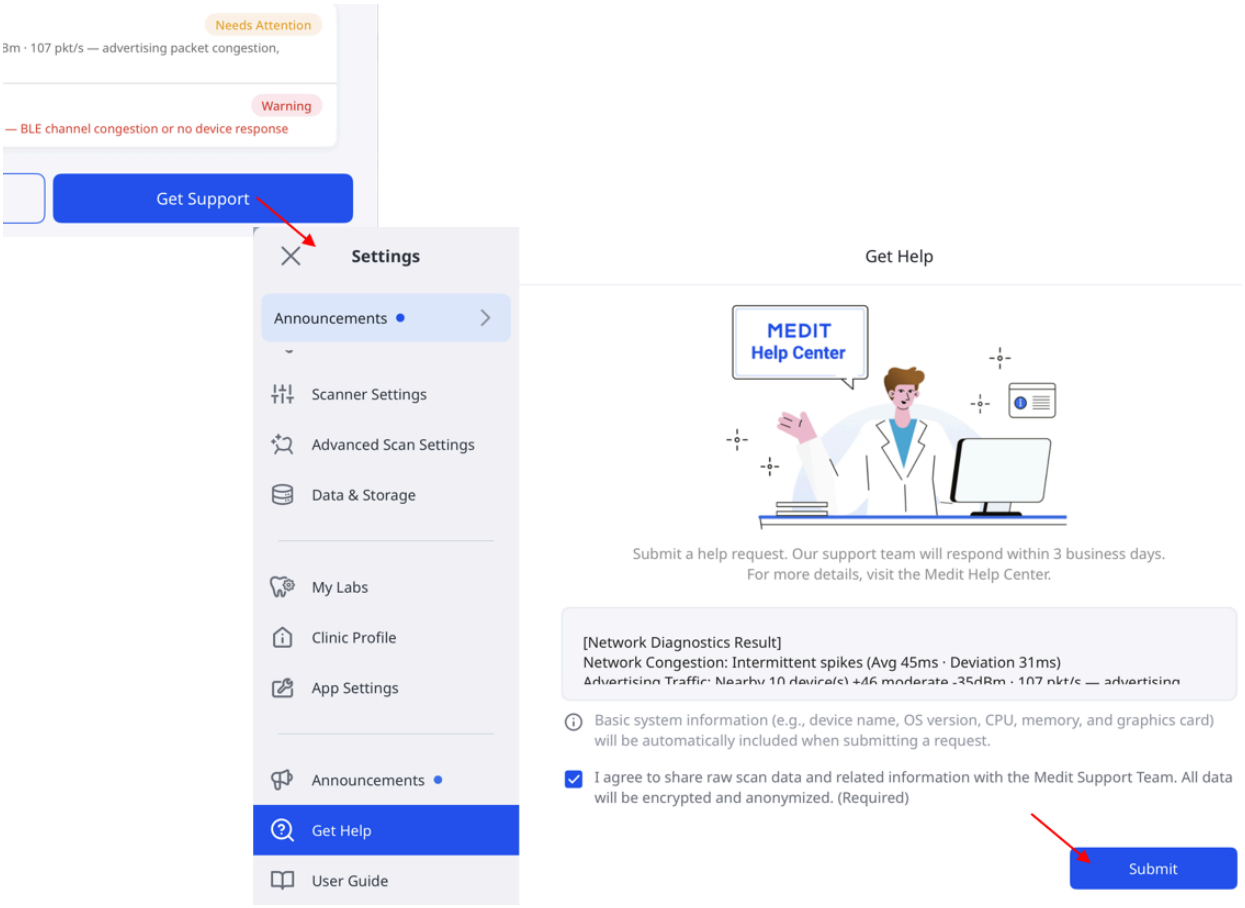

選取結果對話方塊中的 **×**，返回**掃描儀管理器**，您可以在其中選取 **查看結果** 再次查看結果。

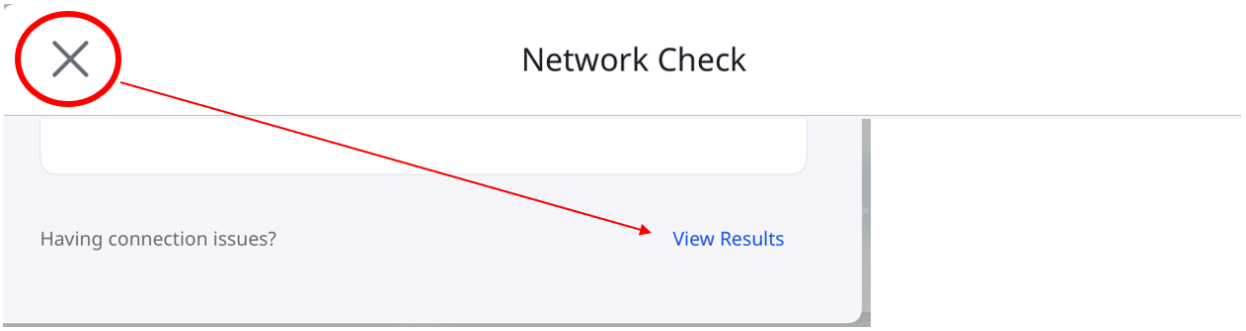

🔎重要資訊

- 使用有線掃描儀或透過集線器連線的無線掃描儀時，無法使用「網路檢查」。

快速導引手冊

本快速指南概述了使用Medit Link Express的關鍵步驟，從掃描到下訂單。請依照以下步驟開始使用。

Express Scan：先掃描，後添加

Express Scan免除了在掃描前建立或選擇案例的負擔。您可以立即開始掃描，並在稍後需要時新增案例。

這可簡化諮詢流程，並使初步評估得以更有效率地進行。

若要在未選擇或建立案例的情況下先開始掃描：

1. 請確認掃描儀已正確連接並完成校準。請參閱掃描儀設定章節以取得如何連接與校準掃描儀的說明。
2. 在主畫面點選**Express Scan**。

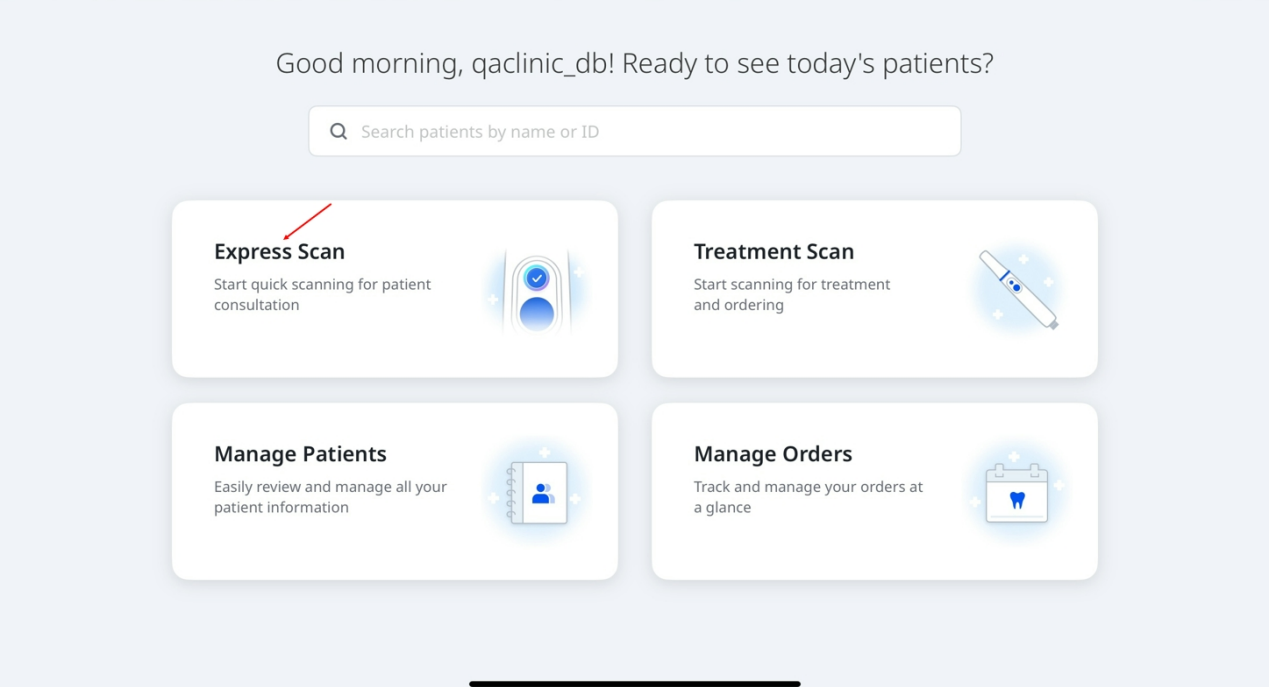

3. Express Scan提供四個預設階段：**上顎**、**下顎**、**咬合一**及**咬合二**。
4. 點選**開始掃描**即可開始掃描。或按下掃描儀機身上的掃描按鈕，如下所示。

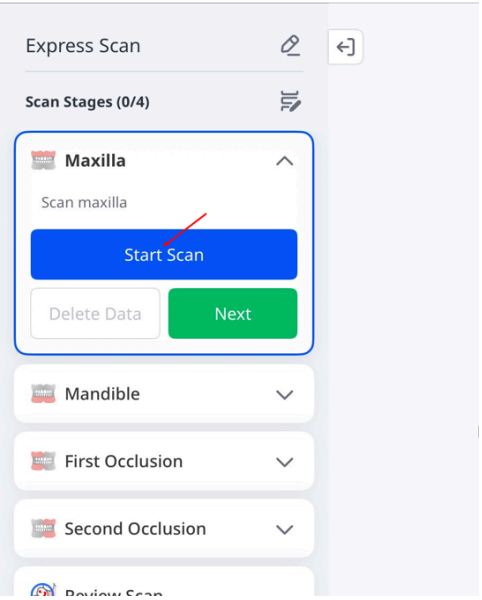

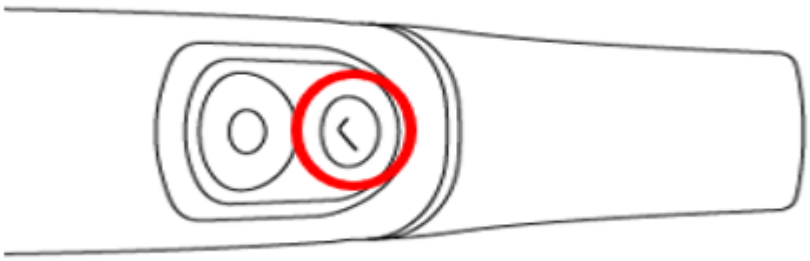

5. 開始掃描。當出現「您已掃描足夠數據...」時，您可以停止或視需要繼續掃描。若要回到**掃描階段**畫面，點選螢幕上的停止圖示 (■)，或再次按下掃描儀機身上的掃描按鈕。

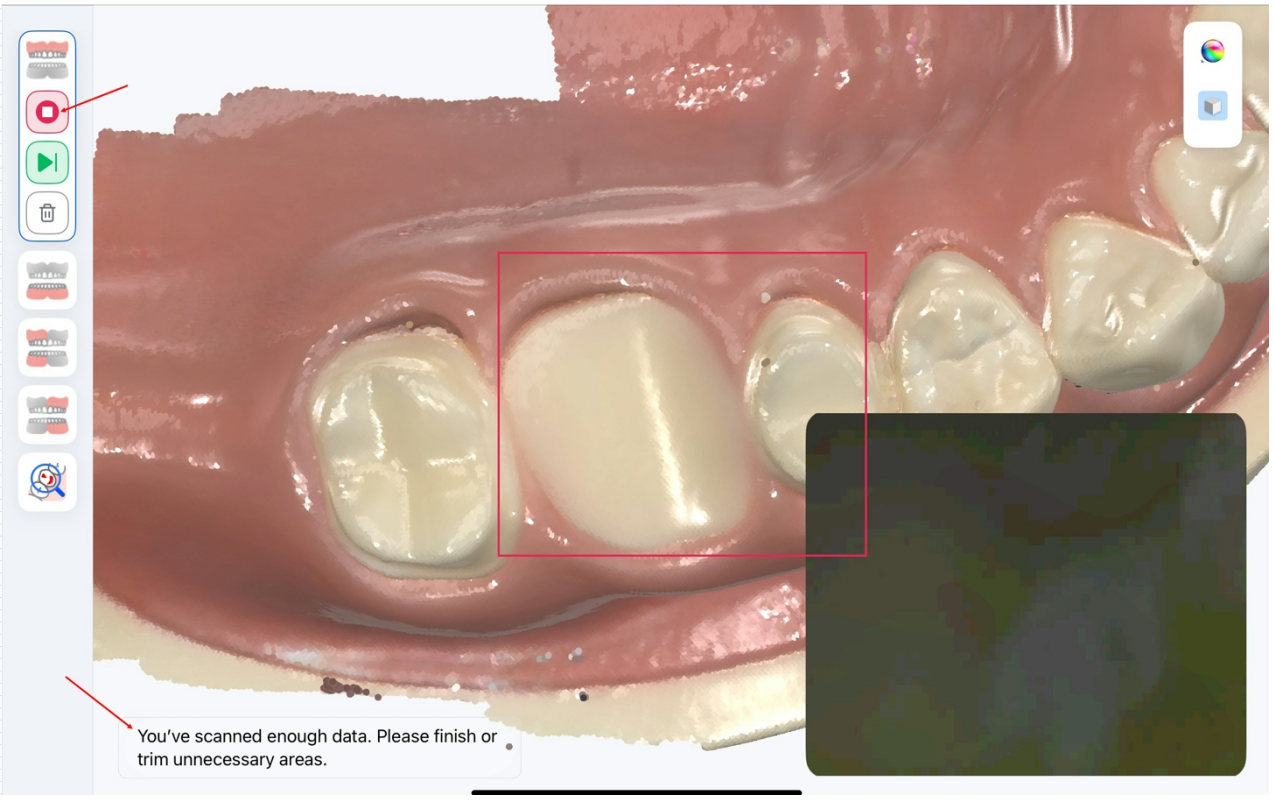

6. 請在每個階段檢查掃描數據，以確保掃描完整且準確。對於咬合階段，請確認上下顎掃描在牙齒接觸面上已正確對齊。然後點選**下一步** 以移至下一階段。
若要從步驟5直接前往下一個階段，點選下一階段圖示 (▶|)。點選**恢復掃描**以在目前階段添加更多數據，或點選**刪除數據**以清除目前的掃描。

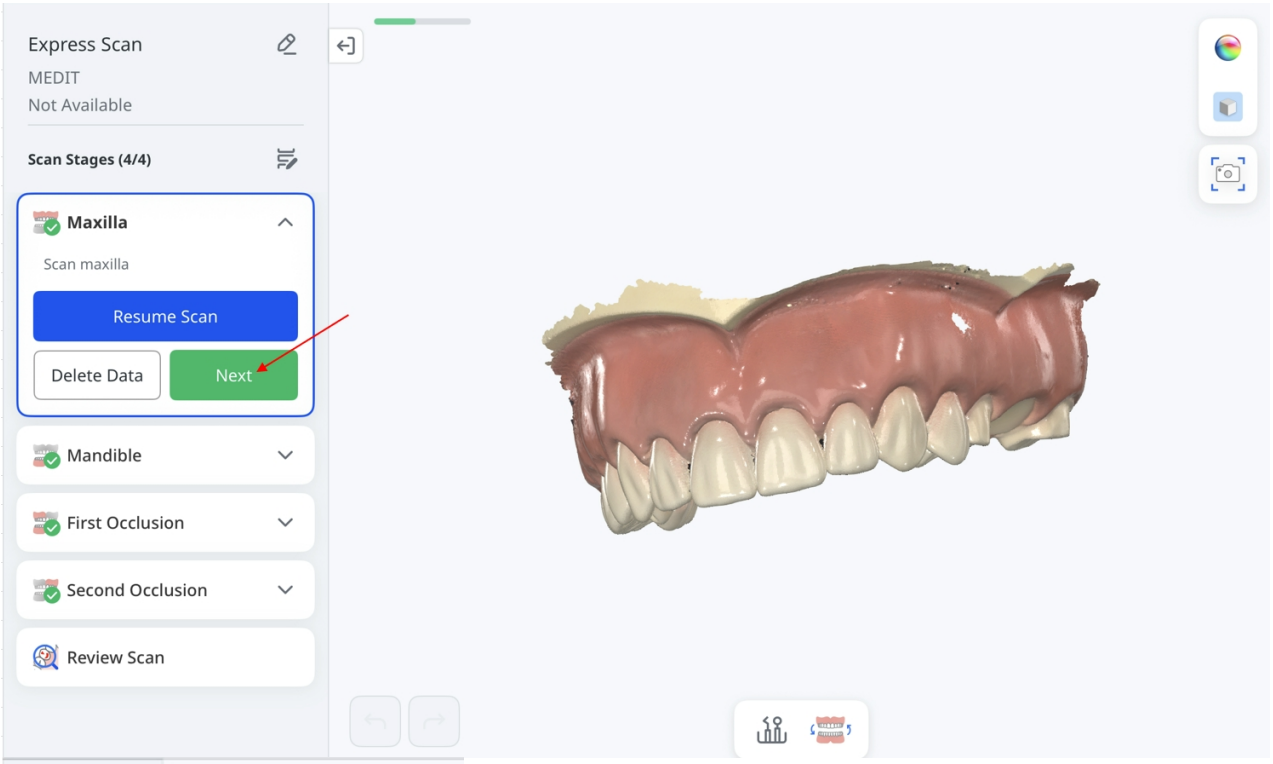

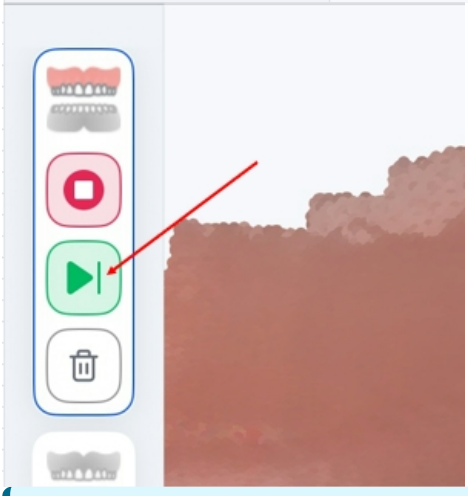

🔎重要資訊

- 如果在掃描階段掃描了錯誤的牙弓，您可以點選螢幕底部的交換圖示來交換掃描數據。
在交換進行時，系統會顯示「正在交換數據……」的訊息。在某些情況下（例如僅有掃描桿數據時），此功能可能無法使用。

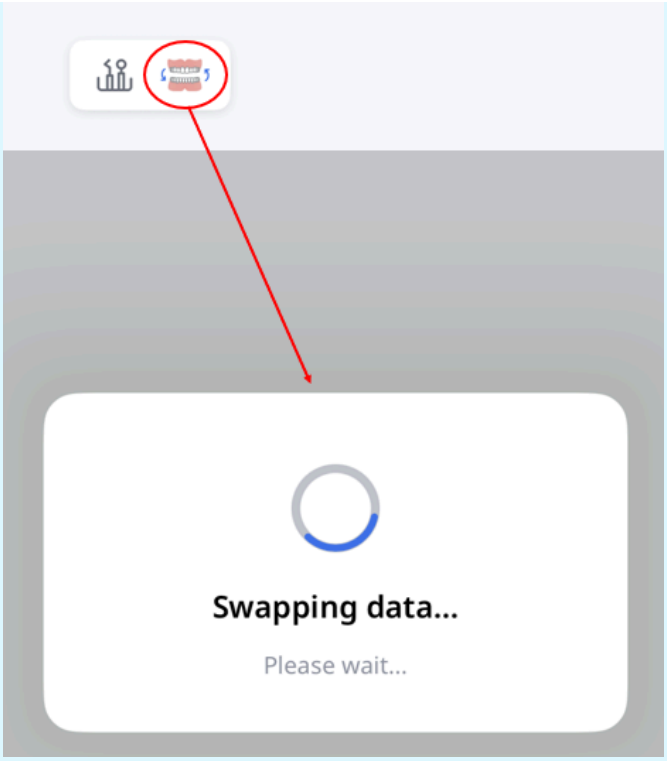

- 您也可以透過在每個數據集上選擇1–3個對應點來進行手動對齊。
  此功能僅在具有足夠掃描數據時可用，可能會依掃描階段及掃描狀態而變為不可用或被停用。如需這些工具的詳細資訊，請參閱**掃描階段和工具**章節。

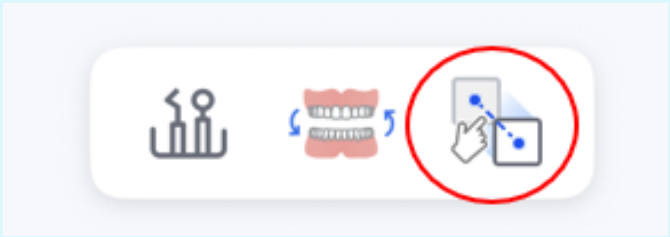

- 若要使用掃描儀拍攝口內影像，請在掃描畫面上點選高清相機圖示。如需詳細資訊，請參閱**掃描階段與工具** 章節。

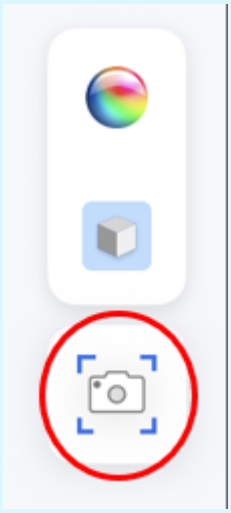

7. 完成所有掃描階段後，您將進入**檢查掃描**階段。點選螢幕右側的圖示以檢視您的掃描結果。如需這些工具的詳細資訊，請參閱掃描階段和工具章節。

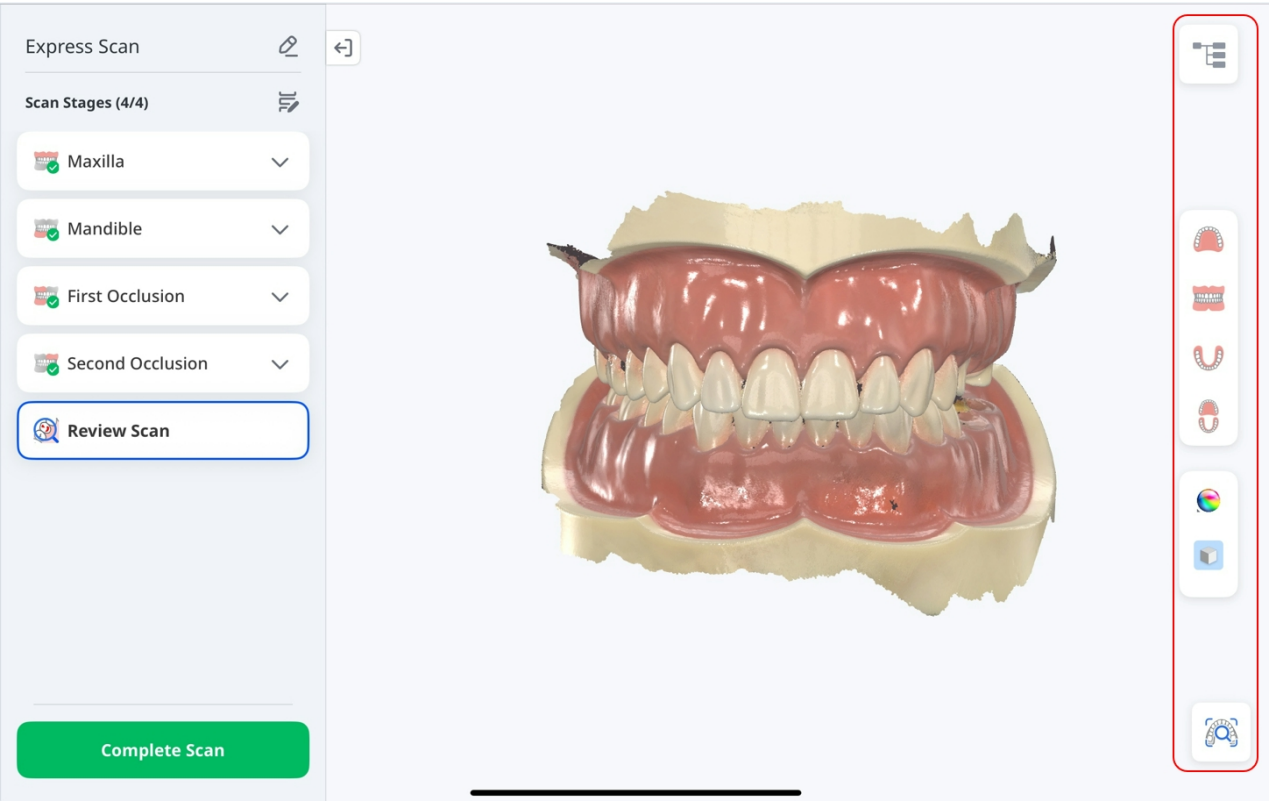

8. 使用數據樹顯示或隱藏掃描數據並調整其透明度。您也可以添加及預覽附件。若要保存案例並繼續，點選**完成掃描**。

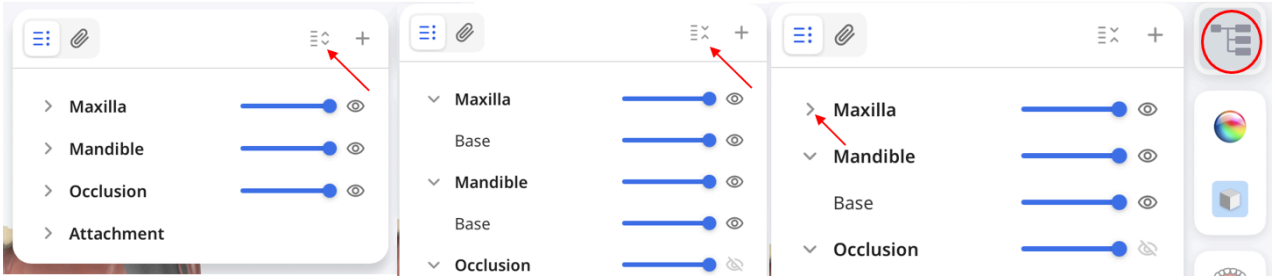

9. 點選**添加患者**。

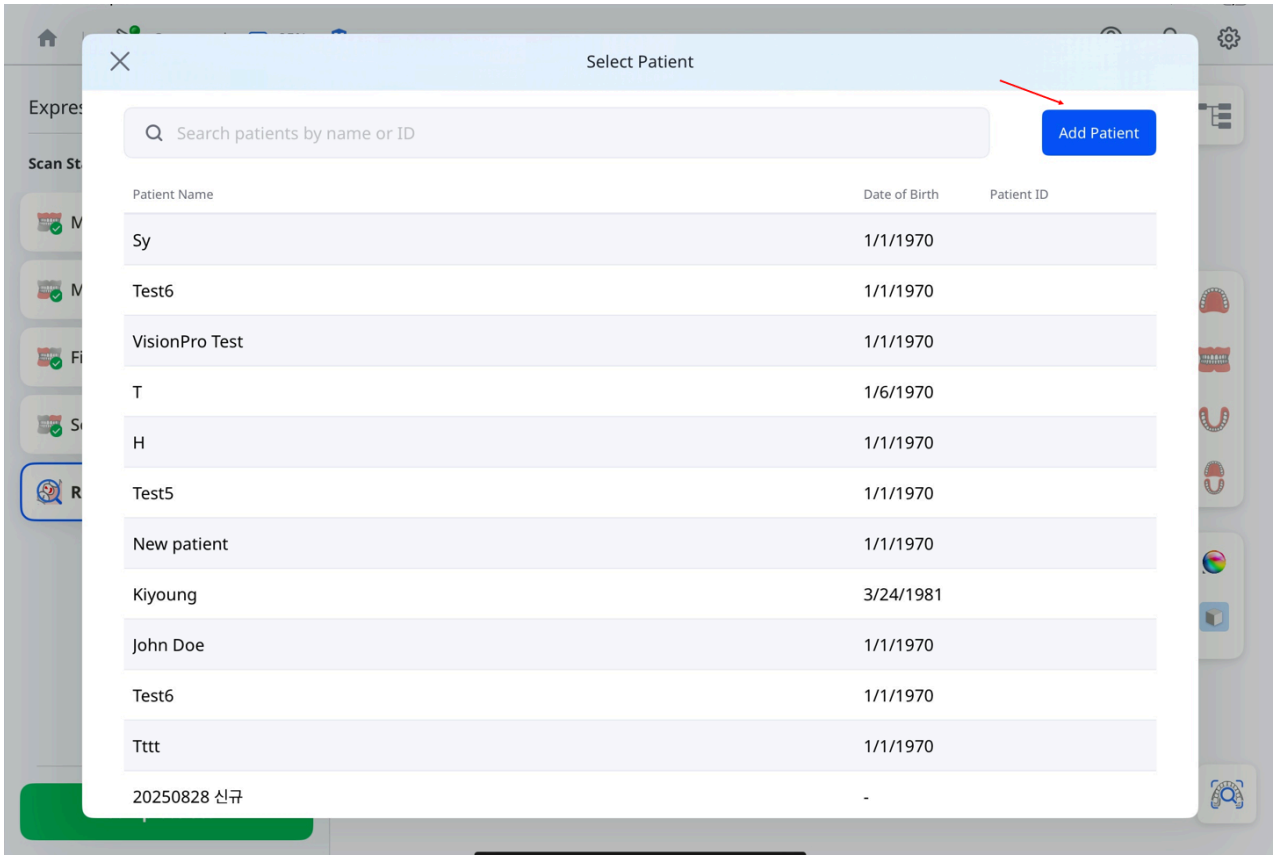

10. 填寫患者詳細資訊，然後點選**註冊**。

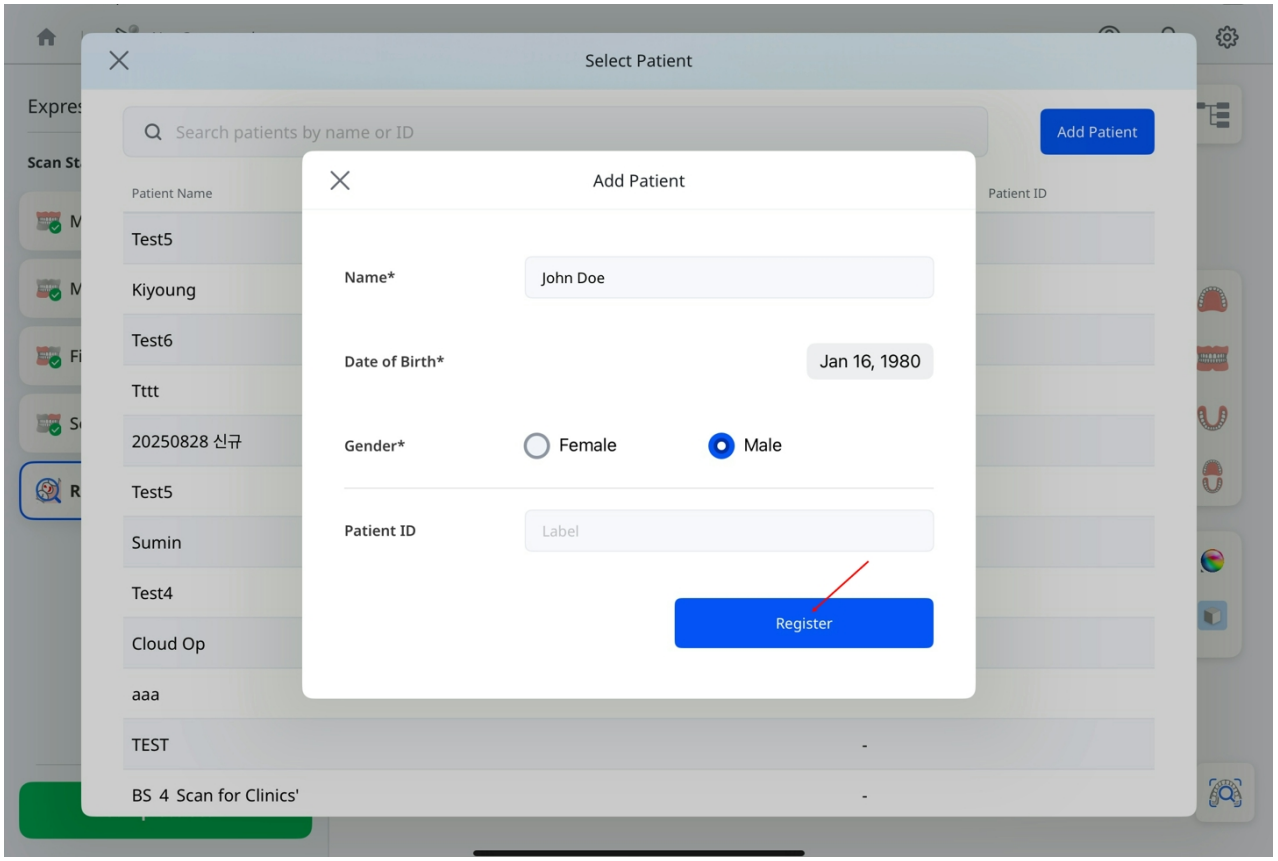

11. 請等待，直到處理進度達到 100%。

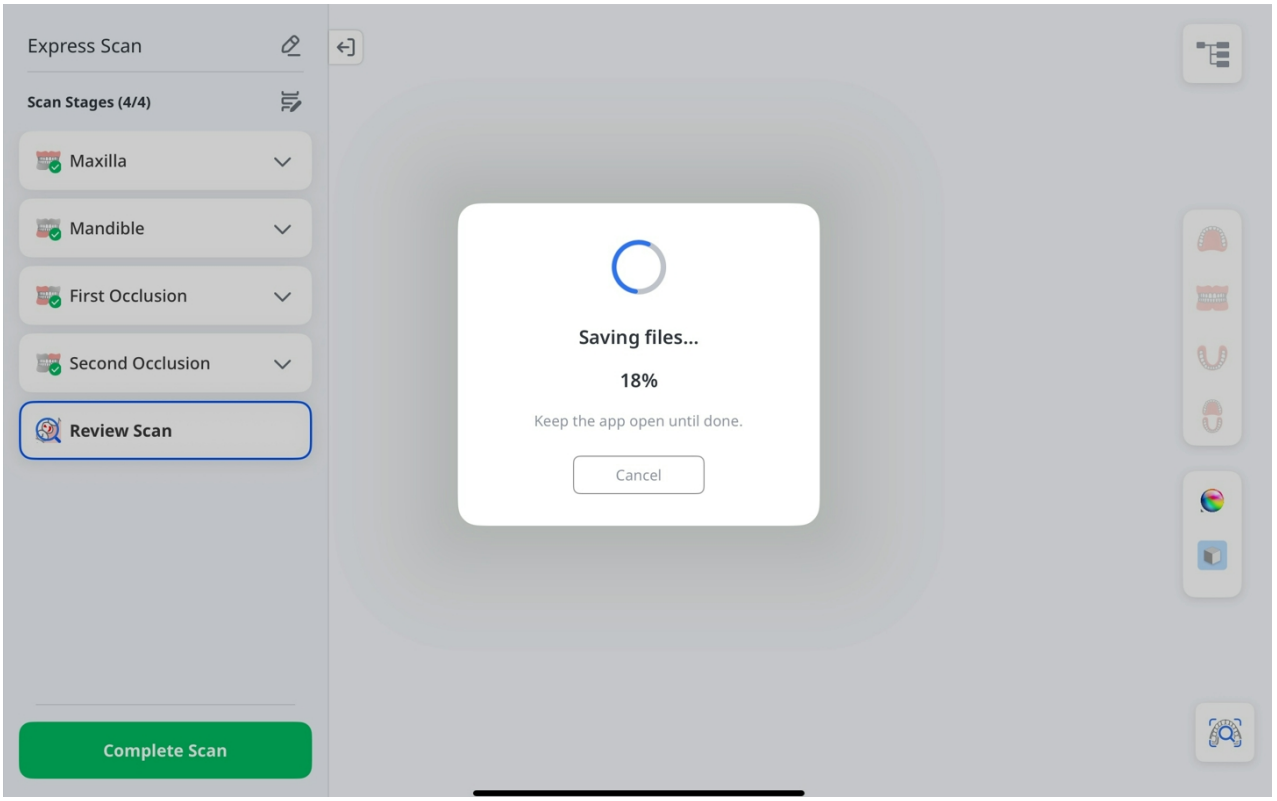

12. 當**掃描數據掃已就緒**對話方塊出現時，選取一個Web應用程式以建立用於患者諮詢報告，或選取**患者詳細資訊**以查看已儲存的案例。

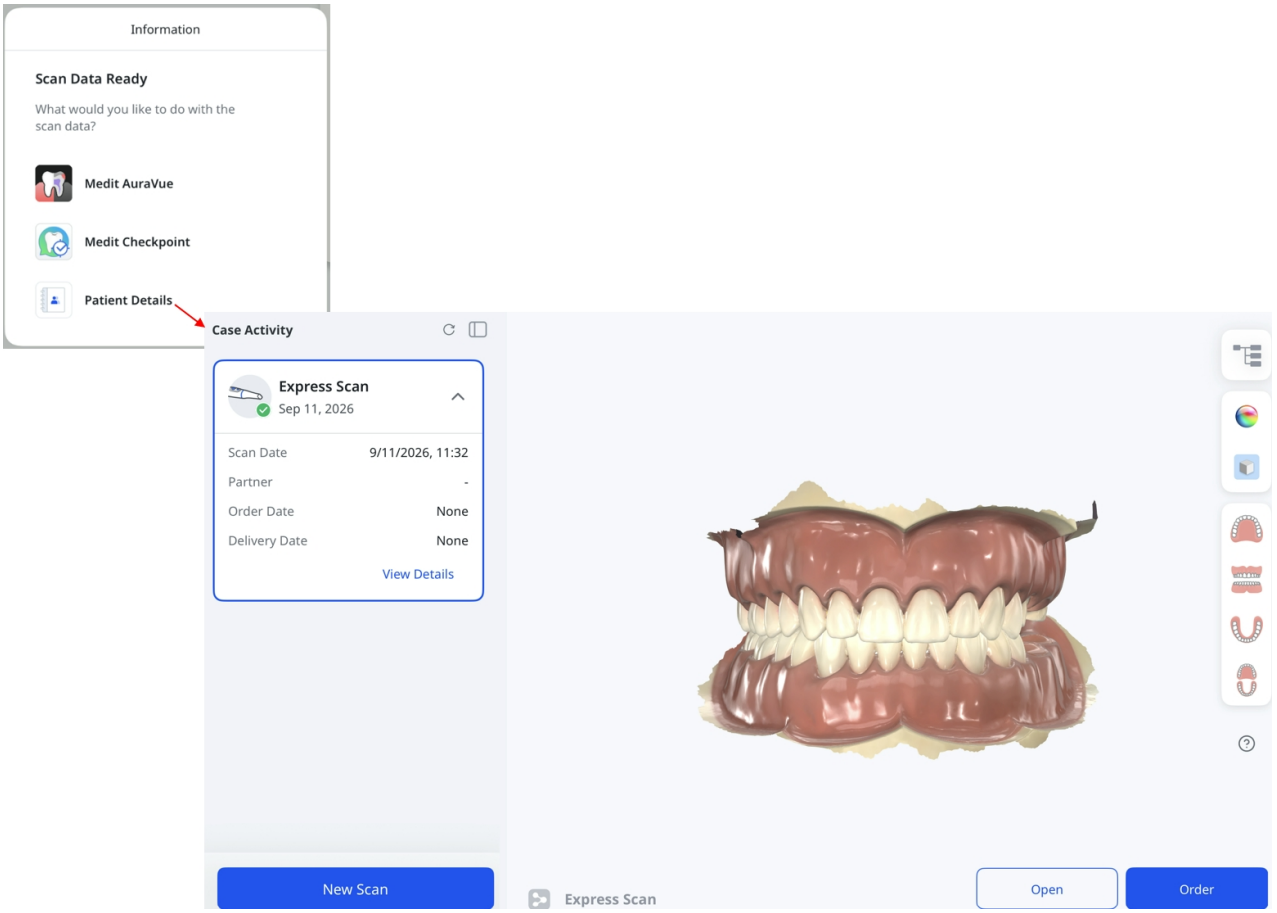

治療掃描

使用「治療掃描」獲取適用於多種牙科應用的精確掃描數據，例如修復製作、治療計劃及臨床工作流程。這些數據可用於技工所與椅旁環境，以確保獲得可靠的結果。

步驟1：連接&校準掃描儀

請參閱掃描儀設定章節以取得如何連接與校準掃描儀的說明。

步驟 2：選擇患者

若要開始掃描：

1. 在主頁面點選**Treatment Scan**。

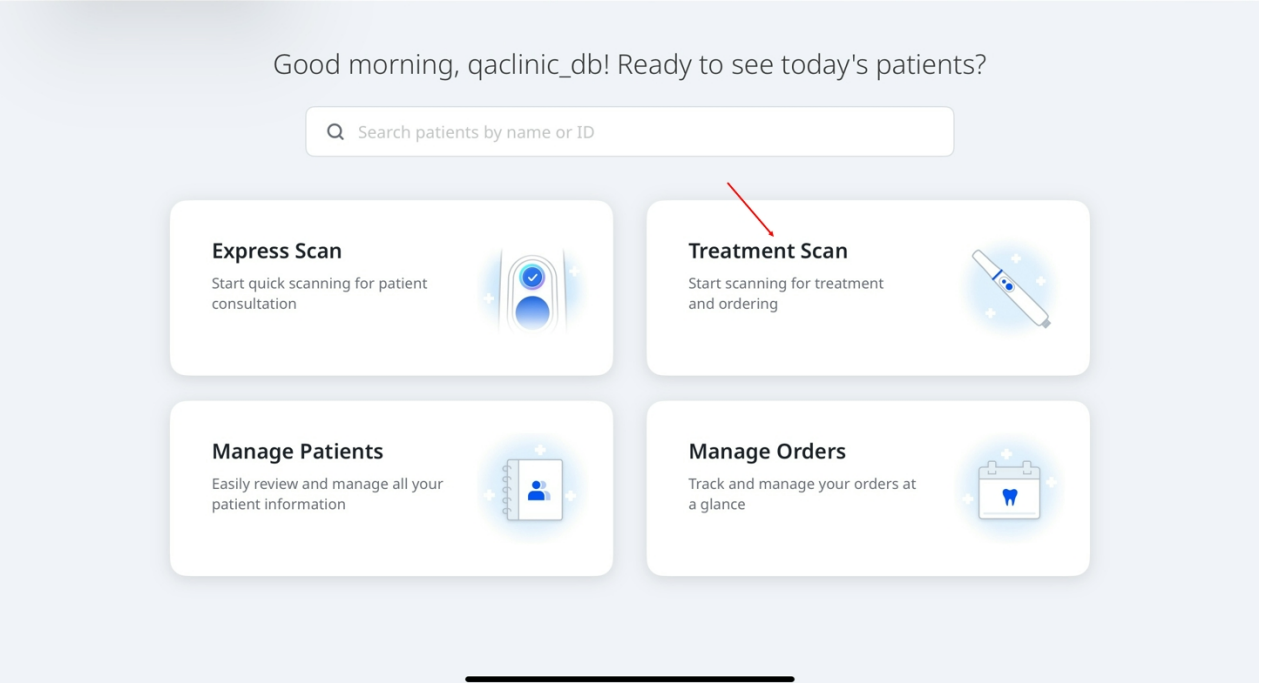

2. 選擇一位患者以繼續。若要添加新患者，點選螢幕右上角的**添加患者**。

   如需更過關於如何添加患者的資訊，請參閱工作流程>管理患者。

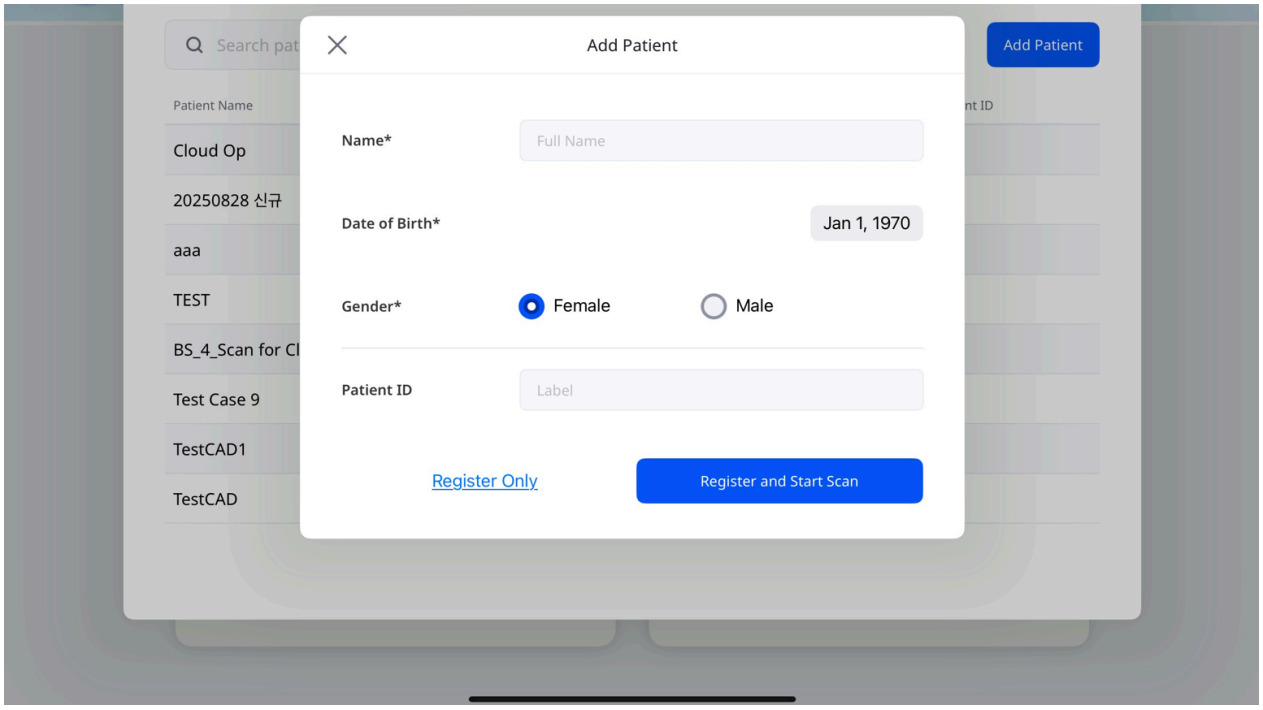

步驟 3：選擇工作流程

選取預設工作流程——**修復體**、**植體掃描** 或 **矯正掃描**——或您建立的自訂工作流程。若要建立自訂工作流程，請點選**建立新工作流程**。如需操作說明，請參閱**工作流程** 章節中的**自訂工作流程**。

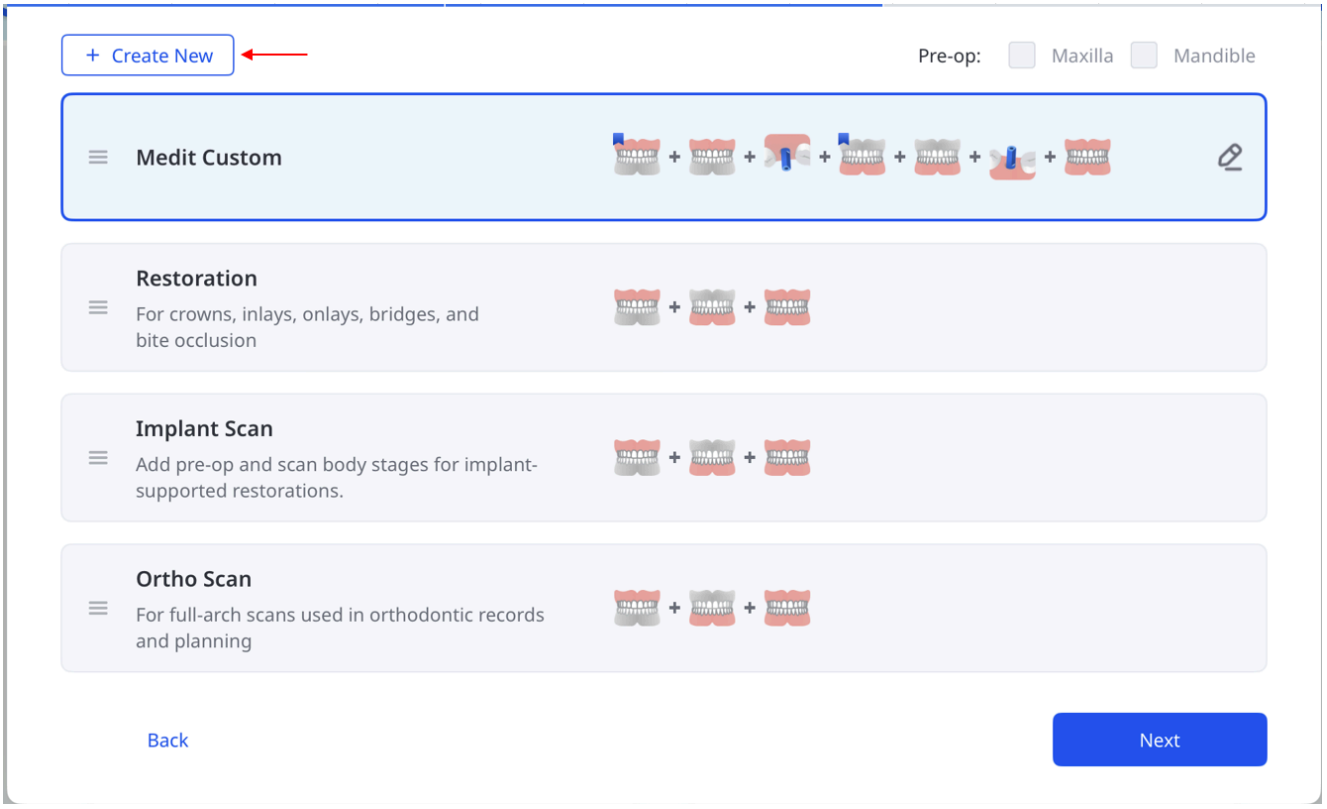

對於預設工作流程，請在**術前**旁選取**上顎**或**下顎**，以包含相應的階段。這些選用階段可用於擷取原始解剖結構，作為對齊或治療規劃的參考。



🔎重要資訊

1. 若要在**掃描階段**畫面中添加或移除階段，請點選下方螢幕截圖所示的鉛筆圖示。

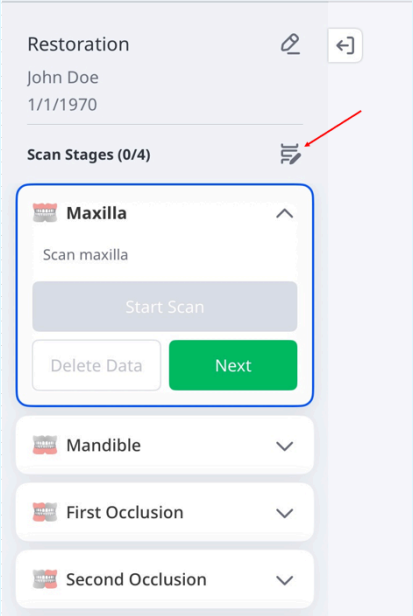

2. 若要刪除某個階段，請選取其旁邊的**X**圖示。若要新增階段，點選**添加階段**。完成後，點選**保存變更**以應用您的更新。

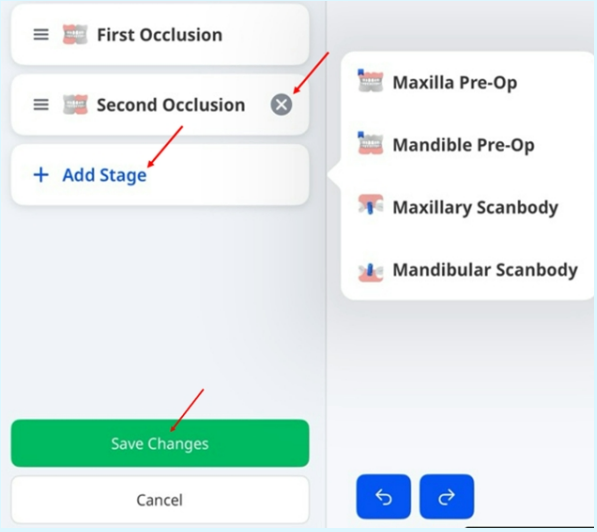

步驟4：選擇牙齒或牙顎——修復體&植體掃描

1. 選取需要治療的單顆或多顆牙齒，然後點選**下一步**。

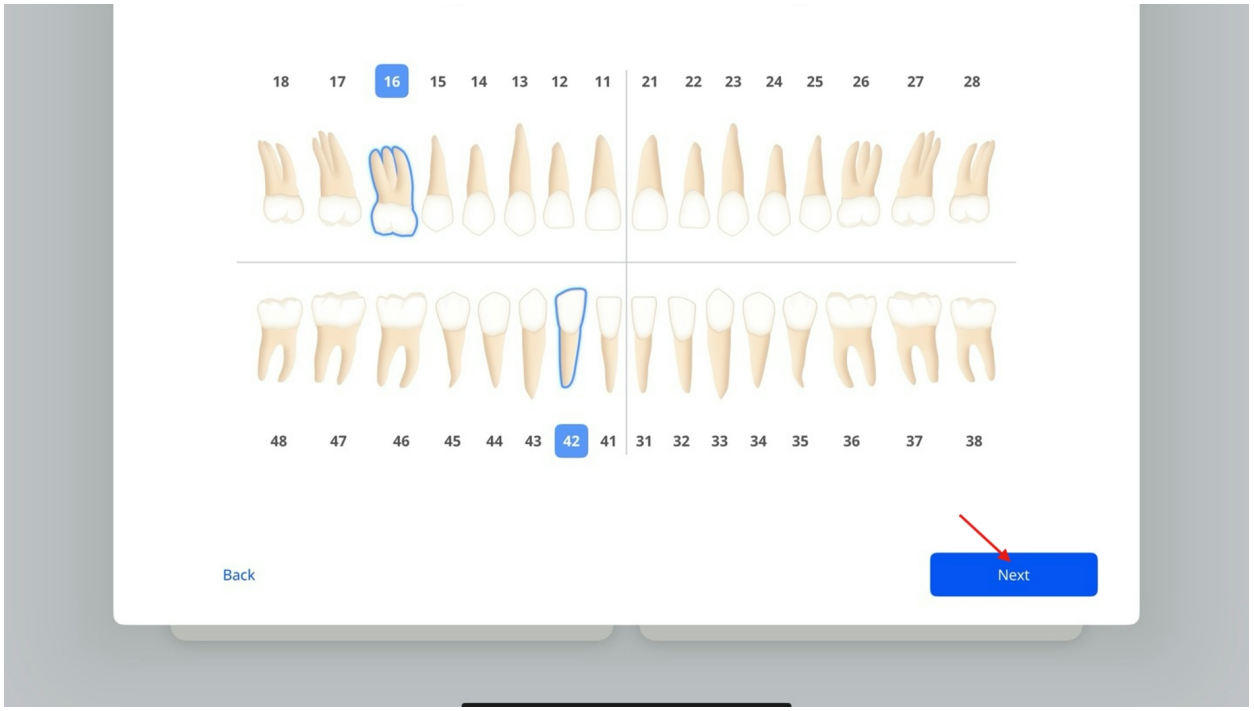

2. 若工作流程為**植體掃描**，請從選項列表中為需要進行植體治療的牙齒選擇**植體**，為需要進行常規治療的牙齒選擇**自然牙齒**。

   接著點選**下一步**。

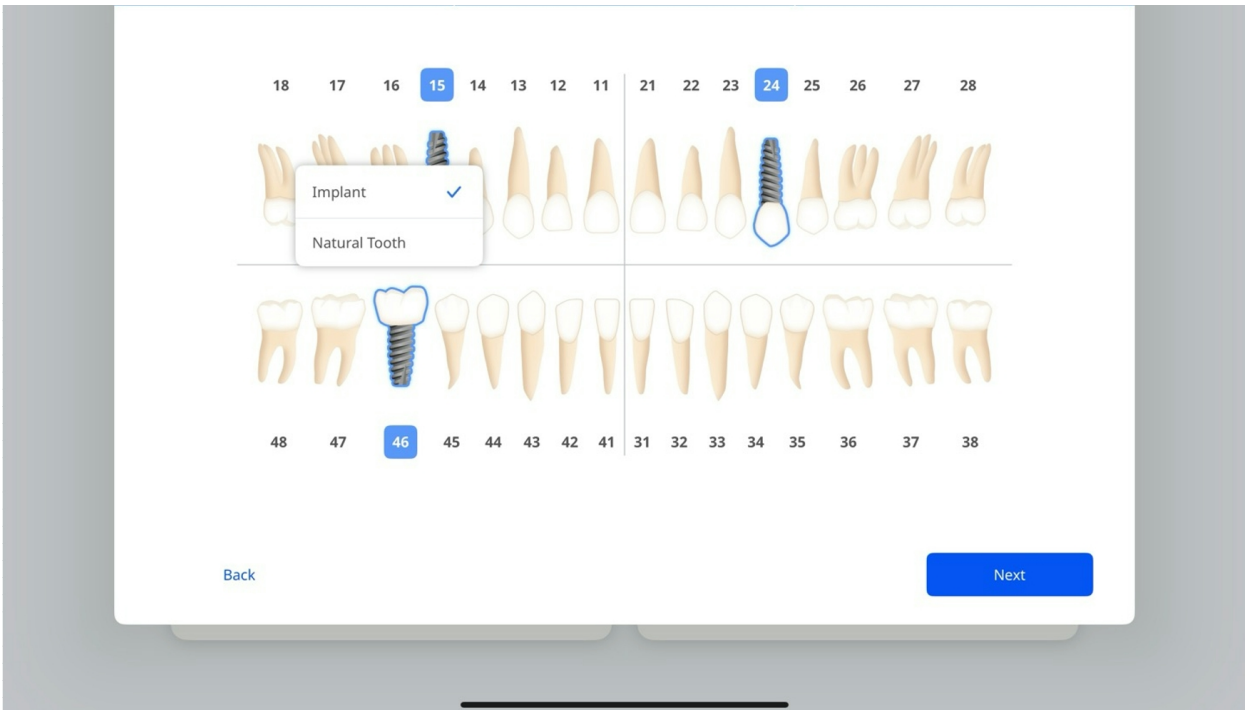

> 🔎**重要資訊**
>
> 若要在US與FDI系統間切換，請前往**設定** > **常規設定**。

步驟 4：選擇牙齒或牙顎——矯正掃描

選取需要治療的上顎弓、下顎弓，或上下顎弓皆選，然後點選**下一步**。

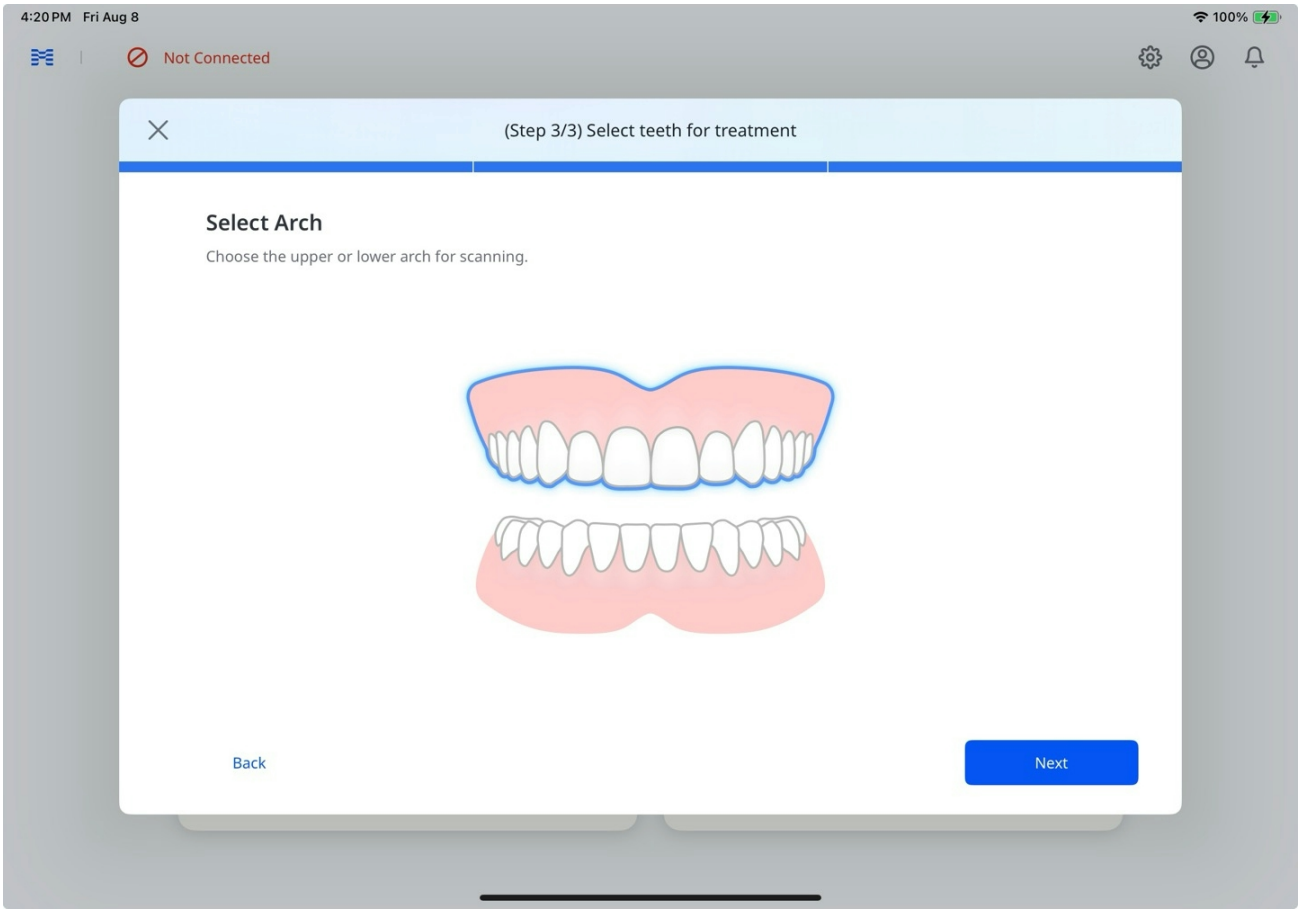

使用現有的Express Scan

如果患者有可用的近期**Express Scan**案例，則系統會顯示**可用的Express Scan** 對話方塊。選取**使用現有掃描**以載入掃描數據，或選取**開始新掃描**即可在不使用該類掃描數據的情況下直接開始操作。

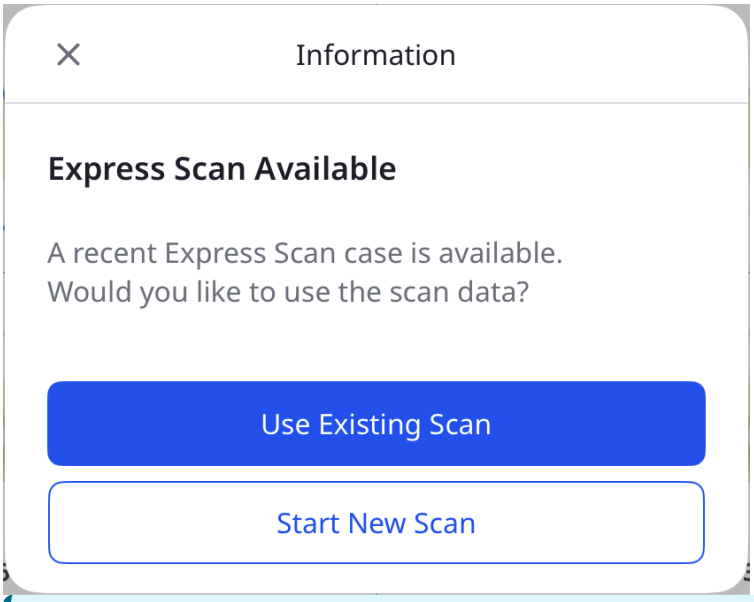

> 🔎**重要資訊**
>
> 我們建議將匯入的數據用於診斷或作為對頜牙弓數據。

步驟 5：掃描&檢視

有關掃描和檢視數據的詳細資訊，請參閱上方Express Scan：先掃描，後添加章節中的步驟4–8。如需處理完成後的選項，請參閱同一章節中的步驟12。

🔎重要資訊

若掃描中斷，主畫面的**管理患者**卡片下方會顯示**未完成的掃描**標籤（參見下方截圖）。點選此標籤以開啟**未完成的掃描**視窗，您可以在此捨棄草稿，或從中斷處繼續掃描。

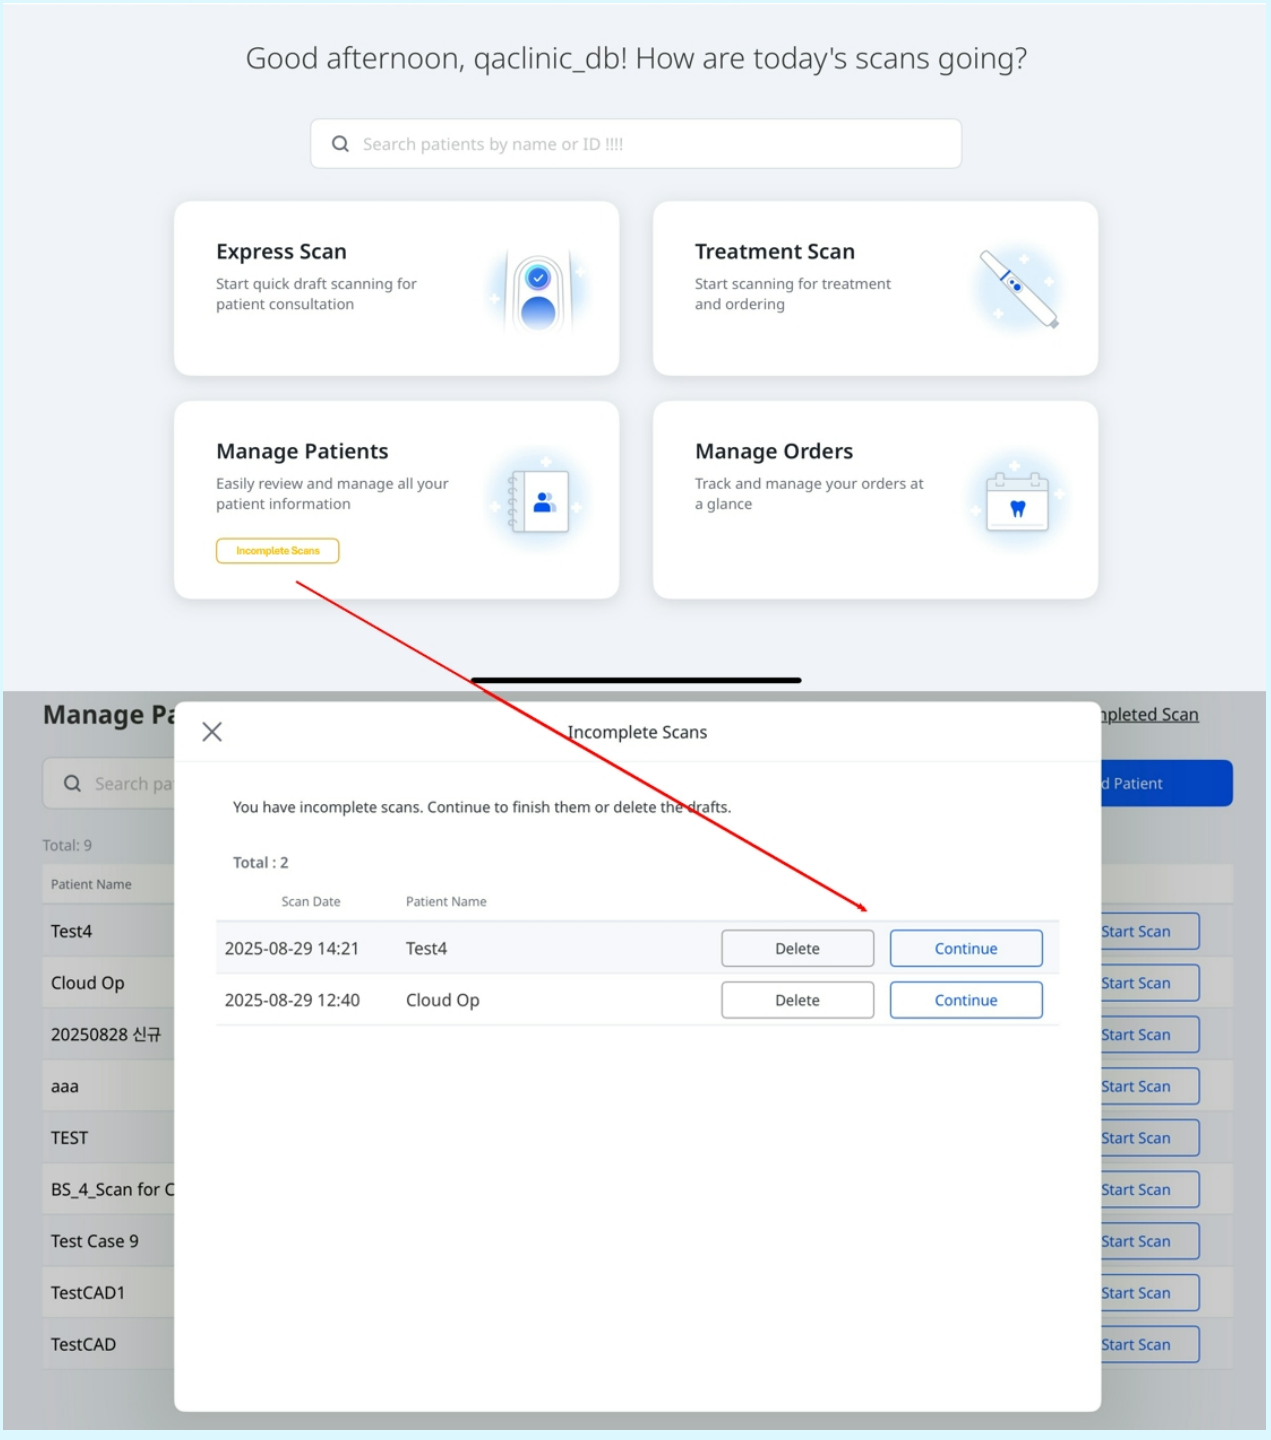

步驟 6：訂單

完成數據檢視後，請依下列步驟下單：

1. 點選**訂單**。

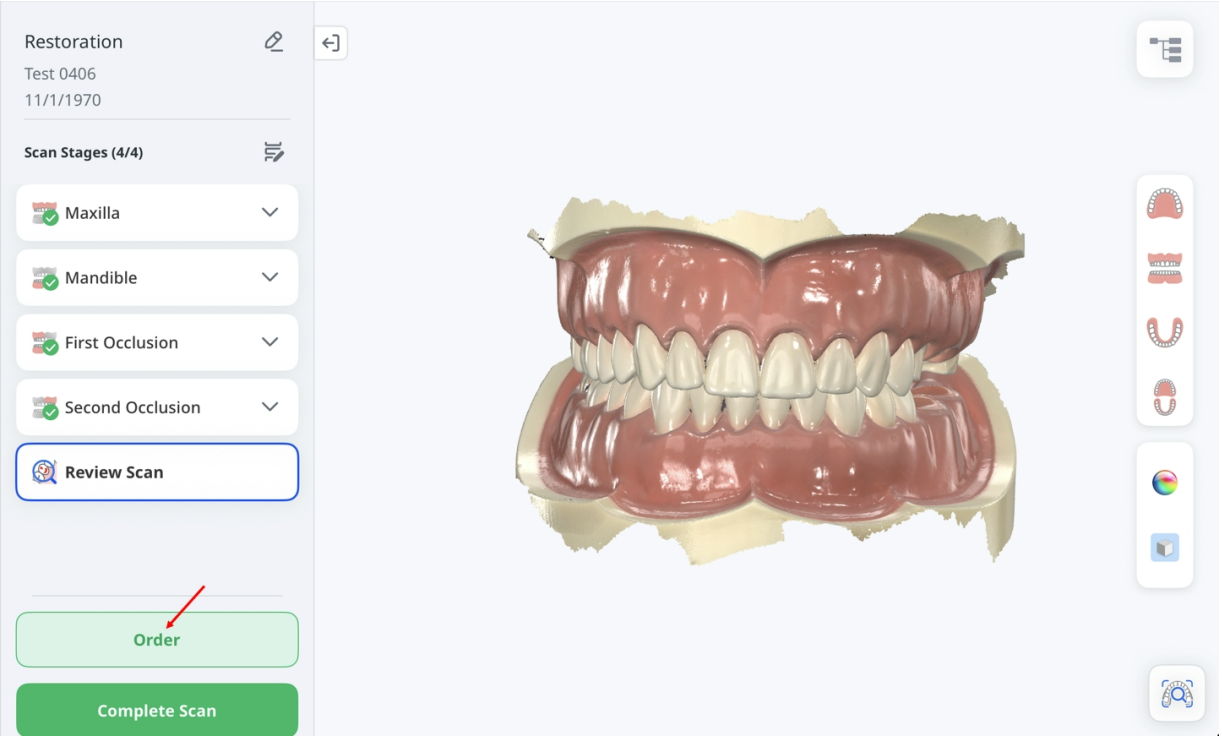

2. 出現**數據處理選項**視窗時，選擇保持原始數據不變（原始）或自動填補較大缺口（自動修復）。

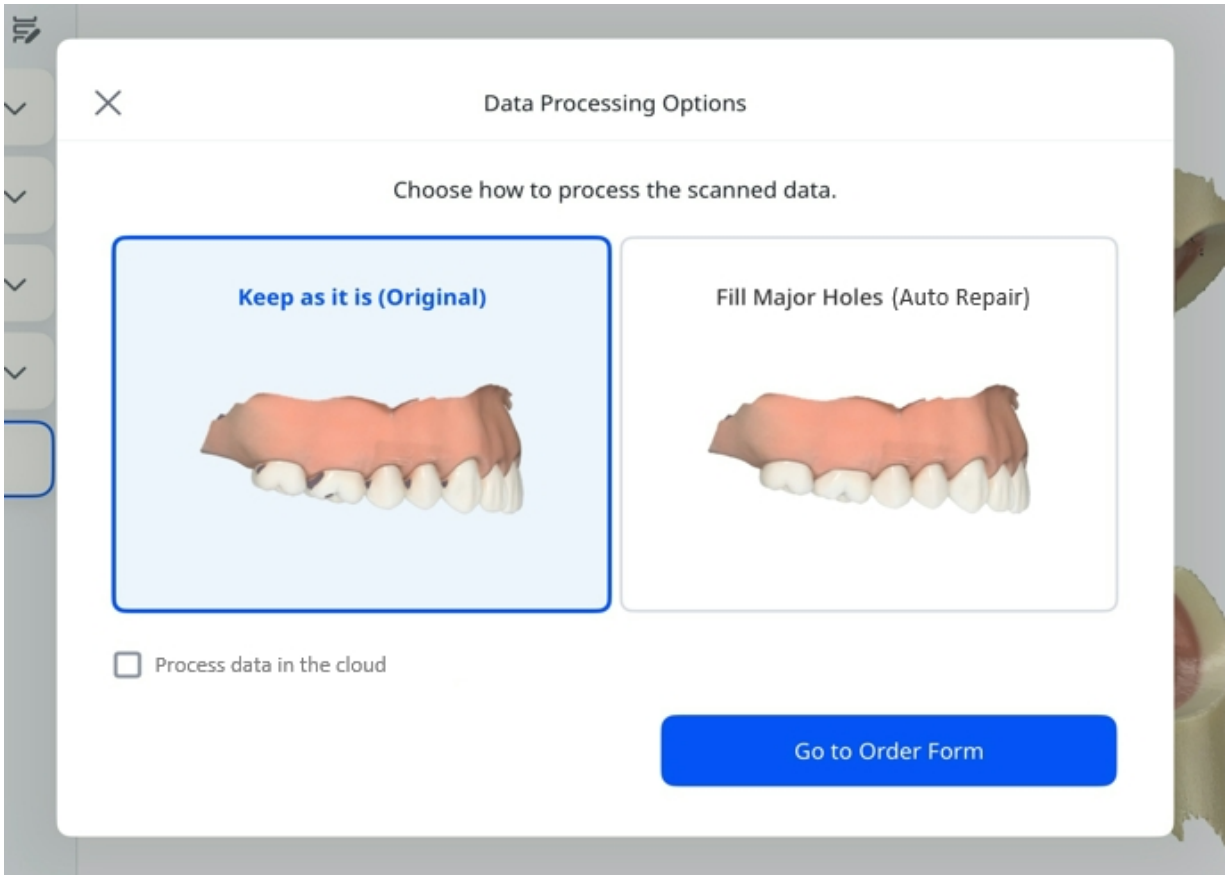

3. 若要在雲端處理數據，請勾選該核取方塊。完成後，點選**轉至「訂單表單」**。

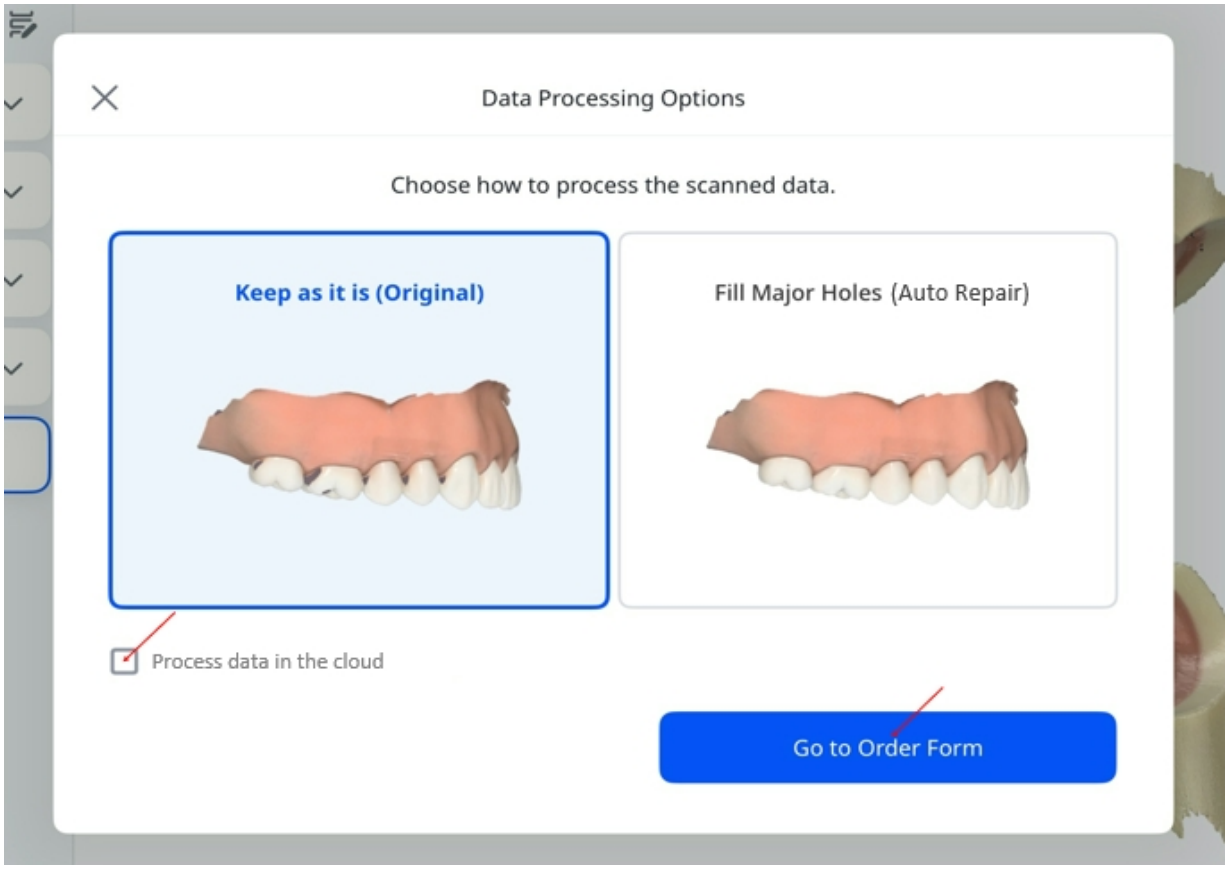

4. 輸入必要資訊以完成**訂單表單**填寫。視需要添加選填詳細資訊。操作完成後，點選**提交訂單**以最終完成訂單。

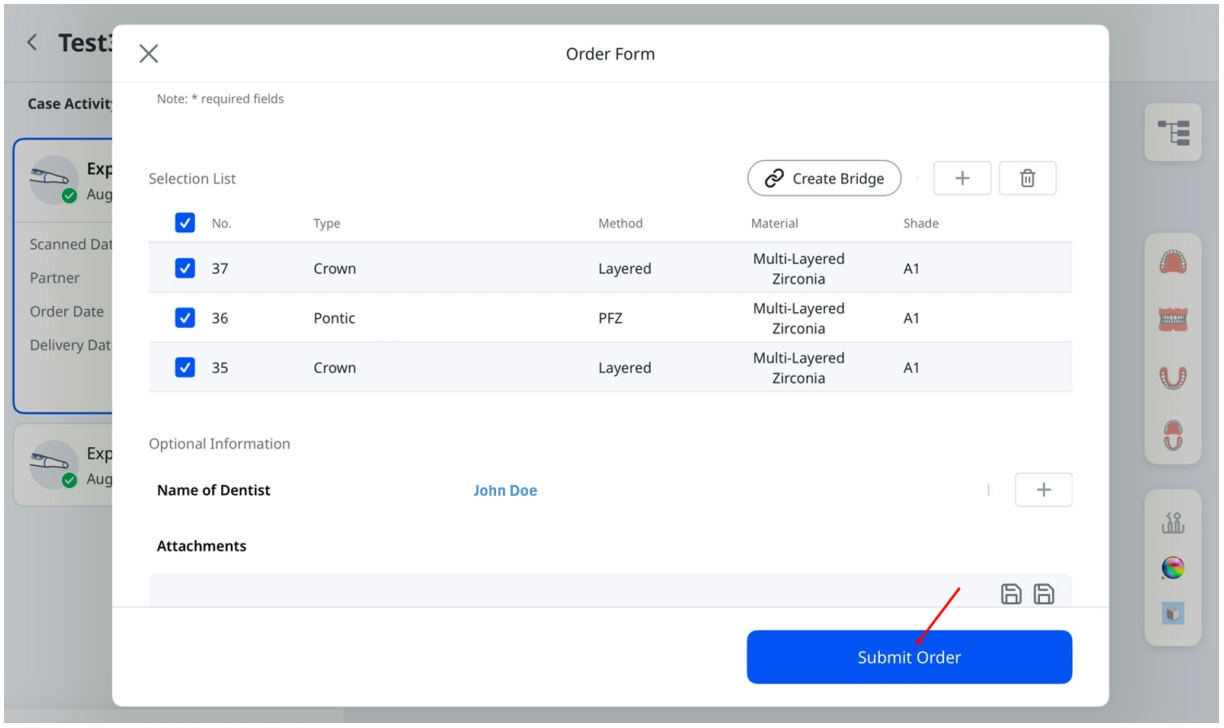

步驟7：管理訂單

若要查看訂單詳細資訊並追蹤其狀態：

1. 在主畫面點選**管理訂單**。

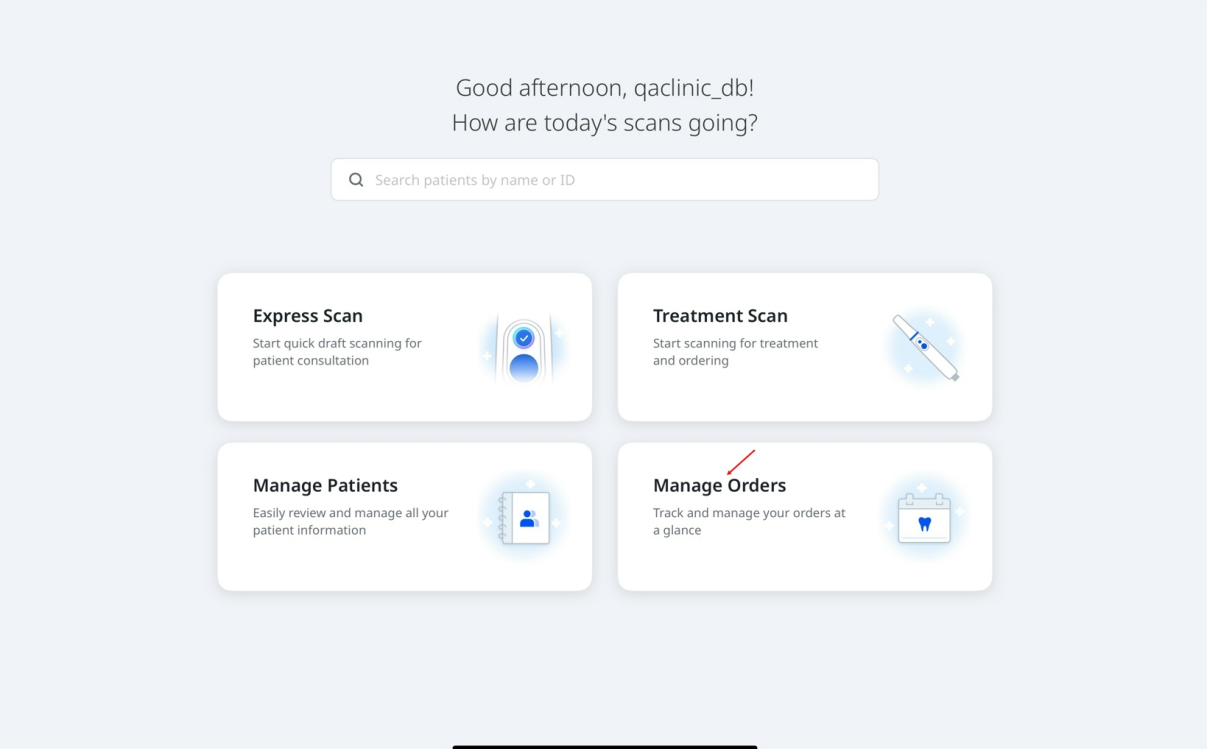

2. 將開啟**管理訂單**畫面，您可以查看訂單詳細資訊、依狀態篩選訂單，以及依訂單資訊進行搜尋。在列表中點選一筆訂單以打開其概述頁並查看更多資訊。

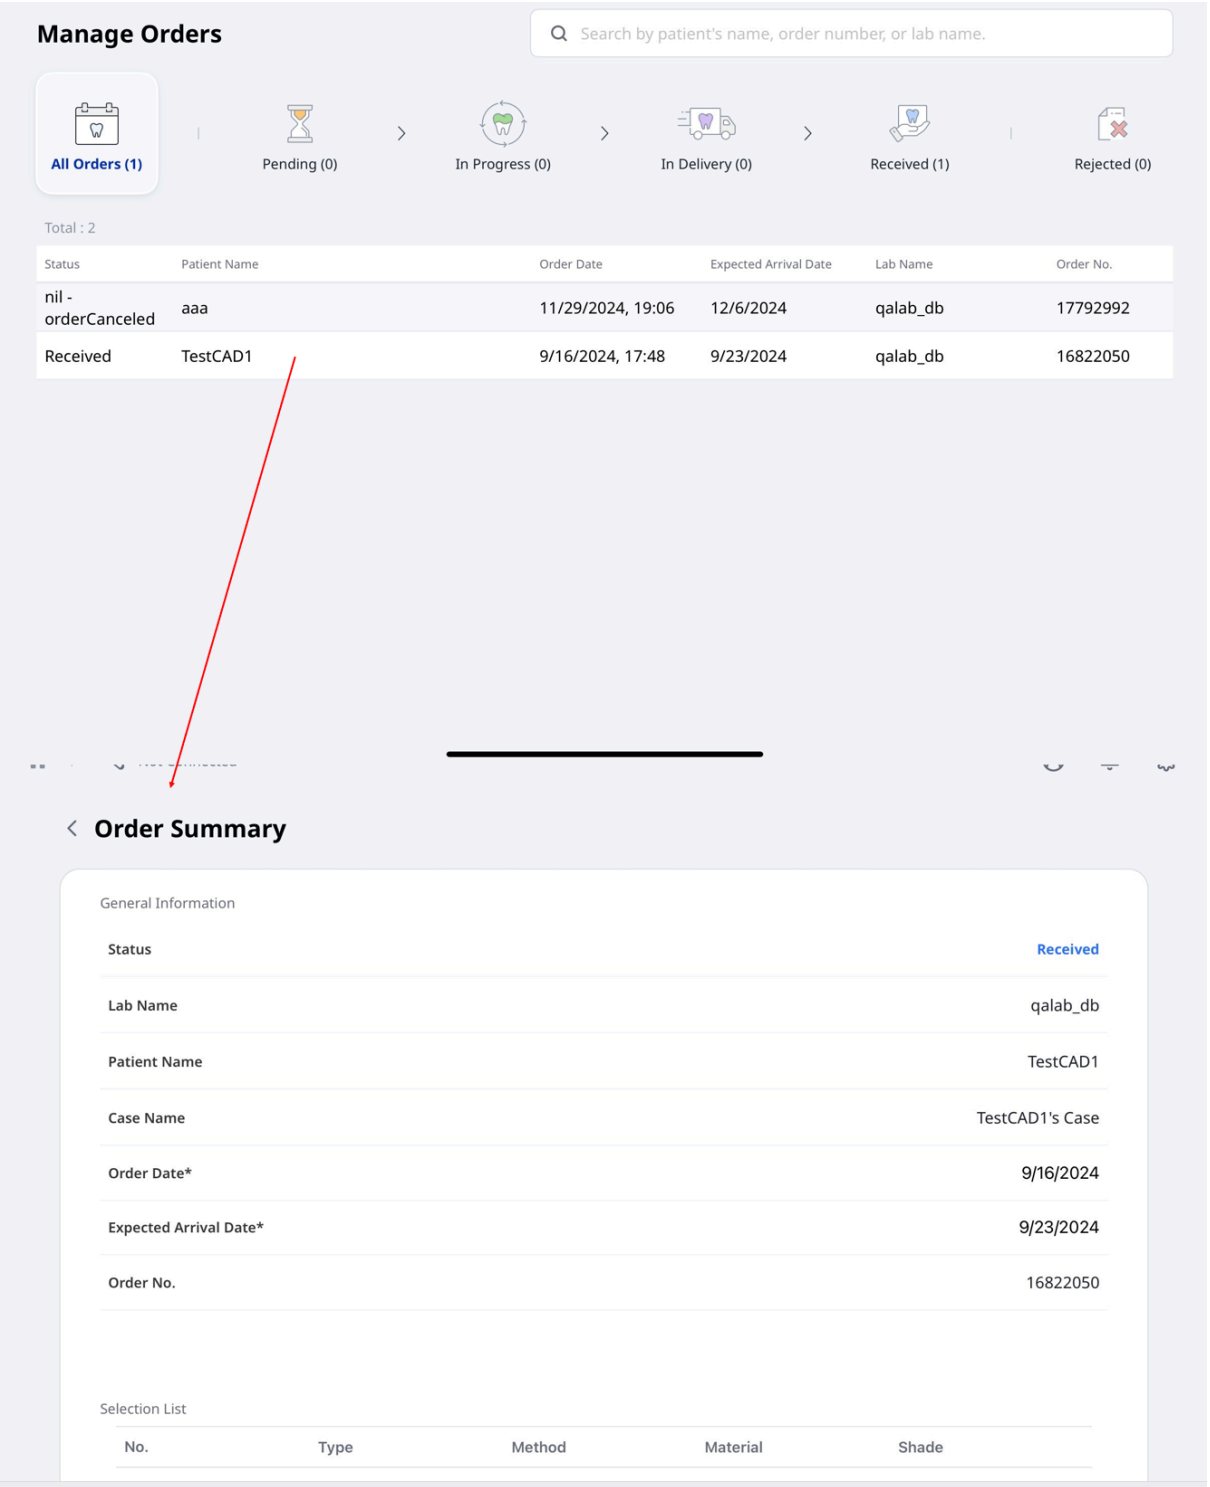
Manage Orders
Search by patient's name, order number, or lab name.
All Orders (1)
Pending (0)
In Progress (0)
In Delivery (0)
Received (1)
Rejected (0)
Total : 2
Status
Patient Name
Order Date
Expected Arrival Date
Lab Name
Order No.
nil - orderCanceled
aaa
11/29/2024, 19:06
12/6/2024
qalab_db
17792992
Received
TestCAD1
9/16/2024, 17:48
9/23/2024
qalab_db
16822050
Order Summary
General Information
Status
Received
Lab Name
qalab_db
Patient Name
TestCAD1
Case Name
TestCAD1's Case
Order Date*
9/16/2024
Expected Arrival Date*
9/23/2024
Order No.
16822050
Selection List
No.
Type
Method
Material
Shade

管理患者

添加患者

1. 在主畫面，點選**管理患者**，然後在下一個畫面點選**添加患者**。

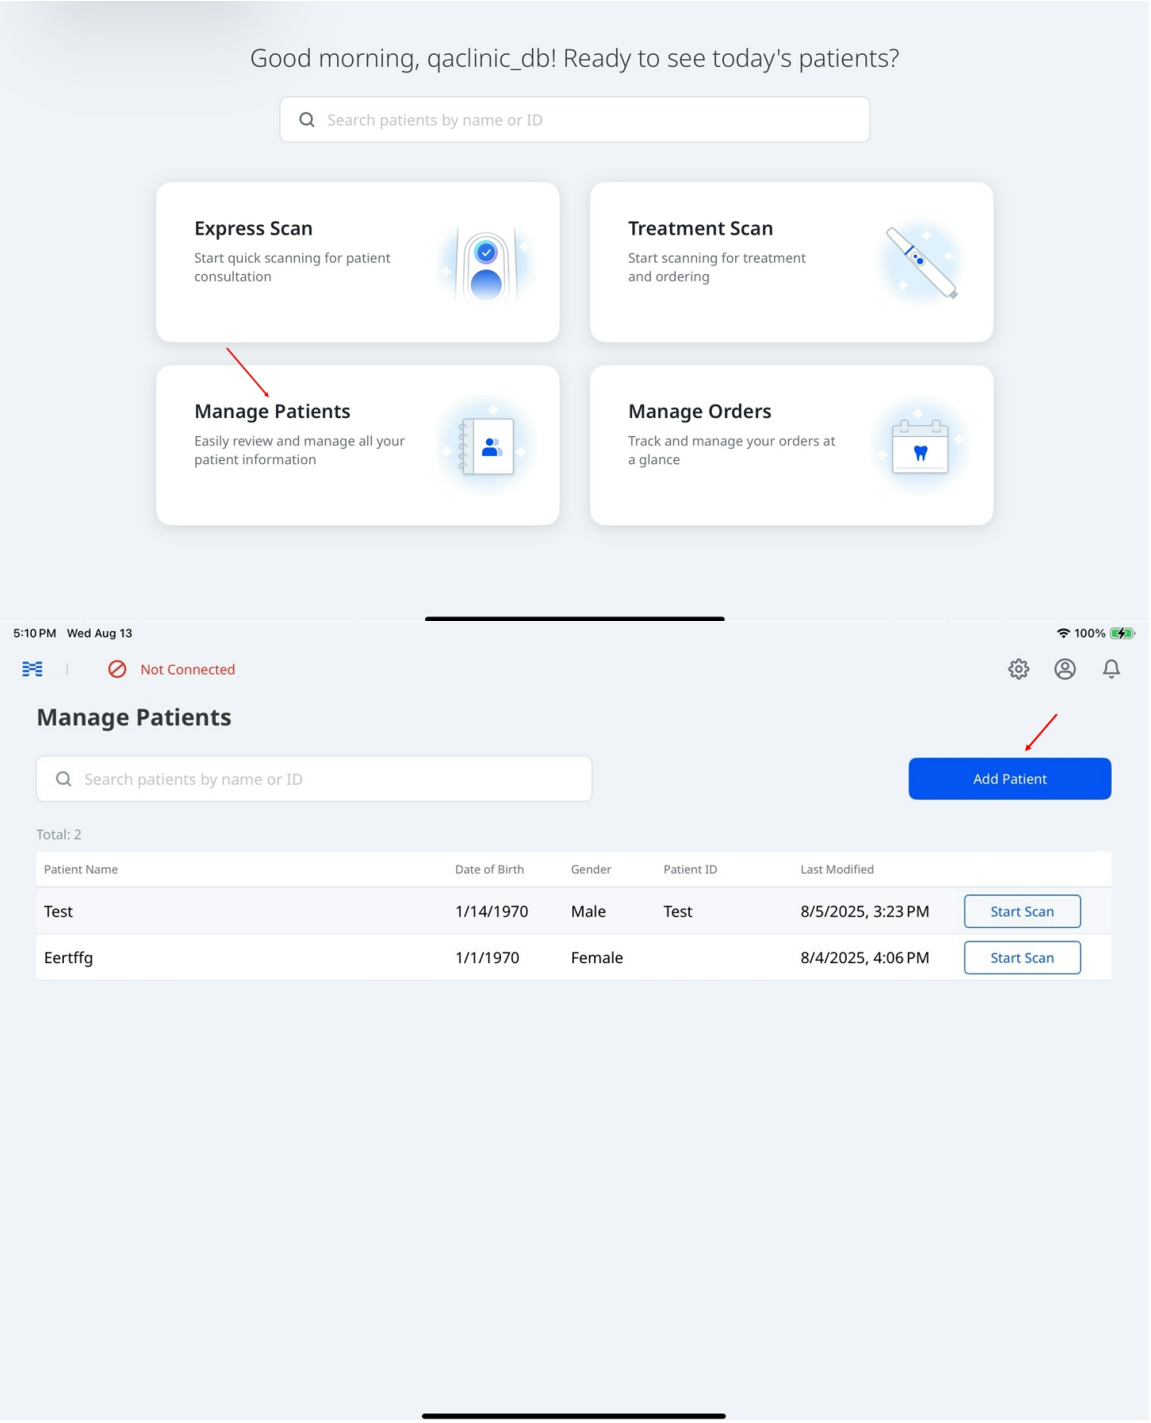

2. 輸入必要的詳細資訊——患者姓名、出生日期及性別。選填其ID。

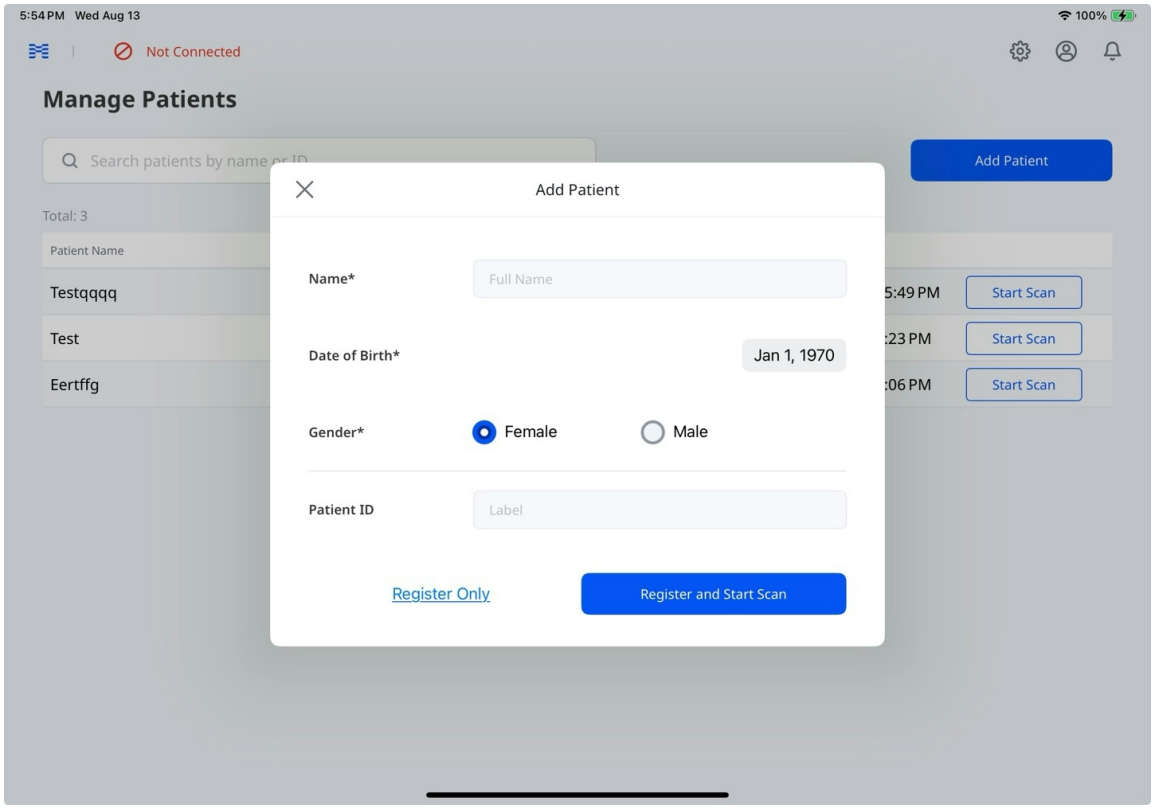

3. 點選**僅註冊**以在未開始掃描的情況下保存患者資訊，或點選**註冊並開始掃描**以保存患者資訊並開始掃描。

編輯和刪除患者資訊

1. 在主畫面，點選**管理患者**。
2. 選取您要編輯或刪除其資訊的患者。

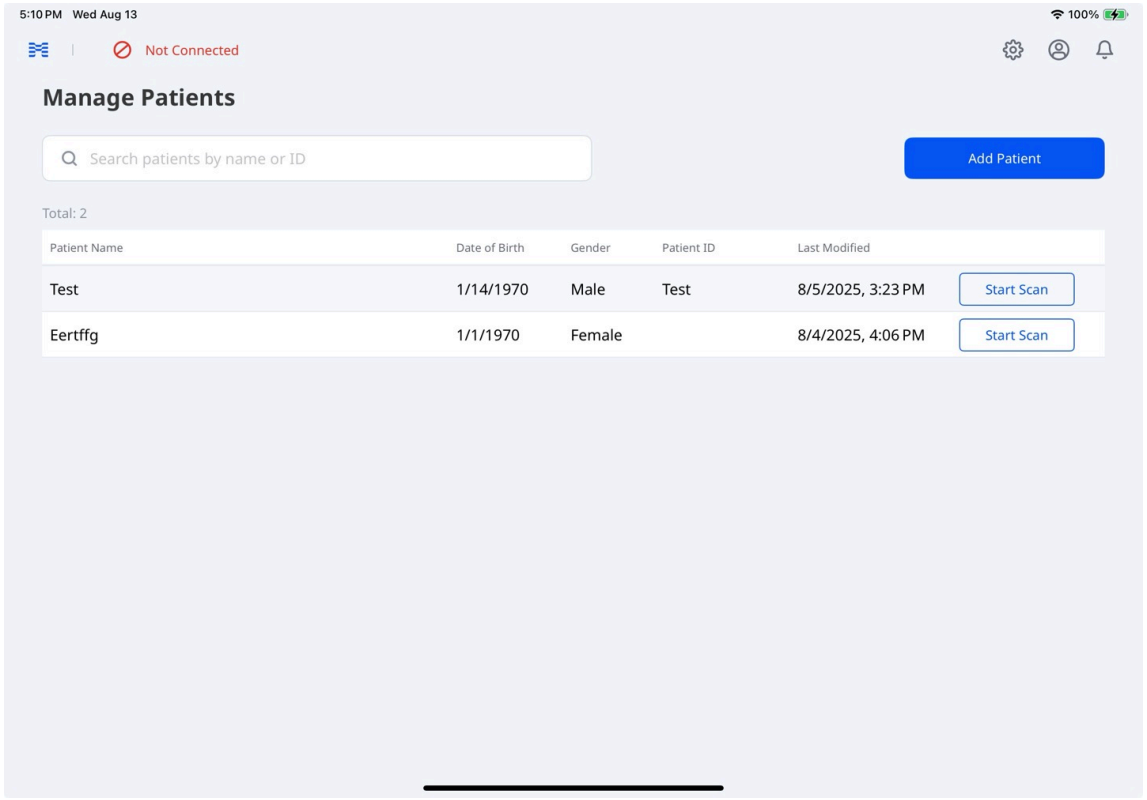

3. 在患者的案例畫面上，選取患者姓名旁的鉛筆圖示。

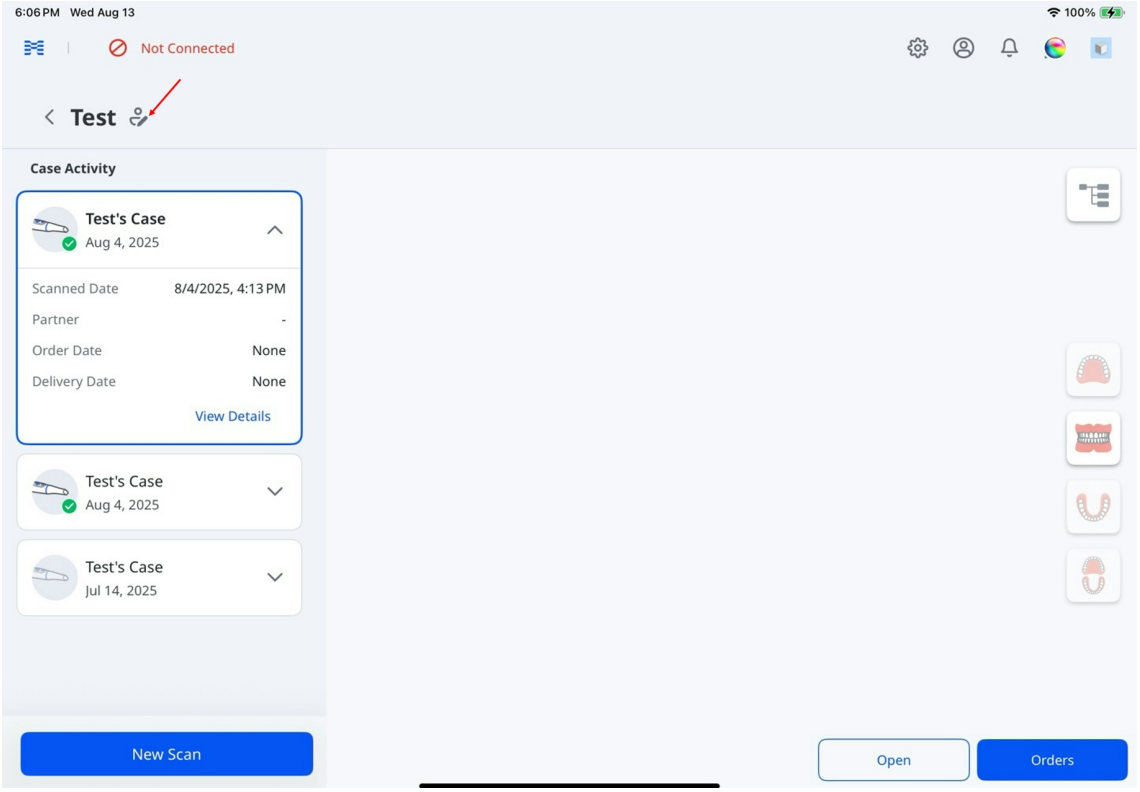

4. 更新患者資訊並點選**保存**。

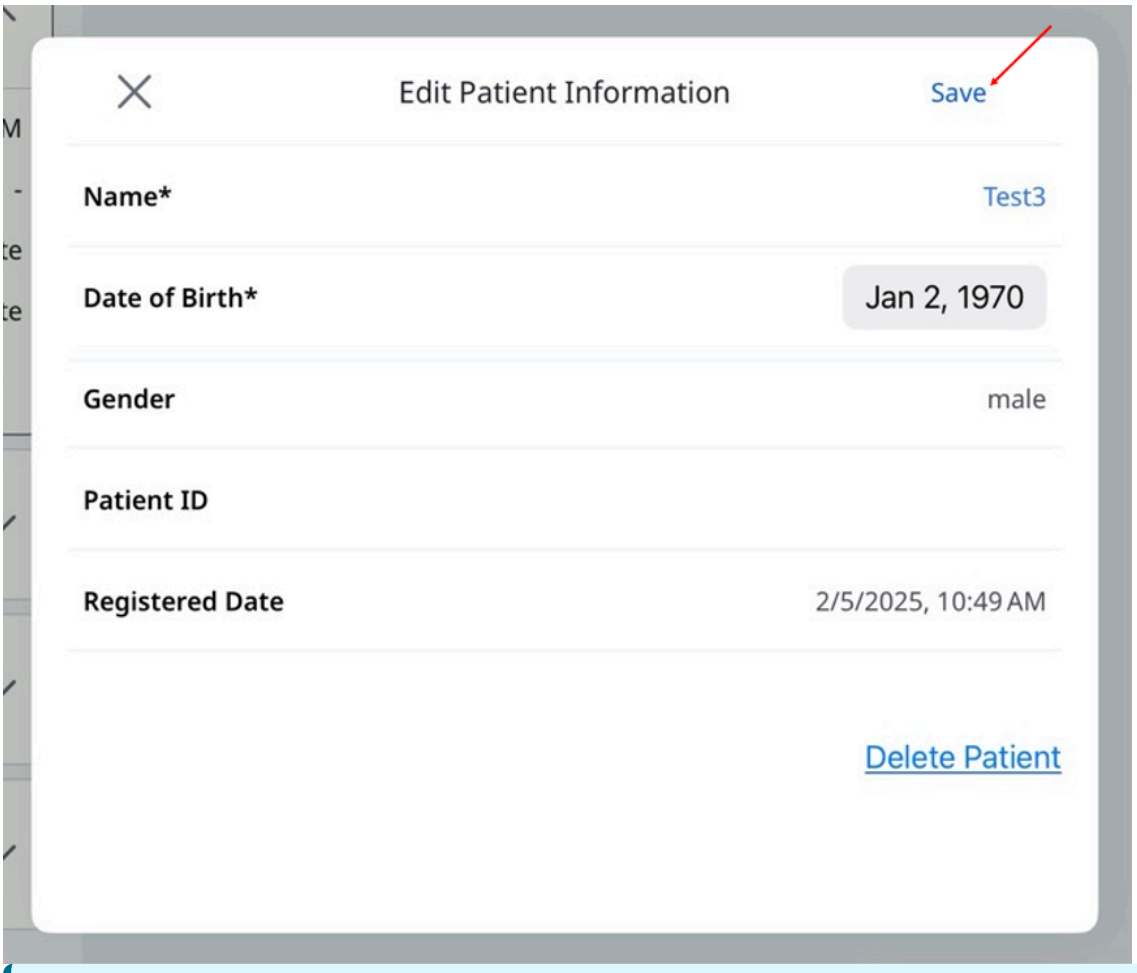

> 🔎**重要資訊**
>
> 選取**刪除患者**，然後在確認對話方塊中選取**刪除**，以永久刪除患者資訊。

管理案例

在**案例活動** 中按住案例，以存取**複製**、**原始檔案上傳** 和 **刪除** 等選項。

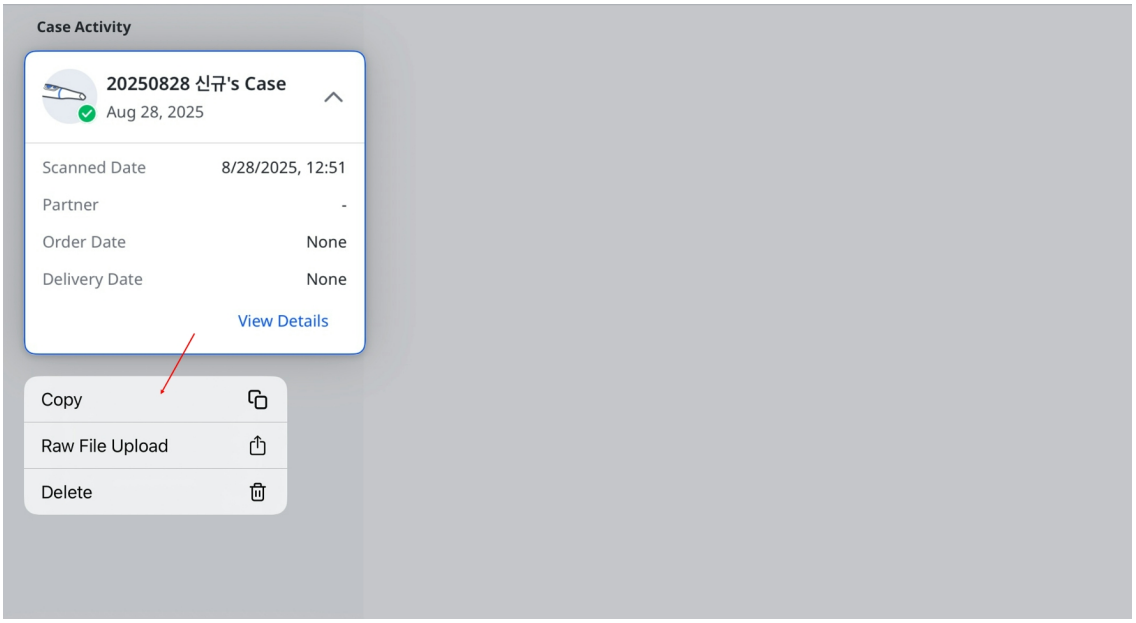

🔎重要資訊

選取**刪除**，然後在確認對話方塊中再次選取**刪除**，以永久刪除案例。

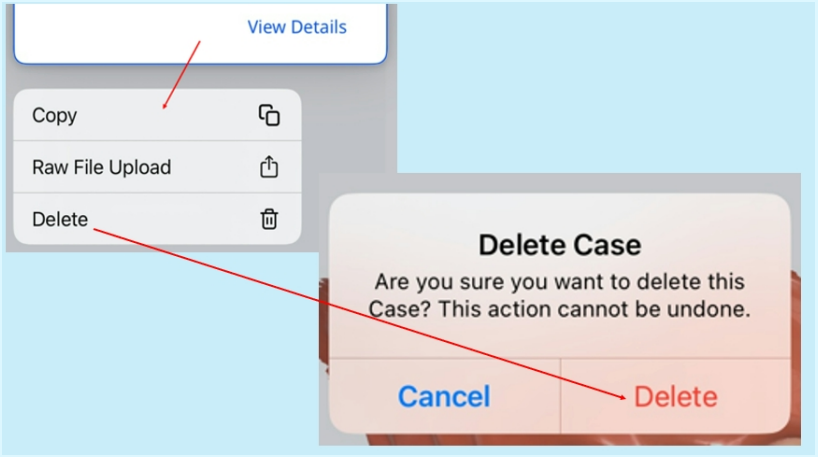

案例狀態

狀態	描述	指示圖示	備註
草稿	該案例已建立但尚未提交		在上傳到雲端之前，該案例會作為暫存檔案儲存在本機。若應用程式意外關閉或當機，會出現此狀態。
需處理	該案例已完成掃描，但需要進行後期處理		案例已儲存至雲端，但後期處理尚未完成。

狀態	描述	指示圖示	備註
處理中	後期處理進行中		–
處理失敗	該案例已完成掃描，但後期處理失敗		–
掃描已完成	該案例已完成掃描並處理成功		此狀態也包含被技工所拒絕的案例。
已下單	該案例已成功下單。		如需訂單狀態的詳細資訊，請前往 管理訂單>追蹤訂單。

檢視和管理案例數據

在**案例活動**中選取一個案例，即可在數據樹中查看其掃描數據和附件。

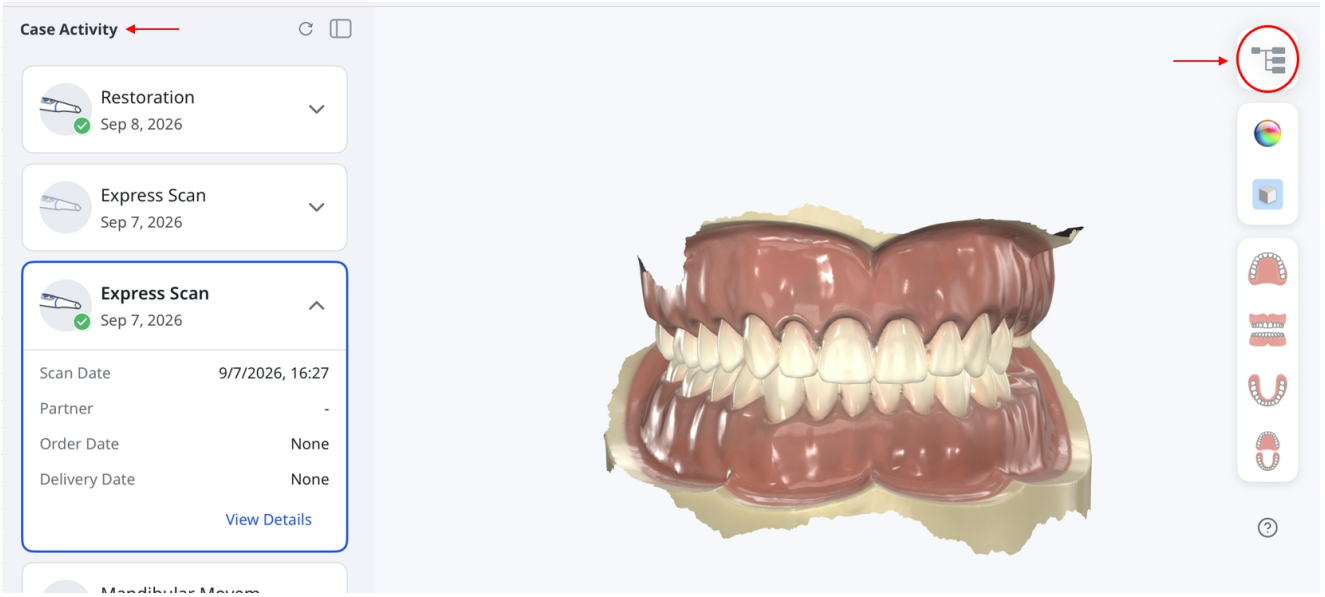

檢視數據

展開或摺疊群組以瀏覽數據。使用顯示/隱藏控制項和不透明度滑桿，調整支援的3D數據的顯示效果。

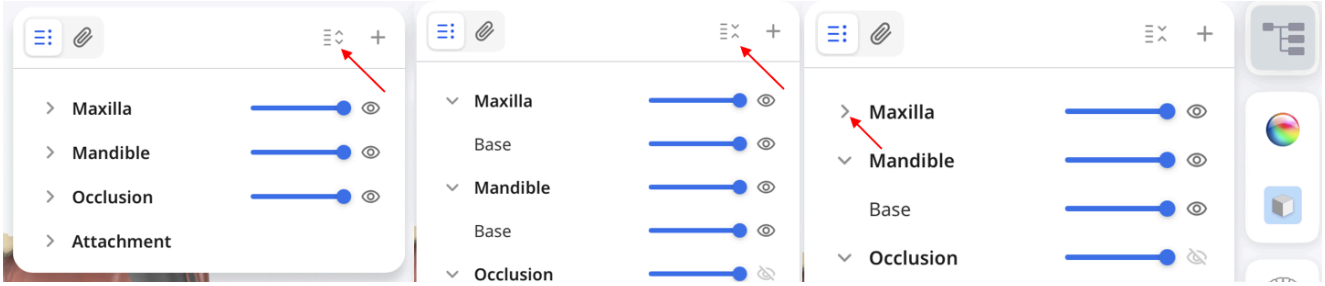

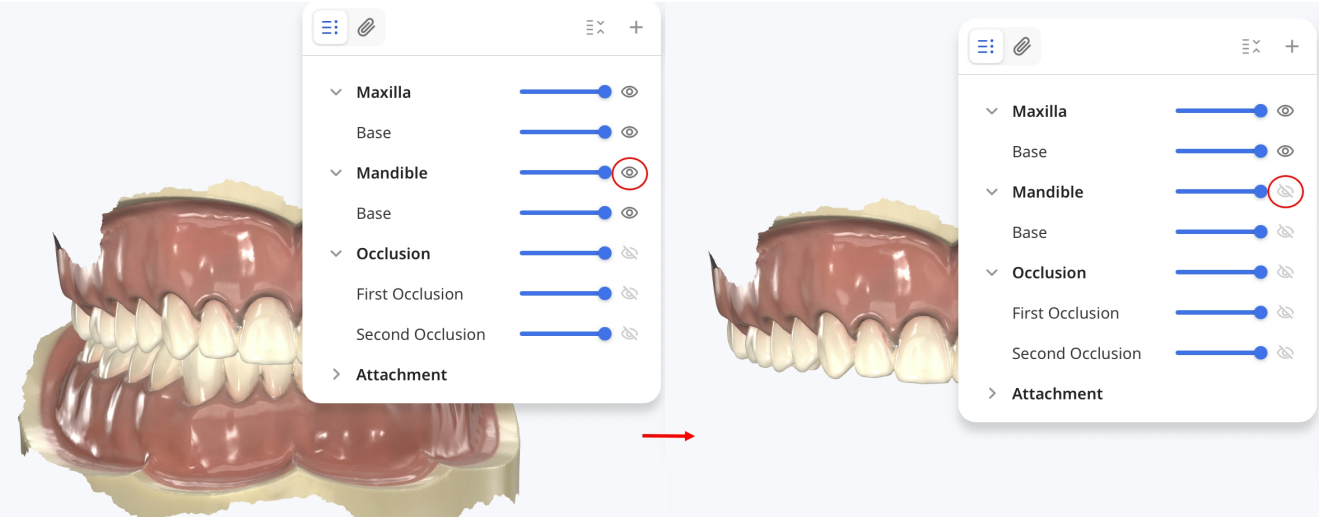

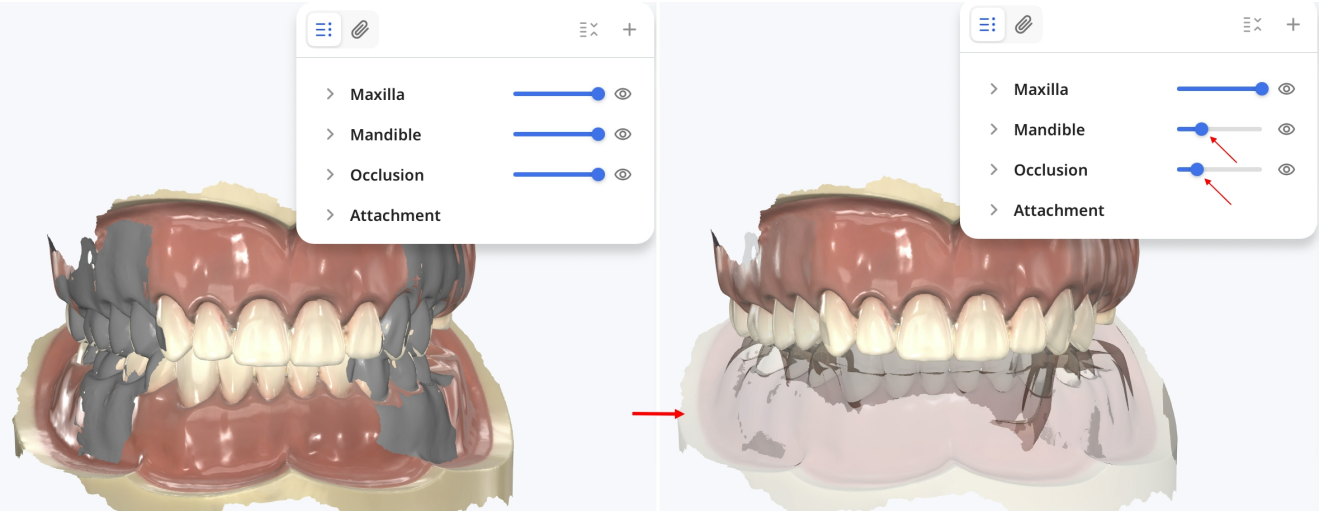

添加及檢視附件

選取**+**將檔案添加至案例。在iPad上，選取**檔案**或**照片**即可選擇現有檔案，或選取**拍攝照片或影片**即可使用 iPad 相機拍攝照片或錄製影片。在Mac上，您也可以將檔案拖放至數據樹中。

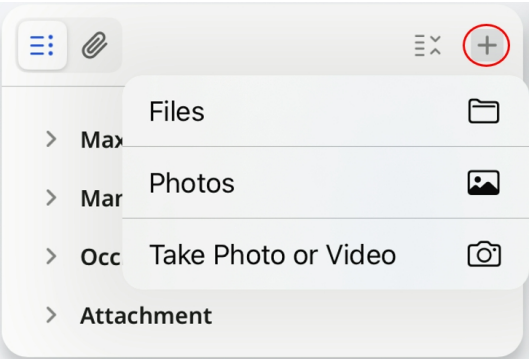

> **🔎重要資訊**
>
> 您也可以在「案例詳細資訊」或「訂單表單」的 **附件** 區段中添加檔案。

選取迴紋針圖示以瀏覽支援預覽的附件，包括使用**高清相機**拍攝的影像。選取任一支援的影像、影片或PDF即可預覽。

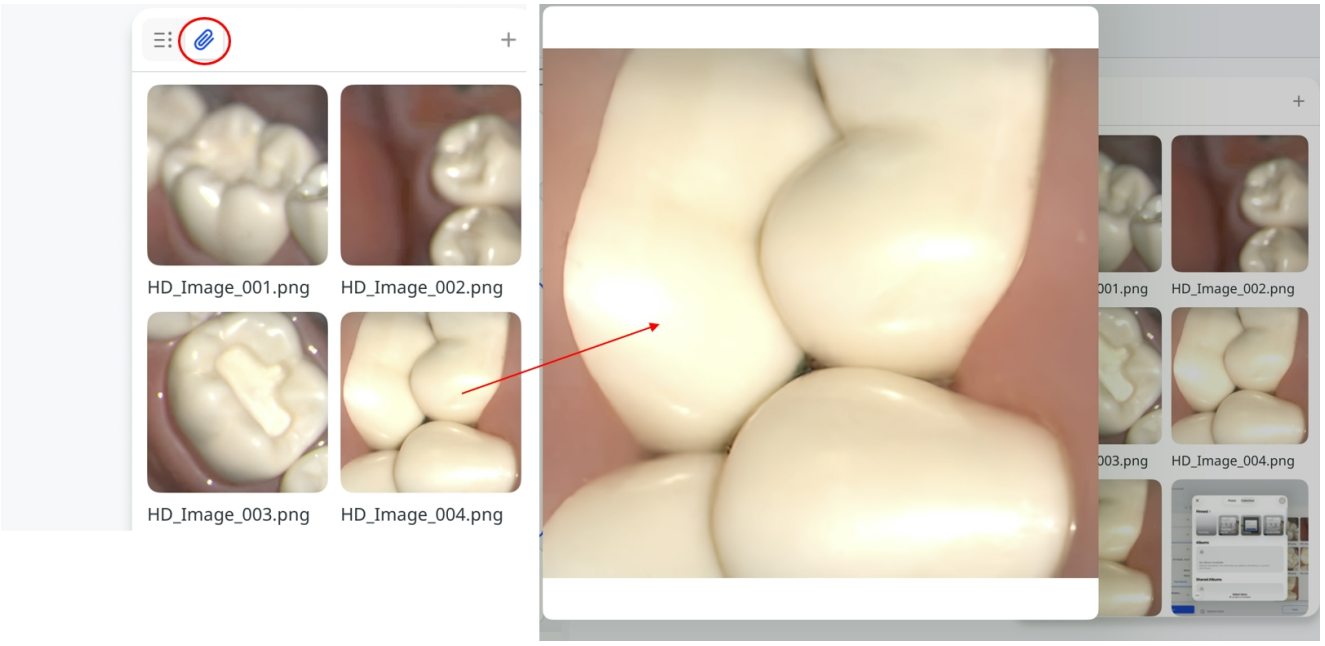

同步檔案

選取同步圖示以同步待處理的檔案。



在Web應用程式中開啟案例

您可以透過Web應用程式使用掃描數據建立患者諮詢報告。

- Medit AuraVue：使用3D掃描數據和X光影像建立視覺化報告，以協助進行患者溝通。
- **Medit Checkpoint**：建立並分享牙科檢查結果的數位摘要。

在**案例活動**中選取一個案例，點選**開啟**，然後選取一個Web應用程式。

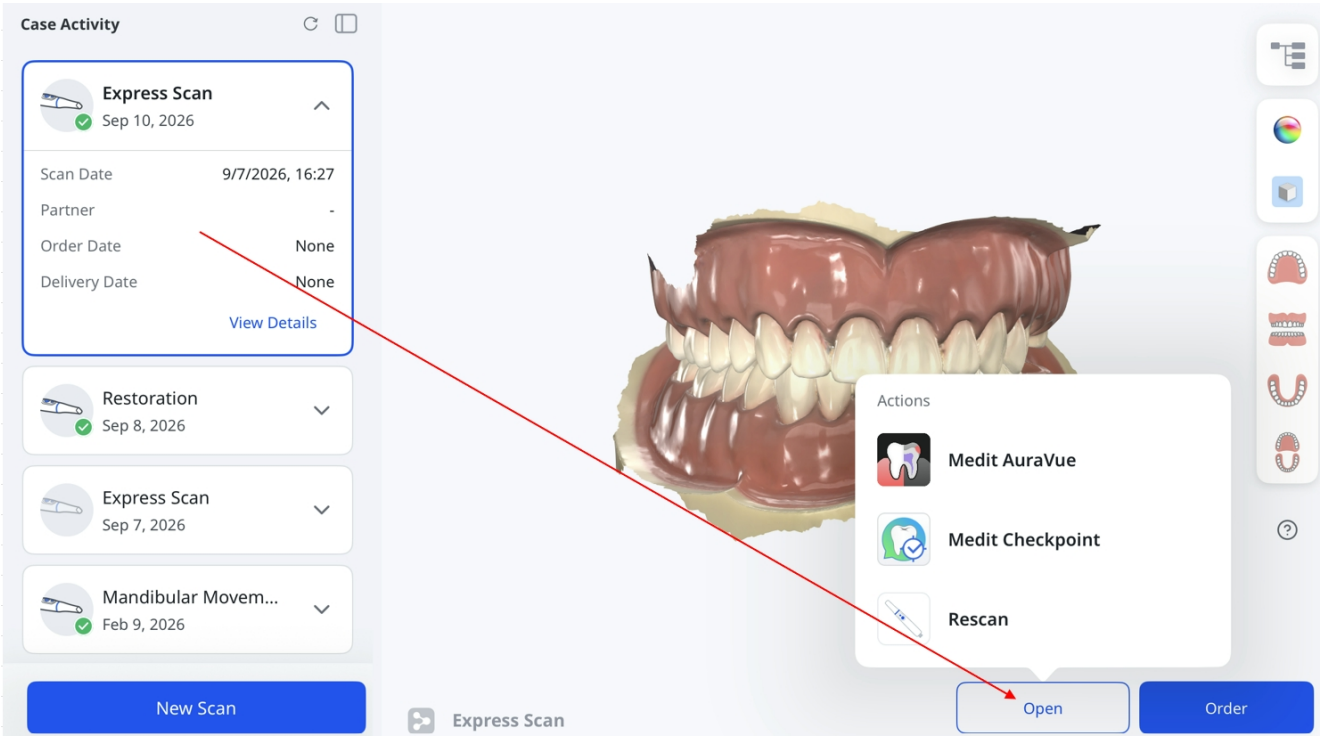

🔎重要資訊

- 在**設定>應用程式設定**中開啟您要使用的應用程式。
- 對於已下單的案例，請在啟動Web應用程式前先複製案例。
- 若要返回掃描，請選取**重新掃描**。

管理訂單

本節提供逐步指南，說明如何查看訂單歷史、進行必要變更，並順暢地處理與訂單相關的工作。

訂購案例

完成數據檢視後，請依下列步驟下單：

1. 點選**訂單**。

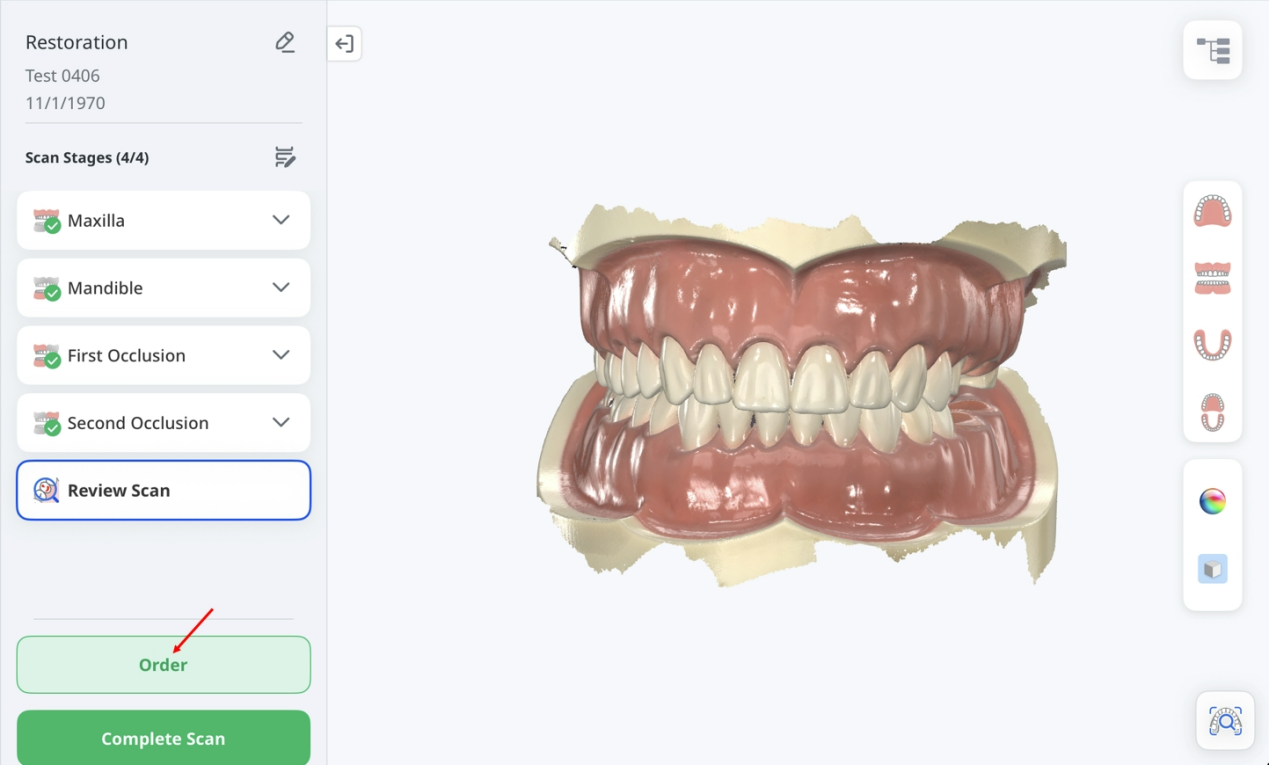

對於Express Scan案例，此畫面中不提供 **下訂單**按鈕。點選 **完成掃描**，然後從 **案例活動** 打開案例並點選 **訂單**。

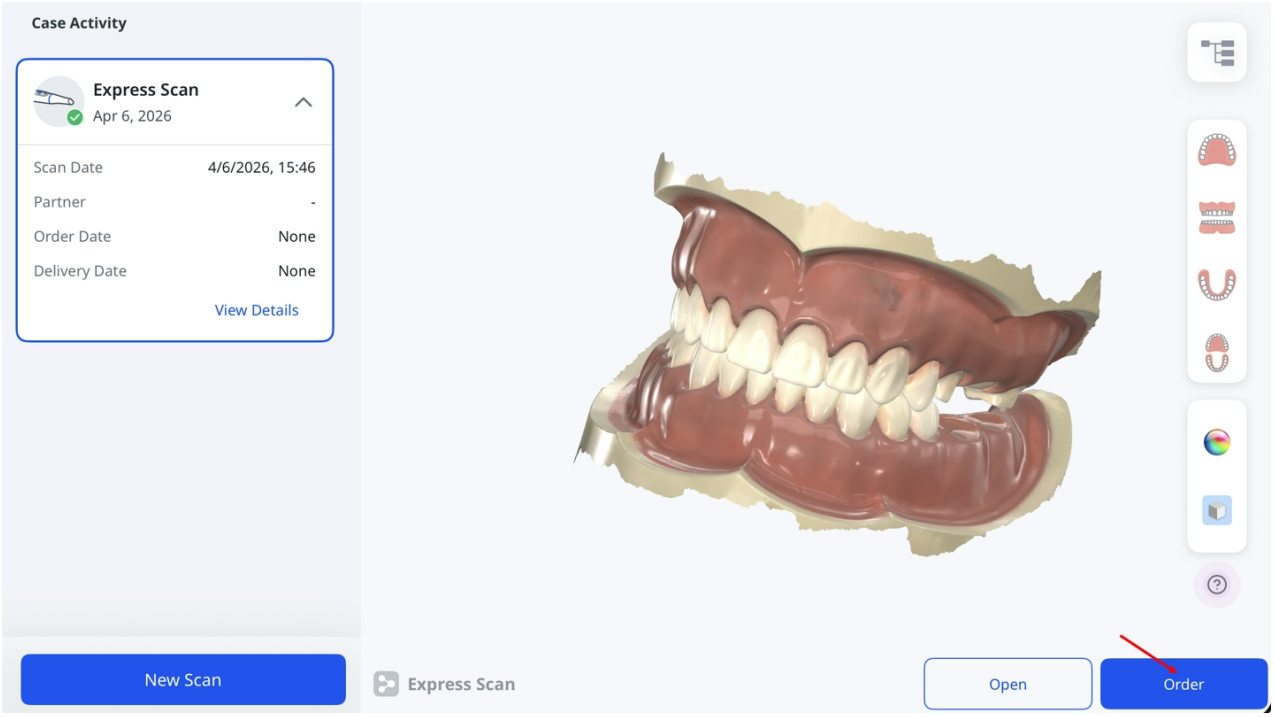

2. 出現**數據處理選項**視窗時，選擇保持原始數據不變（原始）或自動填補較大缺口（自動修復）。

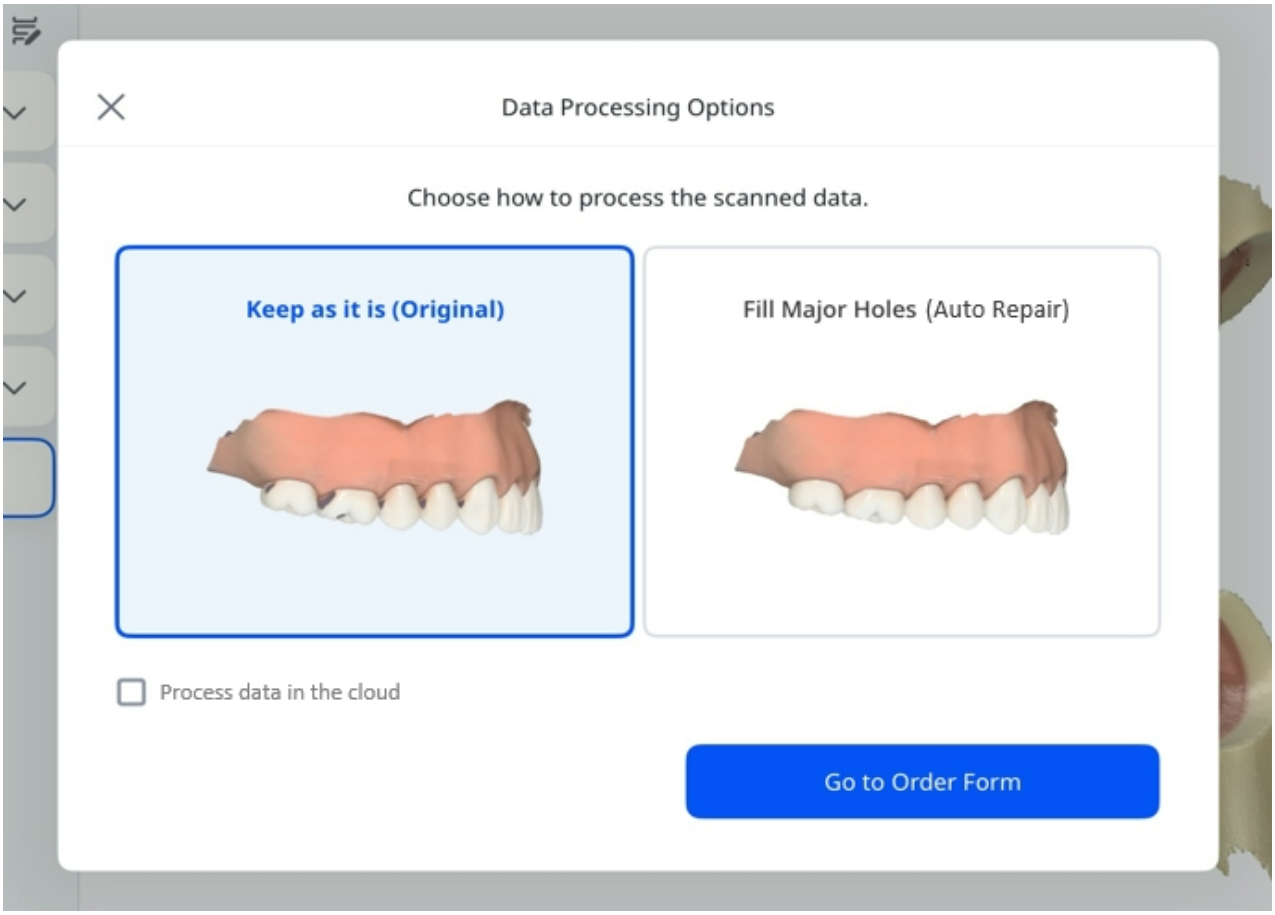

3. 若要在雲端處理數據，請勾選該核取方塊。

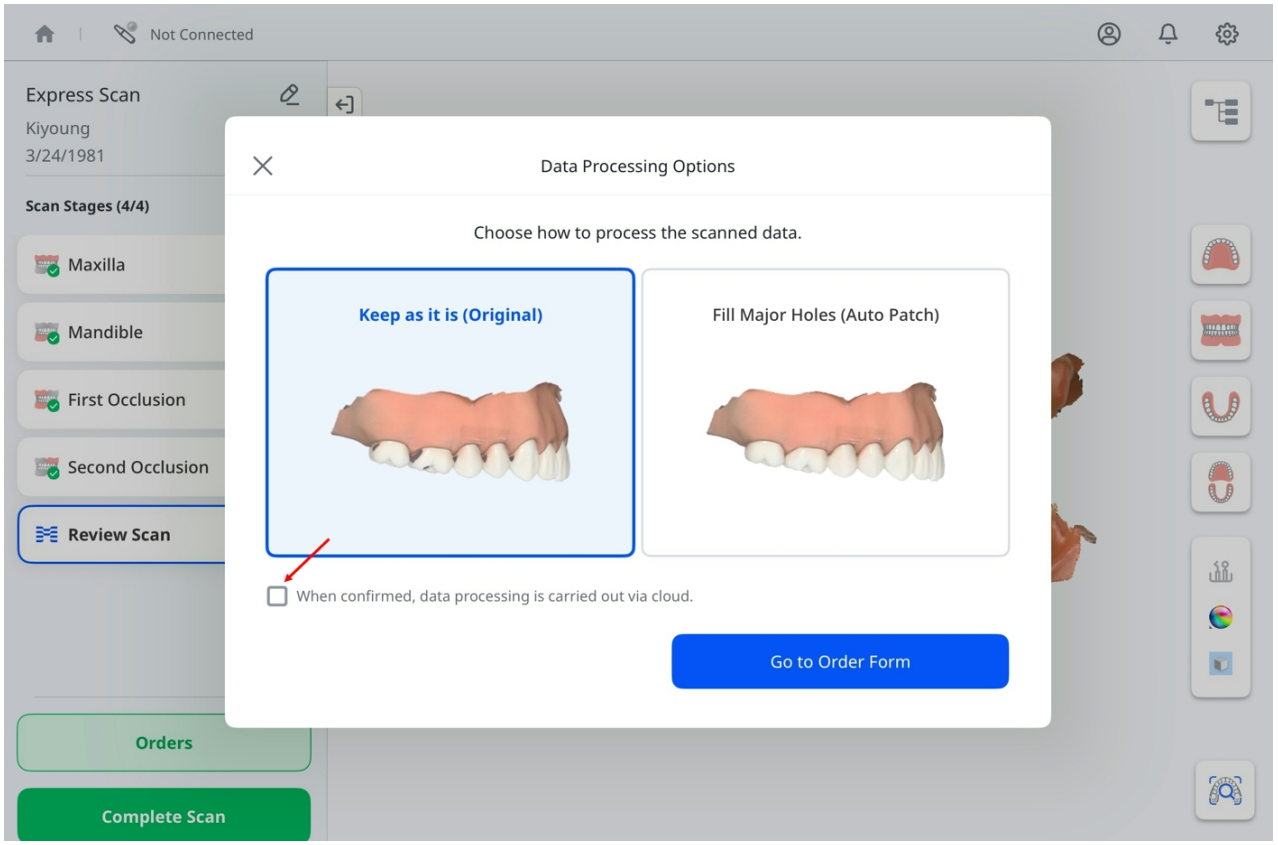

4. 完成後，點選**前往「訂單表單」**。

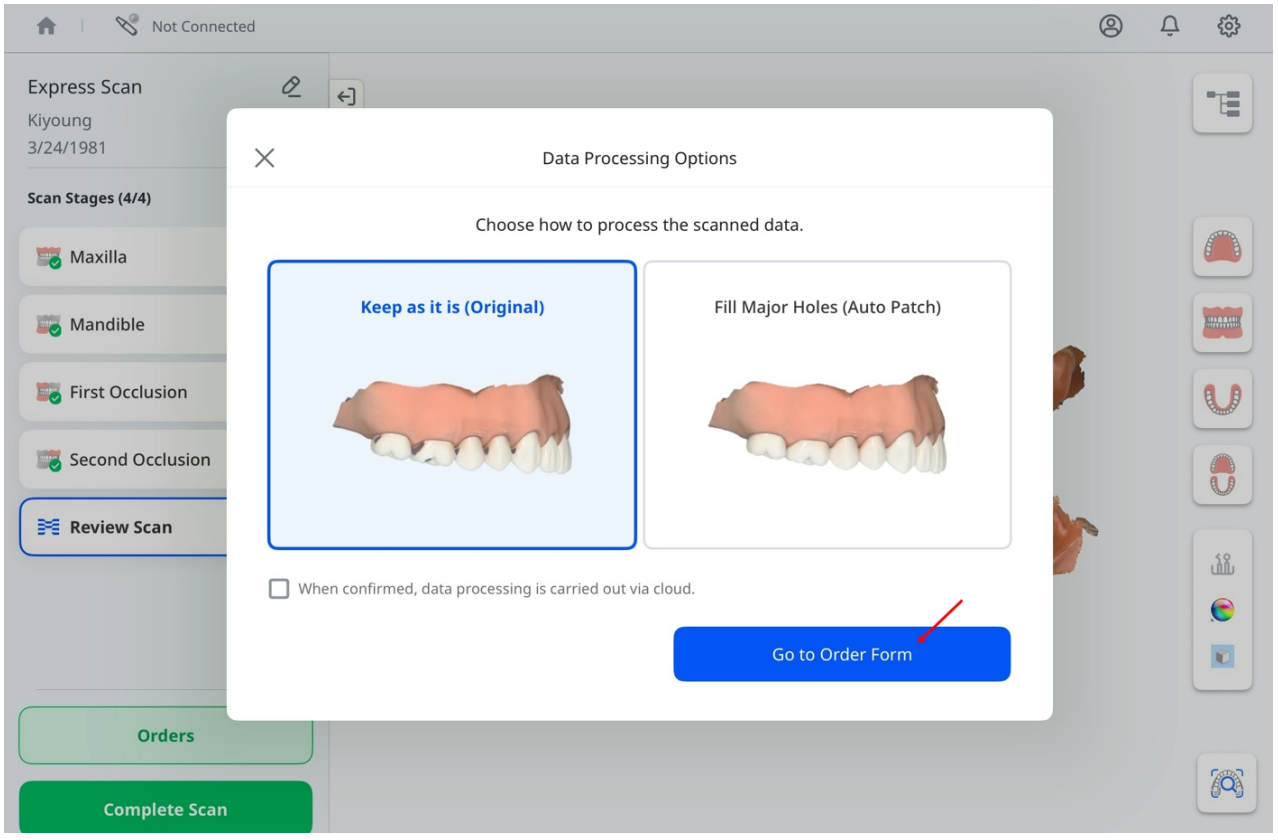

5. 當**訂單表單**視窗出現時，請務必填寫所有必填欄位，包括技工所名稱、患者資訊，以及偏好的交付日期與時間。

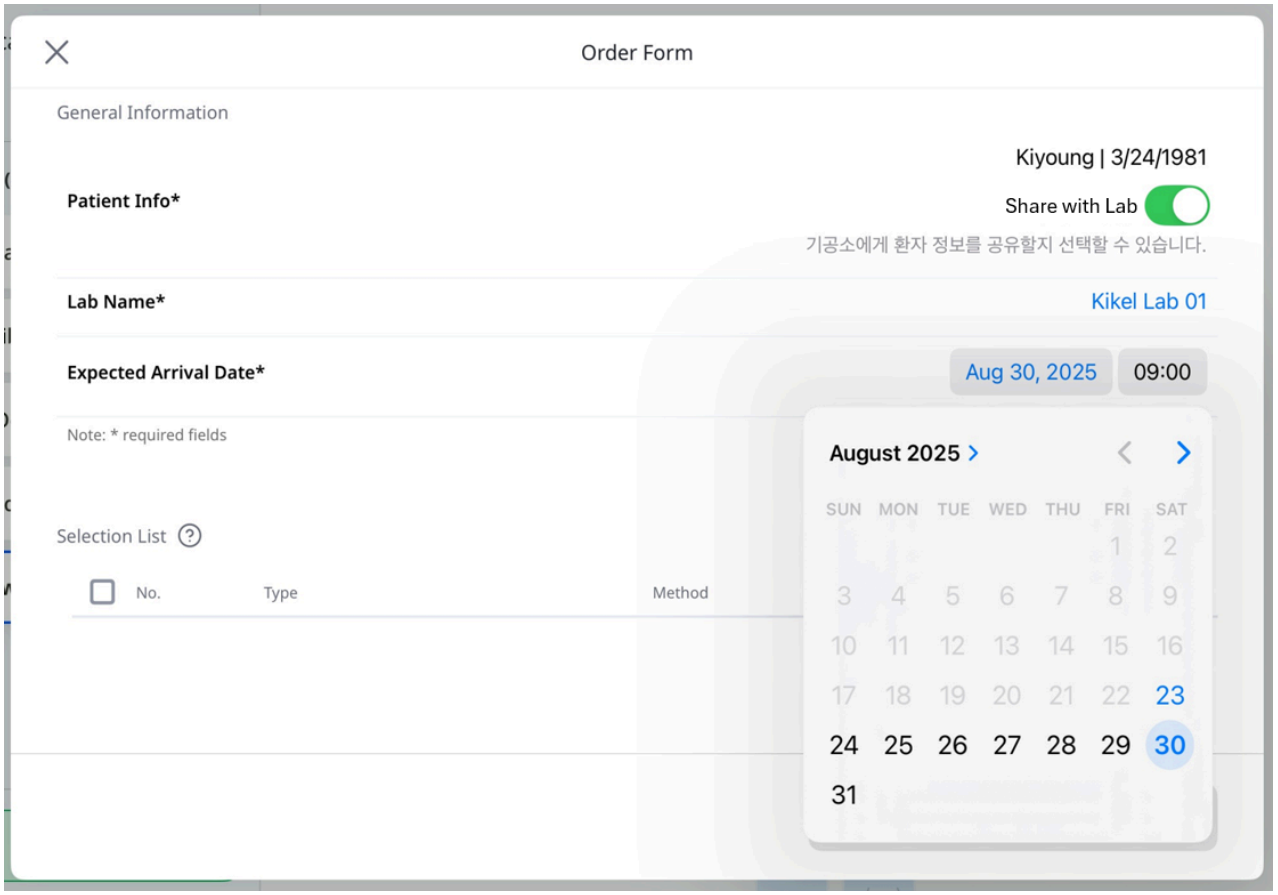

必填欄位	技工所名稱	點選右側的連結以展開下拉選單，然後選擇技工所。
	患者資訊	顯示患者姓名與出生日期。開啟**與技工所共享**以將此資訊分享給技工所。
	交付日期	選擇偏好的交付日期與時間。
選填欄位	牙醫姓名	點選右側的連結以展開下拉選單，然後選擇牙醫師。
	附件	如有需要，請附加參考數據檔案。若要刪除附件，請選取其刪除圖示，然後在確認對話方塊中選取**刪除**。
	重要資訊	添加自訂備註供處理此訂單的技工所參考。

> 🔎**重要資訊**
>
> 交付日期可排定於訂單日期後至少七個曆日。請參考上方的螢幕截圖。

選擇列表

在添加項目之前，請先選擇**牙齒** 或 **牙弓**。

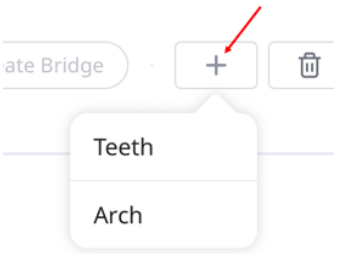

這將決定項目在「選擇列表」中的結構方式。添加項目後，便無法再更改此選擇。若需切換，請移除所有現有項目並重新開始。
「選擇列表」會顯示已選擇要治療的牙齒或顎部，如下例所示：

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

請針對每顆牙齒指定治療類型、方法、材料及牙色。可用選項如下表所示：

類型	方法	材料
嵌體	–	多層氧化鋯、氧化鋯、純金、樹脂、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、蠟、3D列印
高嵌體	–	
內冠	PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯
	PFG	純金
	PFM	鈦、金屬、鈷鉻合金、鎳鉻合金
	無領	多層氧化鋯、純金、LiSi、e.max、金屬、蠟、3D列印
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
義齒內冠	局部義齒內冠	金屬
	主套筒冠 - PFG	純金
	主套筒冠 - PFM	金屬
	副套筒冠 - PFG	純金
	副套筒冠 - PFM	金屬

類型	方法	材料
牙冠	解剖形態	多層氧化鋯、PMMA、純金、樹脂、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印
	臨時	
	PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯
	PFG	純金
	PFM	金屬
	飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、3D列印
牙橋	解剖形態	多層氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印
	臨時	–
	回切	多層氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印
	PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯
	PFG	純金
	PFM	金屬
牙樁和牙核		多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬
貼面	超薄貼面	多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、蠟、3D列印
植體牙冠	螺絲固位	多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、e.max、金屬、3D列印
	粘結固位	
	SCRP	
	臨時	–
	螺絲固位 - 飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、3D列印
	螺絲固位 - PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯
	螺絲固位 - PFG	純金
	螺絲固位 - PFM	金屬
	粘結固位 - 飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、e.max、金屬、3D列印
	粘結固位 - PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯
	粘結固位 - PFG	純金
	粘結固位 - PFM	金屬

類型	方法	材料
	SCRP - 飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、3D列印
	SCRP - PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯
	SCRP - PFG	純金
	SCRP - PFM	金屬
個性化基台	–	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦
手術導板	–	–
基底結構	–	PMMA、金屬、蠟、PEEK、3D列印
個性化基台 + 植體牙冠	螺絲固位	多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、LiSi、e.max、鈦、金屬、3D列印
	粘結固位	
	SCRP	
	臨時	–
	螺絲固位 - 飾瓷	多層氧化鋯、LiSi、e.max、鈦、3D列印
	螺絲固位 - PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦
	螺絲固位 - PFG	多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦
	螺絲固位 - PFM	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬
	粘結固位 - 飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、鈦、3D列印
	粘結固位 - PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦
	粘結固位 - PFG	多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦
	粘結固位 - PFM	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬
	SCRP - 飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、e.max、鈦、3D列印
	SCRP - PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦
	SCRP - PFG	多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦
	SCRP - PFM	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬
個性化基台 + 內冠	PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦
	PFG	多層氧化鋯、氧化鋯、純金、鈦
	PFM	多層氧化鋯、氧化鋯、鈦、金屬
	無領	未選擇、多層氧化鋯、氧化鋯、純金、LiSi、e.max、鈦、金屬、蠟、3D列印
	e.max	多層氧化鋯、氧化鋯、e.max、鈦

類型	方法	材料
	LiSi	多層氧化鋯、氧化鋯、LiSi、鈦
診斷蠟型	–	蠟
局部義齒	支架	PMMA、金屬、蠟、PEEK、3D列印
	臨時	未選擇
	蠟堤	蠟
牙樁&牙核+牙冠	解剖形態	多層氧化鋯、氧化鋯、PMMA、純金、樹脂、LiSi、玻璃陶瓷、鑄瓷、混合陶瓷、複合樹脂、e.max、鈦、金屬、不鏽鋼、蠟、3D列印
	臨時	–
	PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬
	PFG	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬、純金
	PFM	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬
	飾瓷	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、LiSi、e.max、金屬
牙樁&牙核+內冠	PFZ	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬
	PFG	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬、純金
	PFM	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、金屬
	無領	未選擇、多層氧化鋯、氧化鋯、純金、樹脂、LiSi、e.max、金屬、蠟、3D列印
	e.max	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、e.max、金屬
	LiSi	多層氧化鋯、氧化鋯、樹脂、LiSi、金屬

若要建立牙橋，請選取欲包含的牙齒，然後點選**創建牙橋**。

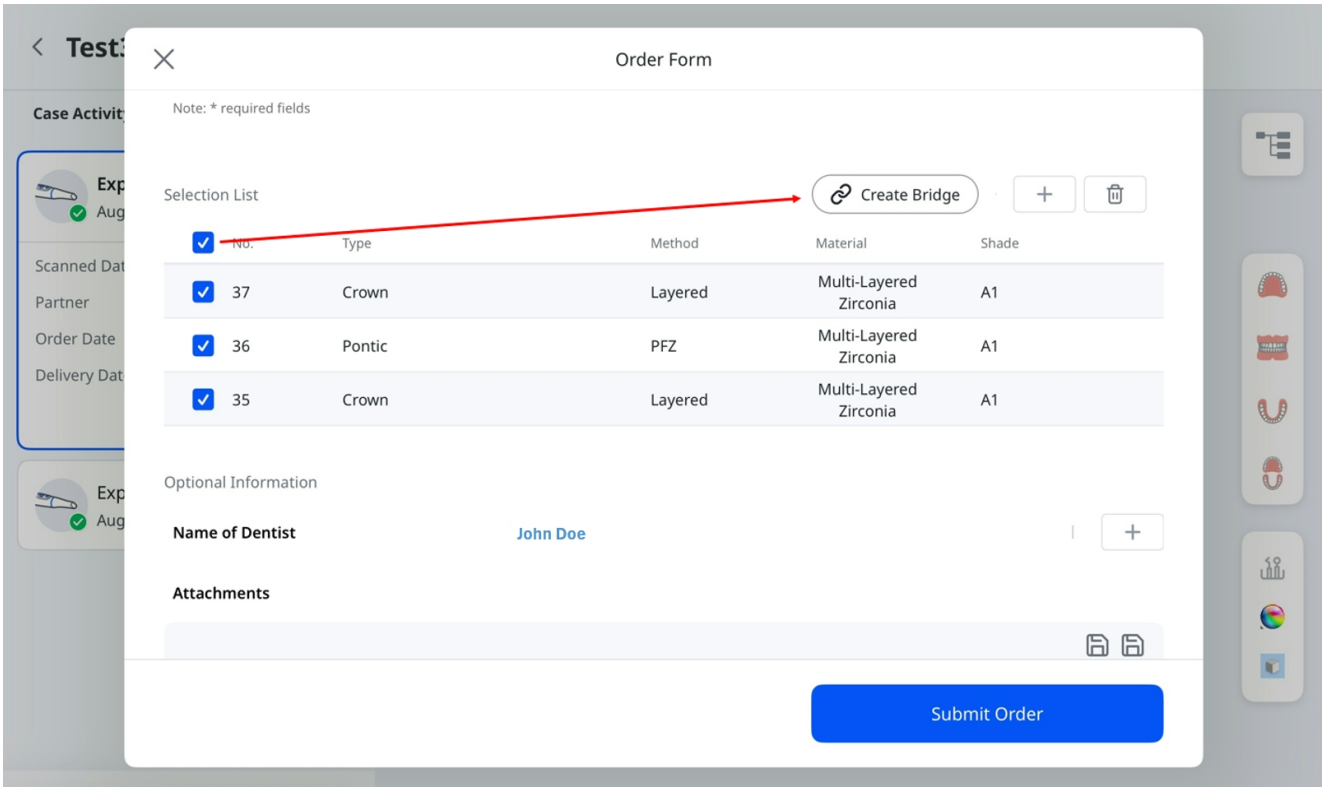

核取方塊會被連結符號取代，以視覺方式表示已在所選牙齒之間成功創建牙橋。



點選**選擇牙醫師**，並從下拉列表中選擇責任人。



🔎重要資訊

若要新增或移除責任人，點選**選擇牙醫師**旁的「+」圖示。

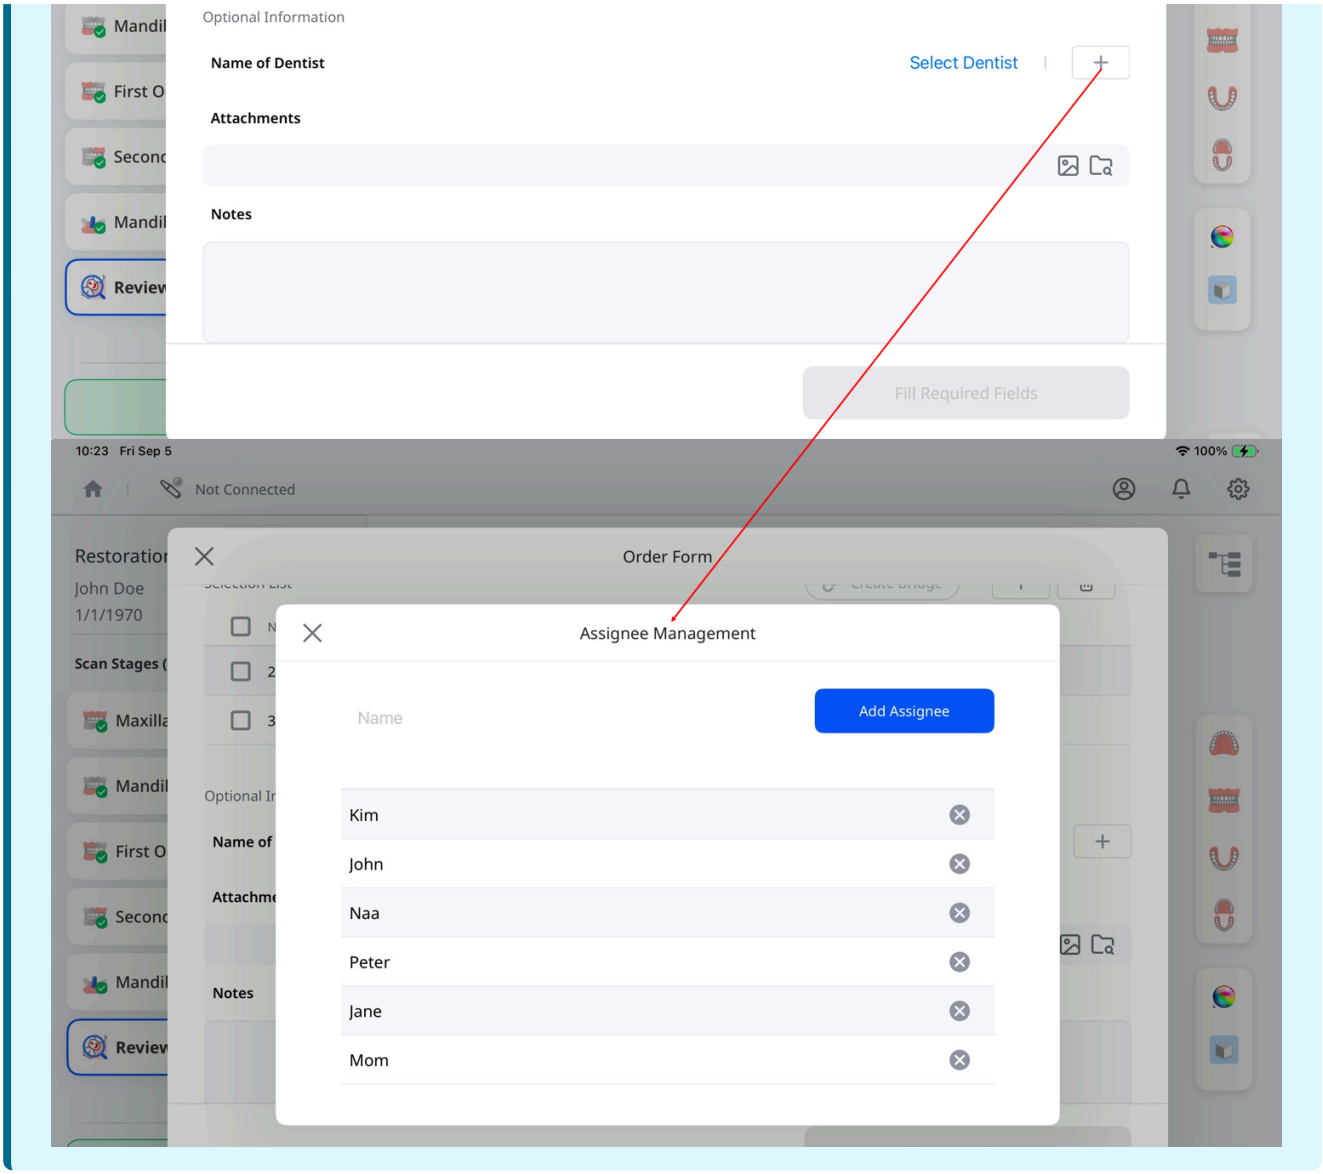

使用**附件**欄位上傳相關檔案，並在**備註**欄位提供關於該案例的其他資訊。

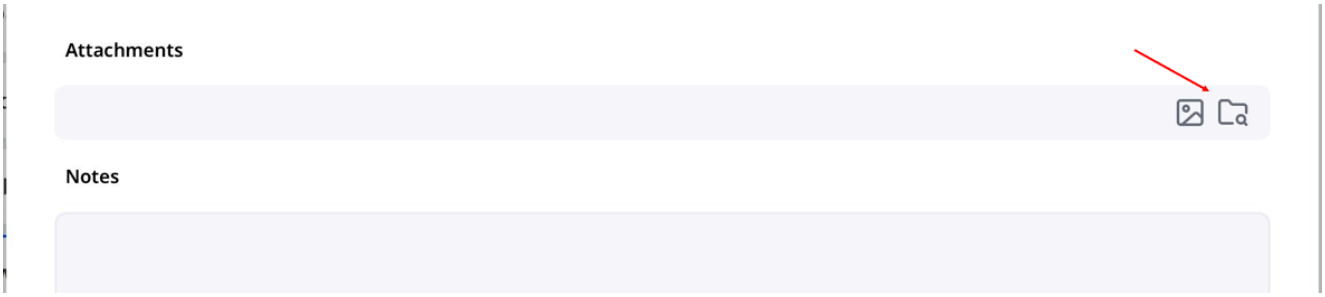

請檢查詳細資訊以確保填寫正確。準備就緒後，點選右下角的**提交訂單**以繼續。

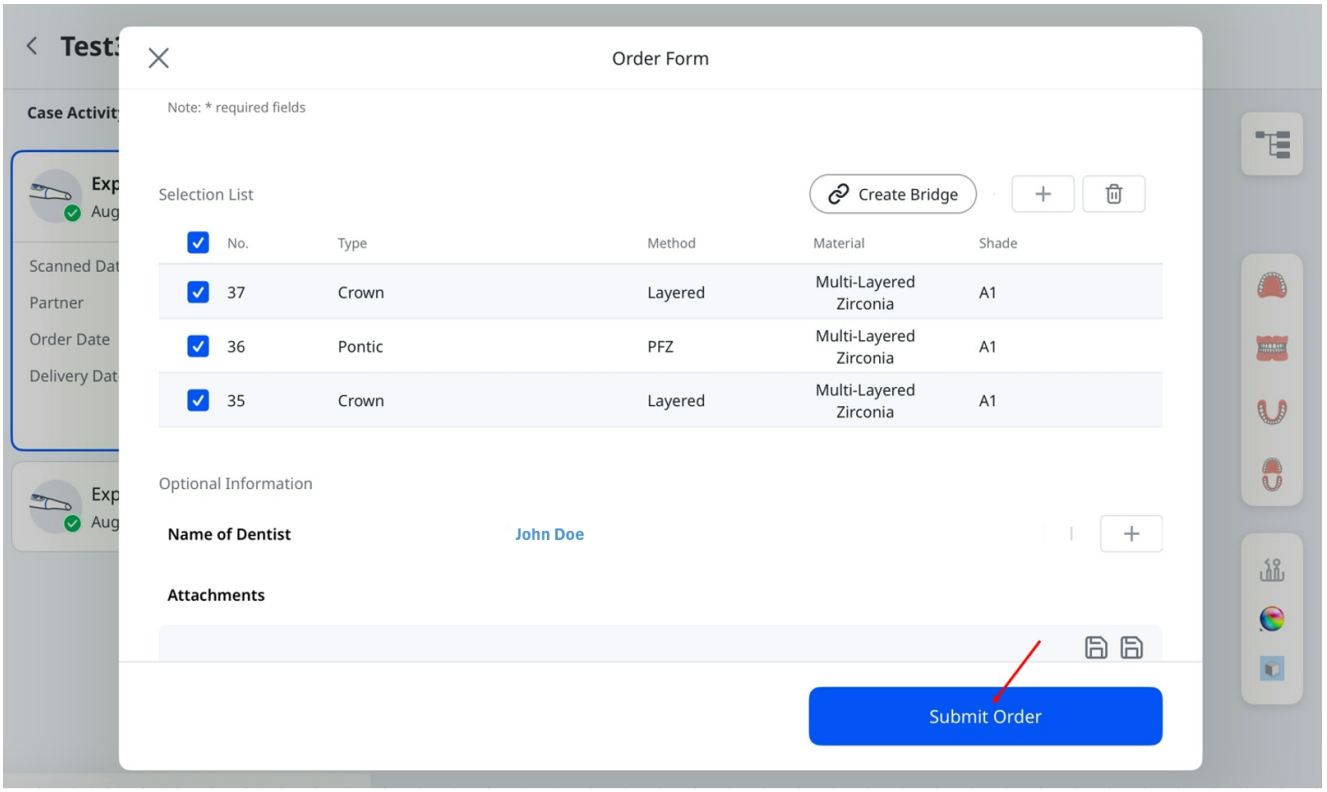

> 🔎**重要資訊**
>
> 在提交訂單前，請確保所有必填欄位皆已填寫，且掃描數據為均可用。對缺少掃描數據的案例無法下單。

查看已訂購案例

點選**提交訂單**會產生訂單概述。在此，您可以再次檢視訂單的詳細資訊，包括已選項與掃描數據。如有需要，您可以點選**取消訂單**，再點選**確認**以取消訂單，如下所示。

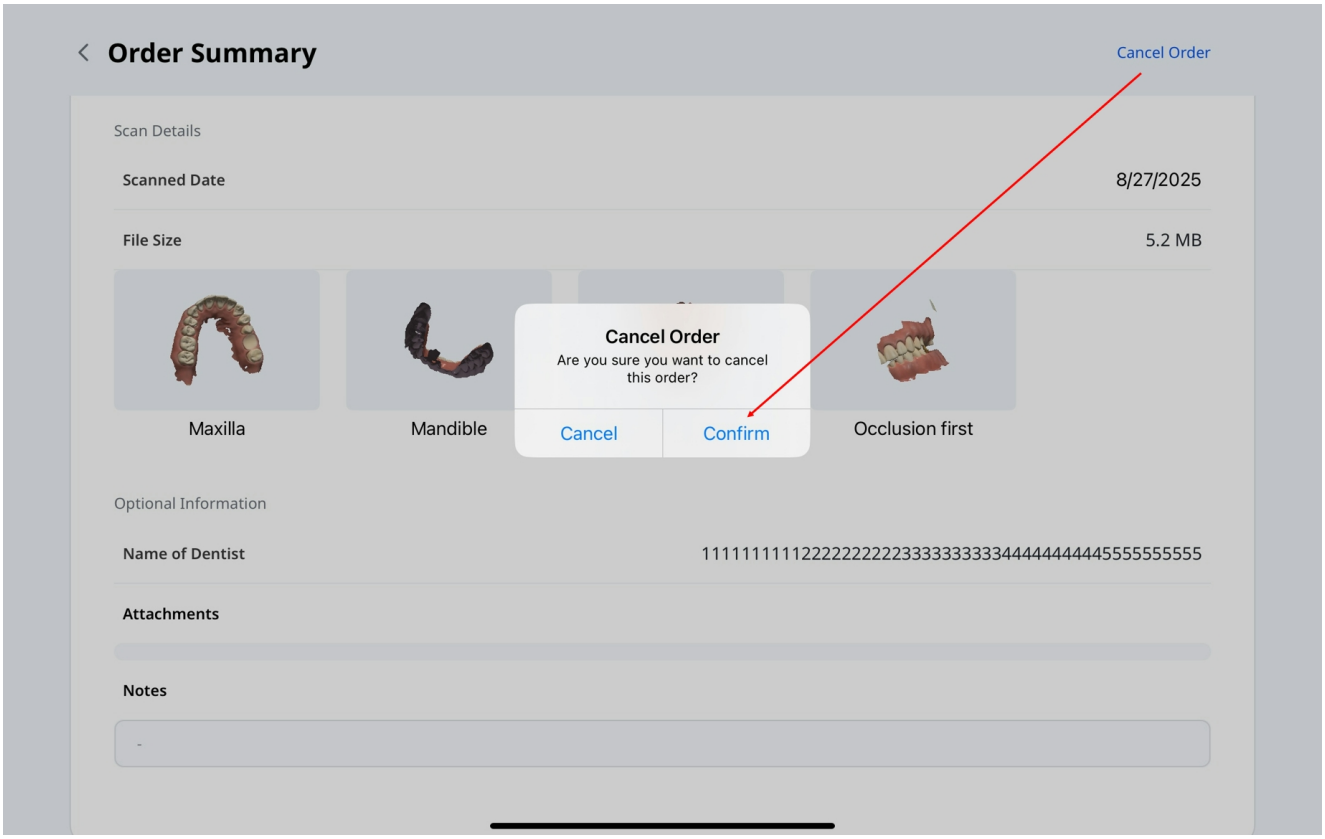

> 🔎**重要資訊**
>
> 在取消訂單前，請確保其狀態為**待處理**。一旦合作夥伴接受訂單且狀態變更為**進行中**，將不再允許取消。

管理訂單

若要查看訂單詳細資訊並追蹤其狀態：

1. 在主畫面點選**管理訂單**。

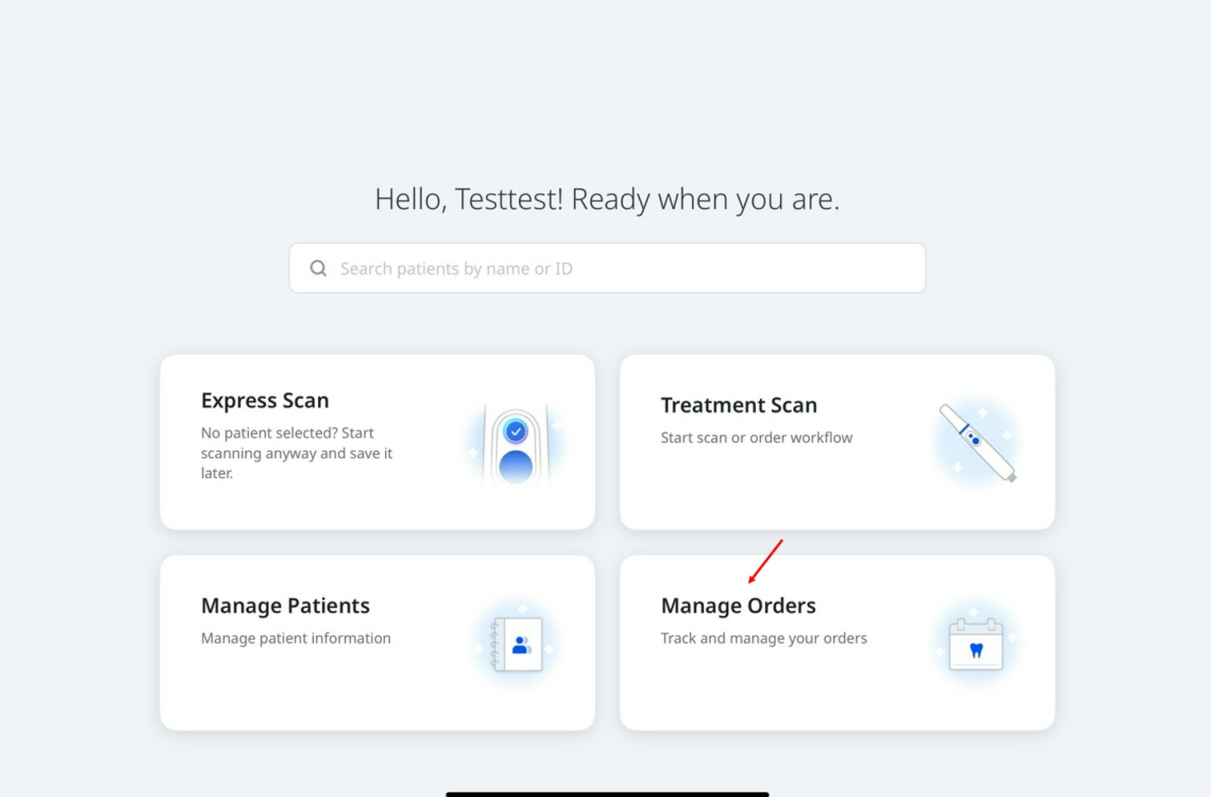

2. 將開啟**管理訂單**畫面，您可以查看訂單詳細資訊、依狀態篩選訂單，以及依訂單資訊進行搜尋。在列表中點選某筆訂單可返回**訂單概述**頁面並檢視完整訂單資訊。

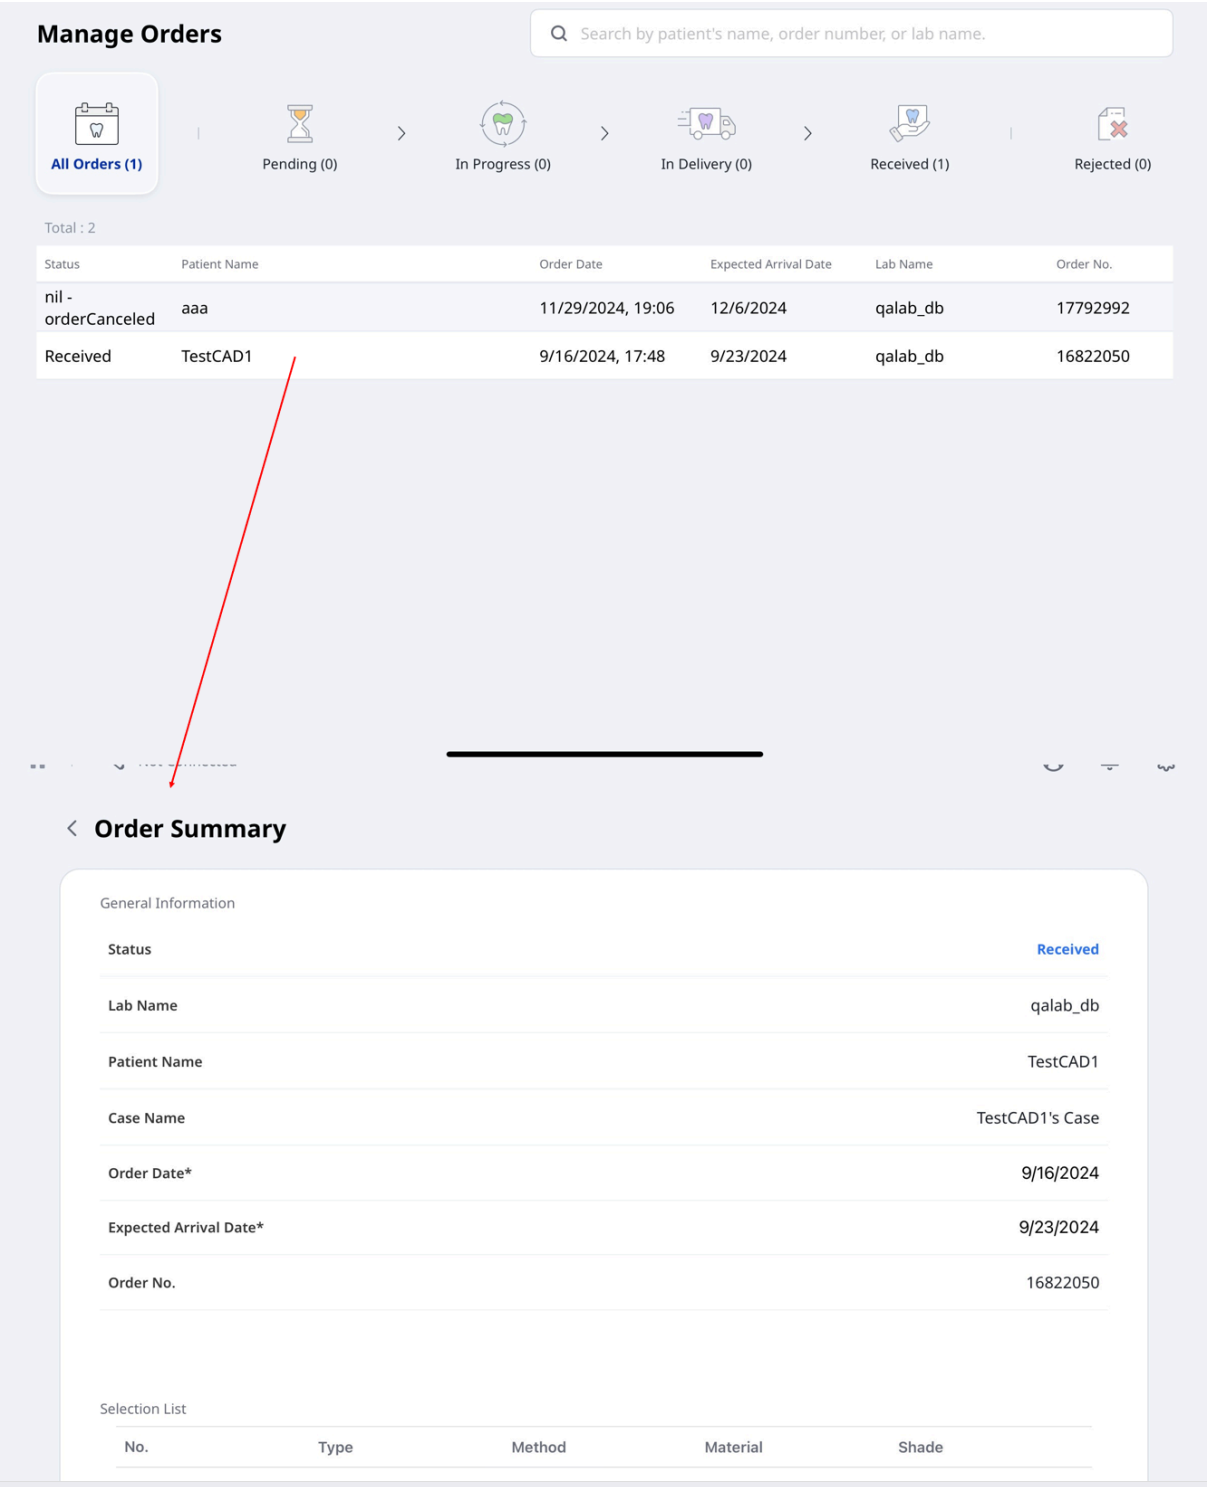
Manage Orders
Search by patient's name, order number, or lab name.
All Orders (1)
Pending (0)
In Progress (0)
In Delivery (0)
Received (1)
Rejected (0)
Total : 2
Status
Patient Name
Order Date
Expected Arrival Date
Lab Name
Order No.
nil - orderCanceled
aaa
11/29/2024, 19:06
12/6/2024
qalab_db
17792992
Received
TestCAD1
9/16/2024, 17:48
9/23/2024
qalab_db
16822050
Order Summary
General Information
Status
Received
Lab Name
qalab_db
Patient Name
TestCAD1
Case Name
TestCAD1's Case
Order Date*
9/16/2024
Expected Arrival Date*
9/23/2024
Order No.
16822050
Selection List
No.
Type
Method
Material
Shade

工作流程

預設工作流程

Medit Link Express提供三個預設工作流程，以最少的設定引導您完成掃描：**修復體**、**植體掃描** 和**矯正掃描**。下表顯示其掃描階段設定。

修復體	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	選擇牙齒 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	適用於牙冠、嵌體、高嵌體與牙橋
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☐ Mandible	選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 →咬合二 → 檢查掃描	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☑ Mandible	選擇牙齒 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合 二→ 檢查掃描	
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☑ Mandible	選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合 一→ 咬合二 → 檢查掃描	
植體掃描	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	選擇牙齒 →上顎 →上顎掃描桿 → 下顎 →下顎掃描桿 → 咬合 一→ 咬合二 → 檢查掃描	用於客製化基台與螺釘固位牙冠
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☐ Mandible	選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☑ Mandible	選擇牙齒 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 術前下顎 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☑ Mandible	選擇牙齒 → 術前上顎 → 上顎 → 上顎掃描桿 → 術前下顎 → 下顎 → 下顎掃描桿 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	
矯正掃描	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	選擇牙弓 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	用於矯正治療
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☐ Mandible	選擇牙弓 → 術前上顎 → 上顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☑ Mandible	選擇牙弓 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☑ Mandible	選擇牙弓 → 術前上顎 → 上顎 → 術前下顎 → 下顎 → 咬合一 → 咬合二 → 檢查掃描	

自訂工作流程

您可以添加、移除及重新排列掃描階段，以建立符合您需求的自訂工作流程。

1. 在工作流程選擇畫面上，選取**建立新工作流程**。

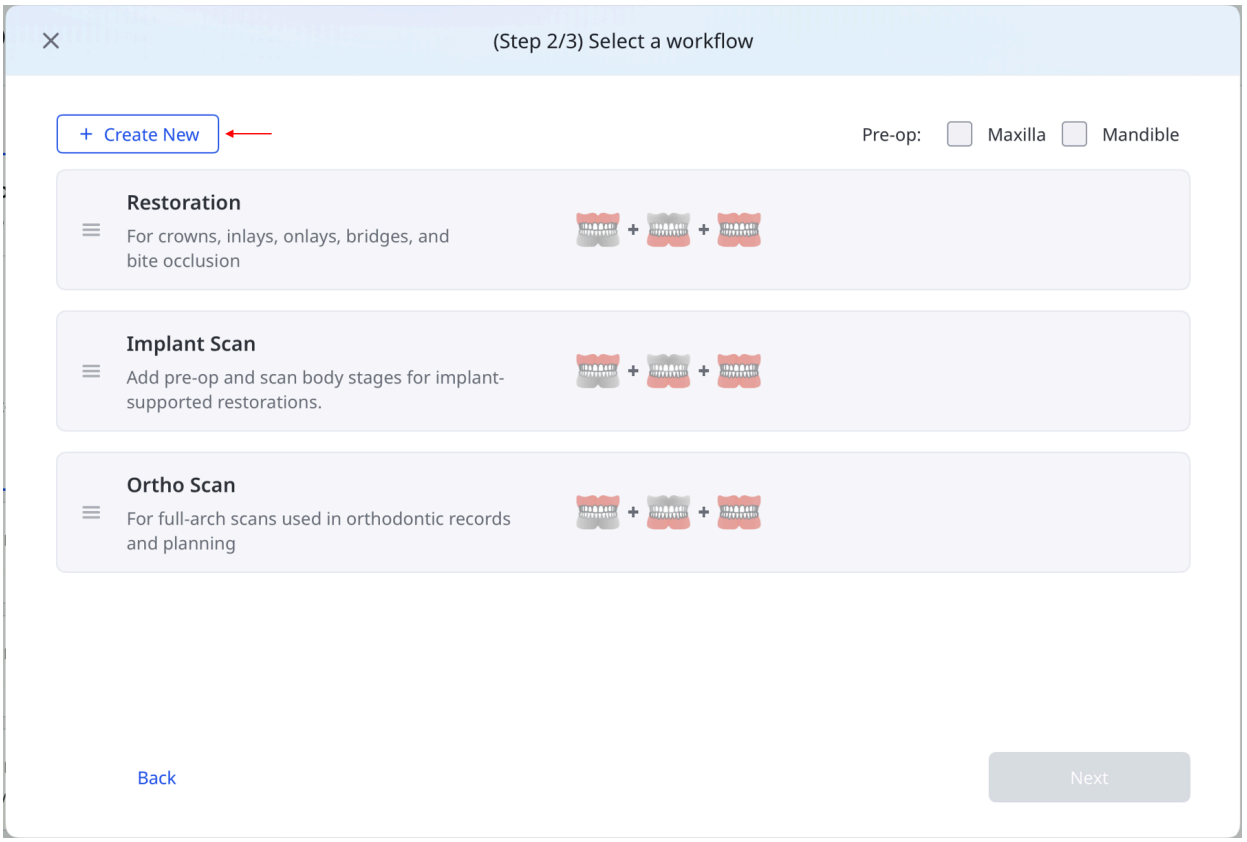

2. 輸入名稱，然後選取**修復體**、**植體** 或**矯正** 作為起始點。

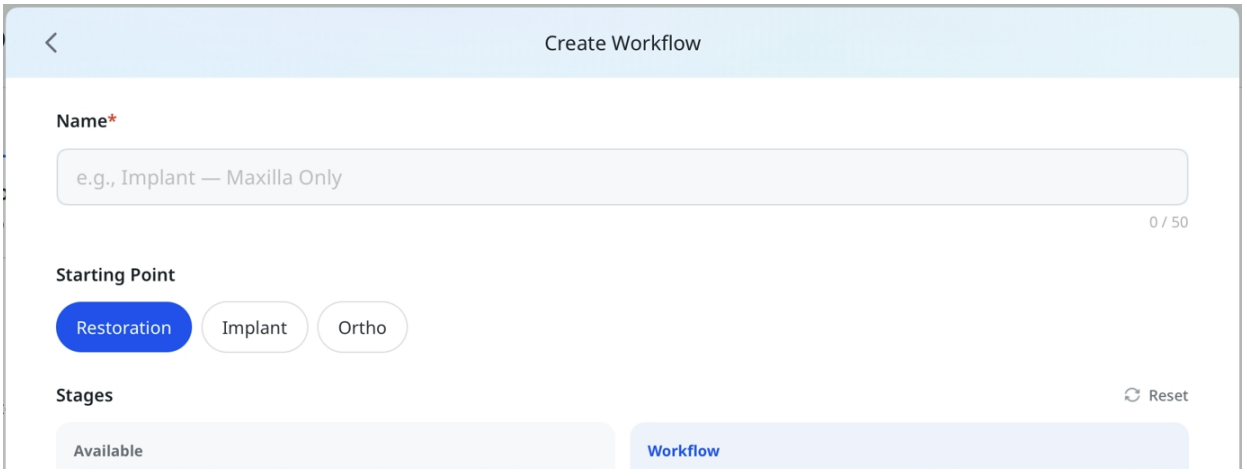

3. 自訂掃描階段：

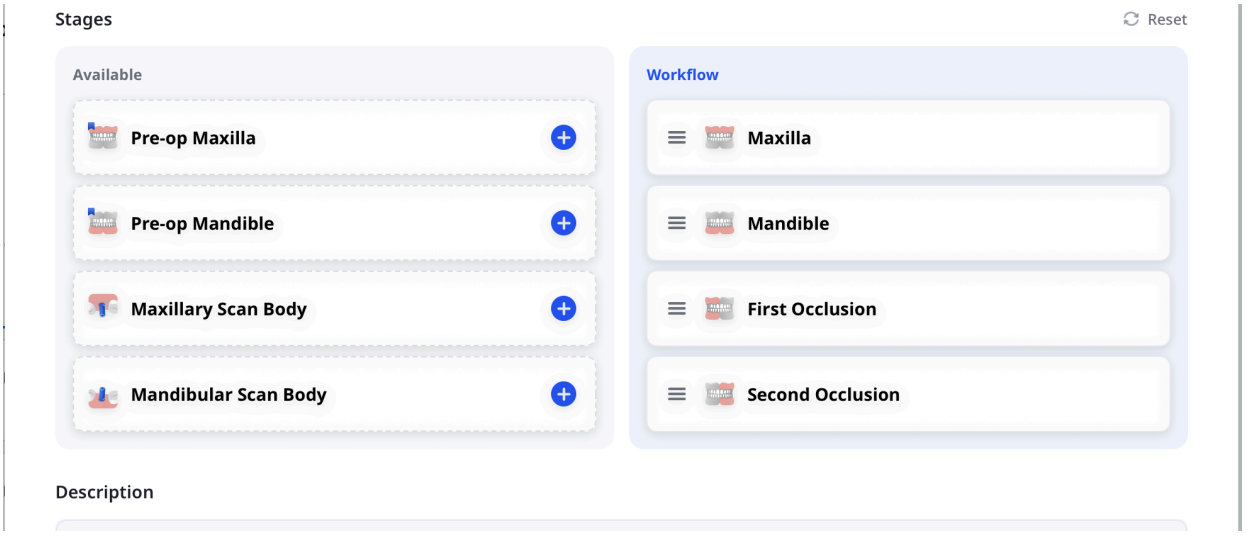

a. 在**可用** 中選取**+**以添加階段，或在**工作流程**中選取**×** 以移除階段。

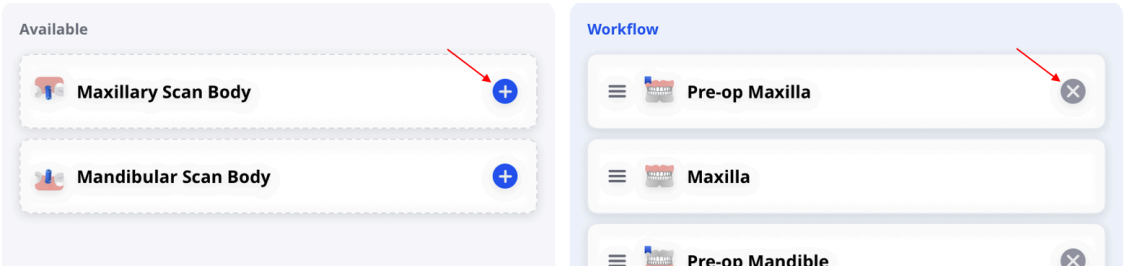

b. 在**工作流程**中按住某個階段，然後拖曳以重新排列順序。



c. 如有需要，選取**重置**，以還原預設設定，同時保留名稱和描述。



4. 如有需要，可添加描述，然後選取**建立**。

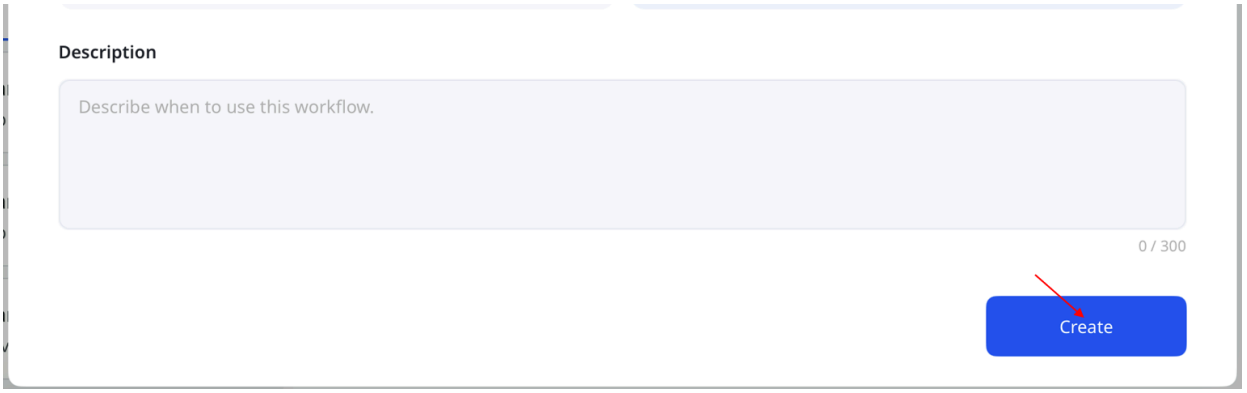

5. 選取**下一步**以繼續。按照**快速指南** 中 **治療掃描** 的 <0>**步驟4** 中的說明操作。

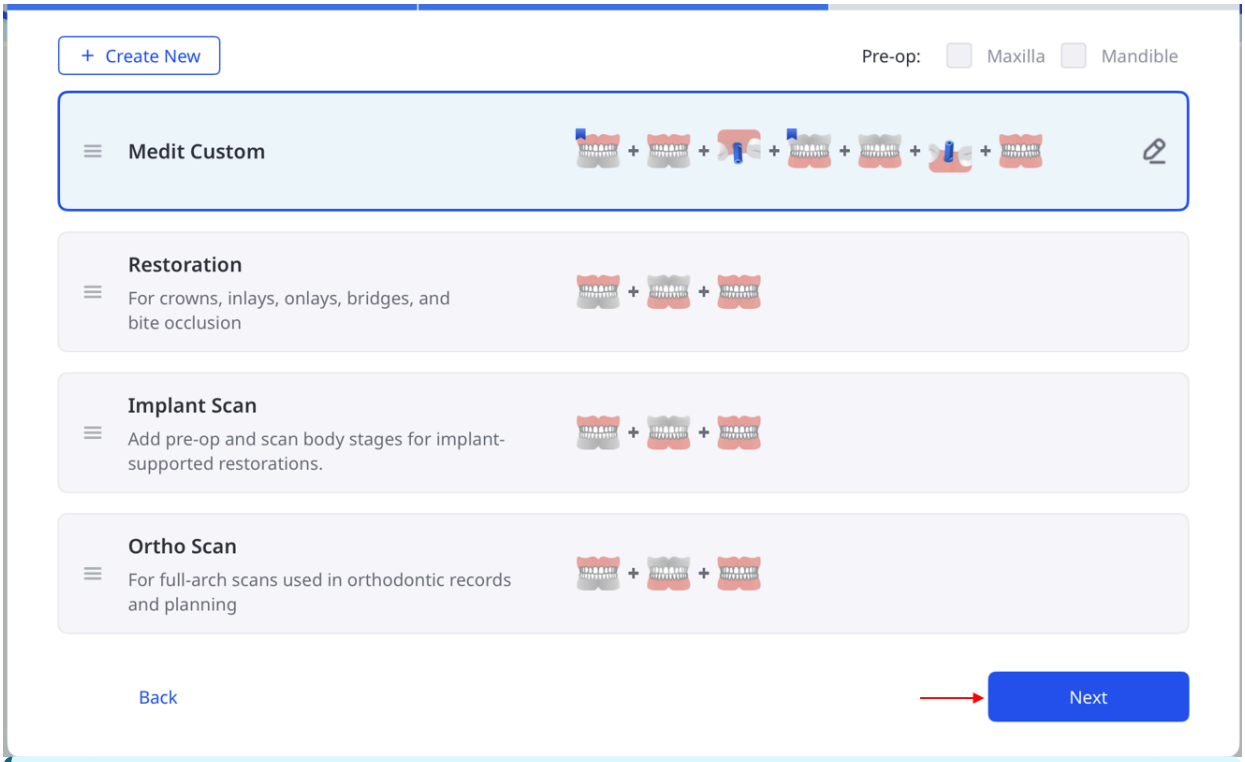

🔎重要資訊

- 「上顎」、「下顎」、「咬合一」和「咬合二」階段無法移除。
- 編輯現有工作流程時，無法變更起始點。
- 您最多可以建立10個自訂工作流程。這些工作流程會針對各個帳戶儲存在本機，不會在裝置之間同步。
- 若要編輯或刪除自訂工作流程，請在工作流程列表中選取其旁的鉛筆圖示。若要重新排列工作流程，請使用其名稱旁的控制柄拖曳。

掃描階段與工具

掃描階段

Medit Link Express可簡化數位印模的擷取，確保牙科掃描高效且精確。該平台支援以下掃描階段：

上顎術前	用於上顎術前掃描
下顎術前	用於下顎術前掃描
上顎	用於獲取上顎3D掃描數據
下顎	用於獲取下顎3D掃描數據
上顎掃描桿	用於獲取上顎掃描桿的3D掃描數據
下顎掃描桿	用於獲取下顎掃描桿的3D掃描數據
咬合	用於獲取咬合一和/或咬合二的3D掃描數據

> 🔎**重要資訊**
>
> - 階段名稱中的「前」並不表示這些階段必須先於其他階段進行；術前掃描可以在之後透過上顎與下顎的掃描數據來執行。
> - 「咬合」與「掃描桿」階段可以先於目標數據掃描進行。掃描完成後，選取目標數據後系統將自動在背景中啟動對齊程序。

工具——編輯

修剪

修剪工具可用於移除不必要的元素，從而協助進行掃描數據的優化及清理。這些工具包括：

Brush	筆刷	沿螢幕上的手繪路徑進行掃描數據刪除。
Quick	快速選擇	點擊後可立即刪除掃描數據中已分離的部分。

Polyline	多邊形選擇	移除螢幕上繪製的多線段形狀內的所有實體。 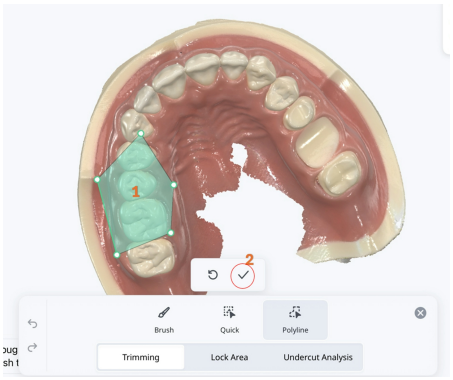 在工具列點擊**復原**圖示以撤銷移除操作。  在應用前要撤銷選取，請點擊✓（確認）圖示旁的**復原**圖示。 

鎖定區域

使用選取工具鎖定特定區域可防止對掃描數據被進一步修改。

Brush	筆刷	沿手繪路徑鎖定區域，以防止後續修改。
Deselect	取消選取	沿手繪路徑取消選取區域，使其可再次編輯。
Deselect All	取消全選	清除所有已鎖定區域，允許後續修改。

倒凹分析

根據插入方向分析倒凹區域。

	筆刷	可自由手繪標記倒凹區域。
	取消選取	沿手繪路徑取消選取已標記的倒凹區域。
	取消全選	清除所有已選取的倒凹區域。
	自動設定方向	計算並顯示可使倒凹區域最小化的方向。
	視角方向	根據使用者的視圖方向計算並顯示倒凹區域。

工具——手動對齊

	手動對齊	使用匹配點手動對齊掃描數據。
	刪除點	刪除您最後新增的匹配點。
	清除對齊	清除當前對齊並重新開始。 （僅適用於掃描桿數據）
	清除上顎	將上顎恢復至對齊前的位置。 （僅適用於咬合數據）
	清除下顎	將下顎恢復至對齊前的位置。 （僅適用於咬合數據）

🔎重要資訊

手動對齊適用於特定的數據組合。

- 支援以下：
  - 手術——掃描桿
  - 含術前數據的咬合
  - 含手術數據的咬合
- 不支援以下：
  - 介於術前與手術之間的數據
  - 帶掃描桿的術前數據

工具——視圖模式

	光澤	查看具有光澤效果的彩色數據（PBR渲染）。
	磨砂	以具有磨砂效果的彩色模式查看數據（Phong渲染）。
	單色	以單色模式查看數據。
	可信圖	在模型上應用紅、黃、綠三色來表示掃描數據的可靠性。 * 綠色數據表示可靠性高，而紅色表示可靠性差。您可以透過執行額外掃描來減少不可信的區域。
	磨砂+可信圖	允許在掃描和檢視簡單著色的同時參考可信圖，有助於獲取更優的結果。

工具 ——網格顯示

	開啟網格	在背景中顯示網格。
	關閉網格	在背景中隱藏網格。
	開啟圖層重疊	將網格重疊於模型之上。

工具 ——智能掃描檢查

	智能掃描檢查	在處理所獲取的掃描數據之前對數據的準確性進行最後的檢查。 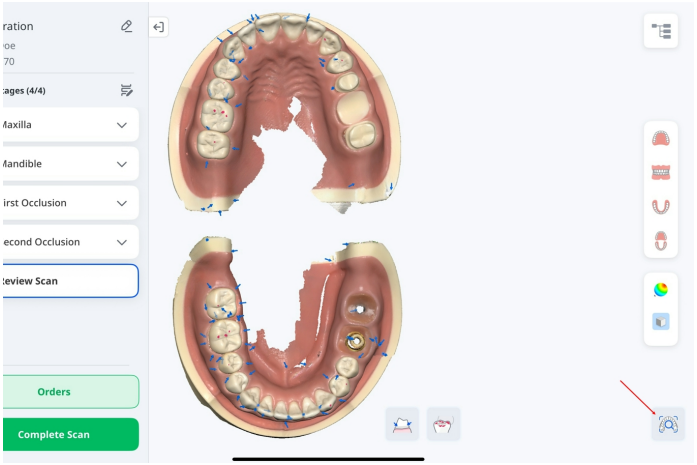
→	智能箭頭	在數據獲取不充足的區域顯示智能箭頭。

		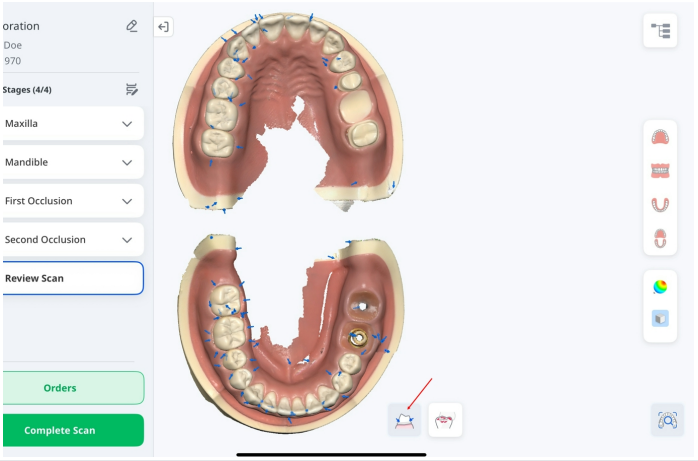
	咬合分析	分析上顎和下顎間之干擾，在顏色圖上顯示分析結果。 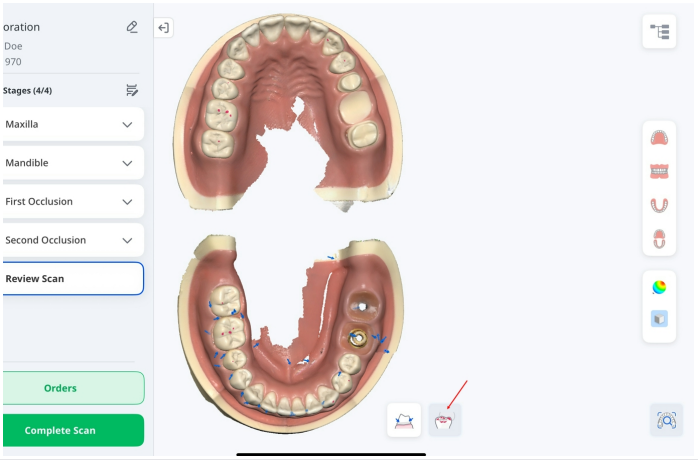

工具——高清相機

您可以使用掃描儀擷取高品質的2D口內影像。可對擷取的影像進行檢視、重新命名或刪除。影像會自動附加至案例，並隨訂單一併提交。

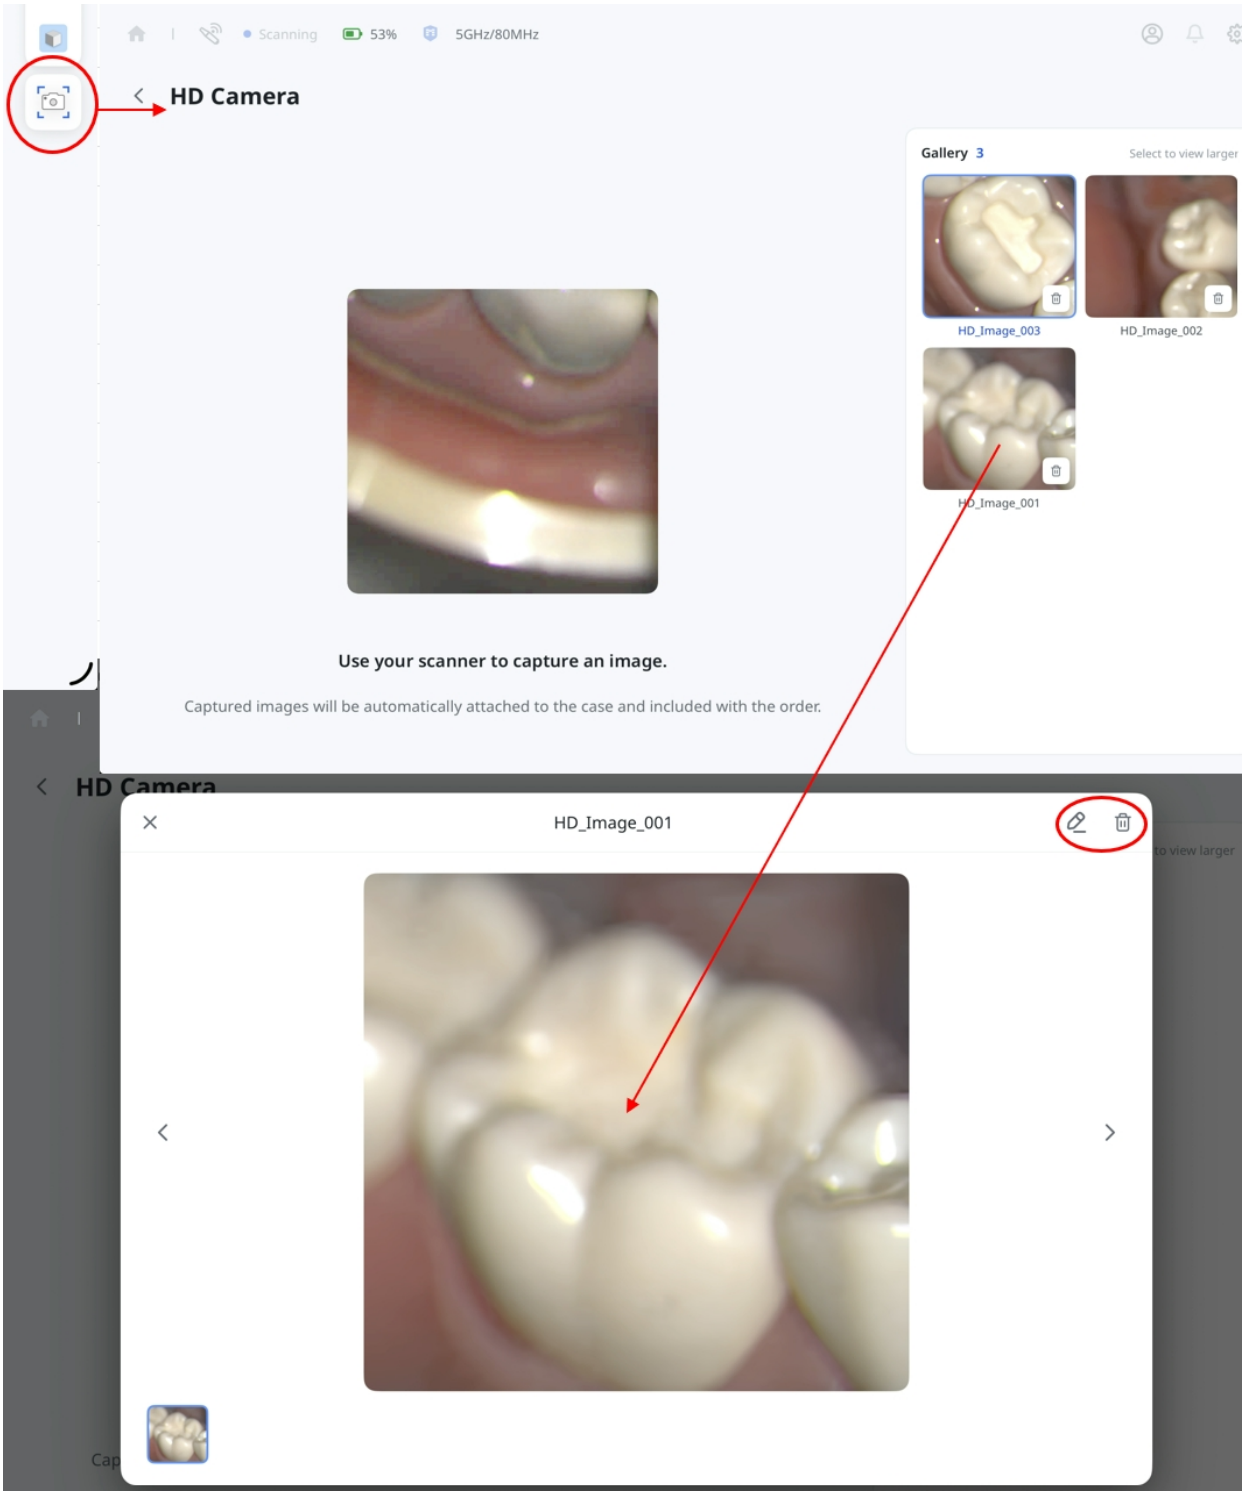

🔎重要資訊

高清相機可在「Express Scan」和「治療掃描」中使用，但「檢查掃描」階段除外。

製造商資訊

Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

聯絡產品售後服務

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600

Powered by Document360